

# **Proficiency Testing Scheme für die Wasseranalytik - Realproben H114 Herbizide/Pestizide**

**Proficiency Testing Scheme for Water  
Analysis - natural water samples  
H114 Herbicides/Pesticides**

## **BERICHT / REPORT**

Probenversand / Sample dispatch: 11.10.2022

**Ausgabe/Edition 1: 22.11.2022**

Dieser Report umfasst 341 Seiten.

This report comprises 341 pages.

Durchführung gemäß Verfahren VA\_1005\_PT\_CA (2021-01-25).

In accordance with the procedure VA\_1005\_PT\_CA (2021-01-25).



**Anbieter der Eignungsprüfung / Provider of the proficiency test:**

**Anschrift / Address:** Umweltbundesamt GmbH  
Spittelauer Lände 5  
1090 Vienna/Austria

**E-Mail:** [ringversuche@umweltbundesamt.at](mailto:ringversuche@umweltbundesamt.at)  
**Tel:** +43 (0) 1 31304 4334

**Website deutsch:** [www.umweltbundesamt.at/ringversuche](http://www.umweltbundesamt.at/ringversuche)  
[www.ifatest.at](http://www.ifatest.at)

**Website english:** <https://www.umweltbundesamt.at/en/proficiency-testing>  
[www.ifatest.eu](http://www.ifatest.eu)

**Koordination und technische Leitung Eignungsprüfungen / coordinator and technical management:**

Dipl.-Ing. Monika Denner

**Verantwortlich für die Durchführung der Eignungsprüfungs runde / Responsible for the implementation of this proficiency test:**

Dipl.-Ing. Johannes Urteil, Martha Schmid MSc unter Mitarbeit von Mag. Vito Satrapa  
Tel.: +43 (0) 1 31304 4334

**Verantwortlich für die Freigabe des Berichts / Responsible for authorizing the report:**

Dipl.-Ing. Monika Denner  
Leitung Eignungsprüfungen für den Bereich chemische Analytik / Management for proficiency tests for chemical analysis

## Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

D1. Beschreibung des Ringversuchs.....	5
D1.1. Ausgestaltung und Durchführung .....	5
D1.2. Beschreibung der Prüfgegenstände .....	5
D1.3. Anweisungen für die Teilnehmenden.....	6
D1.4. Kontrollanalytik zur Bewertung der Homogenität.....	6
D1.5. Trendtest zur Bewertung der Stabilität.....	6
D1.6. Ermittlung des zugewiesenen Wertes.....	7
D2. Kriterien der Leistungsbewertung .....	8
D2.1. Leistungskriterium z-Score.....	8
D2.2. Leistungskriterium $E_n$ -Score .....	8
D2.3. Leistungsbewertung z-Score und $E_n$ -Score.....	9
D3. Darstellung und Interpretation der Messergebnisse.....	9
D4. Anmerkungen zur Auswertung.....	10
D5. Erläuterung zu Tabellen und Grafiken .....	12
D5.1. Angaben und Abkürzungen in Tabellen .....	12
D5.2. Graphische Darstellung der Ergebnisse .....	15
D6. Zusammenfassung .....	18
D6.1. Tabelle der zugewiesenen Werte .....	18
D6.2. Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse ..	20
E1. Description of the proficiency test .....	22
E1.1. Design and implementation .....	22
E1.2. Description of the proficiency test items .....	22
E1.3. Instructions for the participants .....	22
E1.4. Control testing for homogeneity evaluation.....	23
E1.5. Trend test for stability evaluation .....	23
E1.6. Determination of the assigned values.....	24
E2. Criteria of performance evaluation .....	25
E2.1. Performance criterion z-Score .....	25
E2.2. Performance criterion $E_n$ -Score .....	25
E2.3. Performance evaluation z-Score and $E_n$ -Score .....	26
E3. Representation and interpretation of measurement results.....	26
E4. Explanatory notes .....	27

E5. Annotations on tables and charts .....	29
E5.1. Information and abbreviations in tables .....	29
E5.2. Graphical presentation of results .....	31
E6. Summary.....	34
E6.1. Table of assigned values .....	34
E6.2. Summary of results, after removal of outliers.....	36
E7. Parameterorientierte Auswertung / Parameter oriented report.....	38
E8. Labororientierte Auswertung / Laboratory oriented report.....	217
E9. Methodenübersicht / Overview of methods .....	332

## D1. Beschreibung des Ringversuchs

### D1.1. Ausgestaltung und Durchführung

- Anzahl der Anmeldungen: 19
- Anzahl der übermittelten Datensätze: 19
- Probenversand: 11.10.2022
- Einsendeschluss der Daten: 15.11.2022

Die Ergebnisabgabe erfolgte auf elektronischem Weg mittels passwortgeschützter Online-Dateneingabe. Beim Abschluss der Dateneingabe bestätigten die Teilnehmenden die vollständige und korrekte Eingabe aller Daten und die Freigabe der Ergebnisse zur Auswertung.

Zur Anonymisierung der Ergebnisse wurde jedem Labor willkürlich ein Laborcode zugeteilt.

### D1.2. Beschreibung der Prüfgegenstände

Die Probenahme von Grundwasser und von Oberflächenwasser erfolgte jeweils am 06.10.2022. Das Probenmaterial umfasste:

- 1 Probe Grundwasser (H114 A)
- 1 Probe Oberflächenwasser (H114 B)

Alle Proben wurden bis zur weiteren Verarbeitung gekühlt gelagert (4 +/-3°C).

Das Abfüllen der Proben erfolgte nach Filtration (40 µm) unter ständigem Rühren (Rührkessel). Die o.a. Proben wurden zusätzlich mit einzelnen Substanzen im Rührkessel dotiert. Die Stabilisierung erfolgte durch Kühlung.

Die homogenen Prüfgegenstände wurden am 11.10.2022 verschickt.

Jedes Teilnehmerlabor erhielt, je nach Bestellung:

- 2 Proben zu je 600 ml, abgefüllt in 2 x 300 ml Aluminium-Flaschen oder
- 2 Proben zu je 2000 ml, abgefüllt in 2 x 1000 ml Aluminium-Flaschen oder
- 2 Proben zu je 4000 ml, abgefüllt in 4 x 1000 ml Aluminium-Flaschen

### **D1.3. Anweisungen für die Teilnehmenden**

Aus Stabilitätsgründen wurde empfohlen bis spätestens 19.10.2022 mit den Analysen zu beginnen.

Den Teilnehmenden stand die Wahl der Analysenmethode bzw. der verwendeten Norm frei, welche mit ihrem Routineverfahren übereinstimmen sollte. Eine Übersicht der angewendeten Methoden findet sich unter E9.

### **D1.4. Kontrollanalytik zur Bewertung der Homogenität**

Im Zuge der Abfüllung wurden zu willkürlichen Zeitpunkten mehrere Aliquote pro Probe zur Kontrollanalytik entnommen.

Es wurden für die A- bzw. B-Probe jeweils n=5 Kontrollproben sowie n=1 undotierte Realprobe dem Labor zur Analyse übergeben.

Alle Parameter wurden in der Prüfstelle am Umweltbundesamt (Prüfstelle für Umwelt-, GVO- & Treibstoffanalytik, akkreditiert nach EN ISO/IEC 17025 für die angeführten Substanzen) zeitnah zum Probenversand analysiert.

Im Zuge der Auswertung wurde die relative Standardabweichung zwischen den Kontrollprobenabfüllungen bewertet und mit der Vergleichsstandardabweichung beim aktuellen Ringversuch verglichen.

Die Ergebnisse der Kontrollanalytik sind in der parameterorientierten Auswertung (E7) in Form von Mittelwerten  $\pm$  Messunsicherheit als Kontrollwert (control test value)  $\pm$  U gelistet (jeweils angegeben als erweiterte Messunsicherheit, k=2).

### **D1.5. Trendtest zur Bewertung der Stabilität**

Die Bewertung der Stabilität der Prüfgegenstände (Realproben) erfolgte auf Basis der Datenstatistik aus den vergangenen Runden für Realproben im Zeitraum 2013 bis 2021.

Um die ausreichende Stabilität der Prüfgegenstände der aktuellen Eignungsprüfungsrounde bis zum Abgabetermin zu überprüfen, wurde die Darstellung der Ergebnisse der Teilnehmenden nach Analysendatum ausgewertet und auf systematische Trends geprüft (unauffällig). Durch Darstellung der Ergebnisse der Teilnehmenden nach Abfüllreihenfolge wurde auf das Vorliegen möglicher systematischer Trends der Ergebnisse geprüft (unauffällig).

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und aufgrund der Bewertungsgrundlagen der aktuellen Eignungsprüfungsrounde gilt die Stabilität der Prüfgegenstände im empfohlenen Zeitraum für die Analyse bis zum Abgabeschluss als gewährleistet.

#### **D1.6. Ermittlung des zugewiesenen Wertes**

Die Ergebnisse der Analysen mussten spätestens bis zum 15.11.2022 beim Veranstalter vorliegen. Später eingehende Werte wurden nicht berücksichtigt.

Im Zuge der Plausibilitätsprüfung der Daten (z.B. Check korrekte Einheiten, Messunsicherheitsangabe, ...) wurden die Teilnehmenden mit auffälligen Ergebnissen zum erneuten Datencheck der Eingabe und um Rückmeldung binnen 24 h aufgefordert.

Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung, wurde der Ausreißertest nach Hampel durchgeführt und die Ausreißer ermittelt. Die von diesem Test auffällig eingestuften Werte wurden in der Auswertung gekennzeichnet („H“). In begründeten Fällen, z.B. wenn der Ausreißertest nach Hampel nicht anwendbar ist (z.B. Ergebnisse liegen sehr eng beieinander oder überwiegend selber Zahlenwert bzw. bei wenig abgegebenen Daten mit sehr hoher Streuung), kann eine Ausreißereliminierung nach weiteren Kriterien erfolgen (z.B. Dean- und Dixon Test bzw. manuelle Ausreißerdefinition aufgrund Expertenbefund). Diese Vorgangsweise wird nach Anwendung unter Punkt D4 des Berichts dokumentiert.

Die weitere Auswertung erfolgte gemäß ISO 5725-2. Eine statistische Auswertung der Ringversuchsdaten erfolgte erst ab zumindest 6 gültigen, numerischen Ergebnissen pro Parameter. Ergebnisse kleiner Bestimmungs- oder Nachweisgrenze wurden bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Der zugewiesene Wert wird im Normalfall jeweils als der ausreißerbereinigte Mittelwert über alle übermittelten Ergebnisse gebildet.

Bei sehr hohen Streuungen der Ergebnisse der Teilnehmenden von über 50 % oder bei mangelhafter Rückführbarkeit der statistischen Kenndaten aus den ausreißerbereinigten Ergebnissen der Teilnehmenden auf den Mittelwert des Kontrolllabores bzw. einer zu geringen Anzahl an ausreißerbereinigten Ergebnissen über die Gruppe der akkreditierten Labore, kann die Situation auftreten, dass kein zugewiesener Wert für den aktuellen Ringversuch festgelegt werden kann und daher keine Bewertung der Ergebnisse der Teilnehmenden für diesen Parameter möglich ist. Ein entsprechender Hinweis wird im Bericht unter E7 bei der informativen Auswertung angebracht. Im Rahmen der internen Qualitätssicherung der Teilnehmenden kann ein Vergleich mit den Ergebnissen des Kontrolllabors durchgeführt werden. Diese

Vorgehensweise wird bei Anwendung jeweils parameter- und probenbezogen unter Punkt D4 des Berichts dokumentiert.

## D2. Kriterien der Leistungsbewertung

### D2.1. Leistungskriterium z-Score

Als Basis zur Berechnung der Wiederfindungsraten sowie der z-Scores wurde der ausreißerbereinigte Mittelwert über alle übermittelten Ergebnisse herangezogen.

Die Ermittlung der z-Scores erfolgte gemäß nachfolgender Formel:

$$z\text{-score} = \frac{x_i - \bar{X}}{\text{Kriterium}}$$

Dabei ist:

$x_i$	Messergebnis des teilnehmenden Labors
$\bar{X}$	zugewiesener Wert Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen); im Regelfall: ausreißerbereinigter Mittelwert der Ergebnisse der Teilnehmenden. Eine davon abweichende Vorgehensweise wird unter Punkt D4 des Berichts beschrieben.
Kriterium	Vergleichsstandardabweichung berechnet aus den Statistiken für reale Wasserproben der vorangegangenen Runden im Zeitraum 2013 bis 2021 (RSDpooled) bzw. aus den ausreißerbereinigten Ergebnissen der Teilnehmenden (sR) des aktuellen Ringversuchs (falls noch weniger als 6 vorangegangene Runden für A und B-Proben vorlagen). In begründeten Fällen (z.B. Ergebnisse Realproben nahe an Mindestbestimmungsgrenze oder regulatorischer Vorgaben) erfolgt die Festlegung nach Expertenbefund und die Vorgangsweise wird unter Punkt D4 des Berichts beschrieben.

### D2.2. Leistungskriterium E<sub>n</sub>-Score

Für die realen Wasserproben erfolgen seit 2019 zusätzliche Bewertungen unter Einbeziehung der erweiterten Messunsicherheiten der Teilnehmenden und der erweiterten Messunsicherheit des zugewiesenen Wertes, gemäß E<sub>n</sub>-Score. Diese Auswertungen werden für die Teilnehmenden im Bericht unter Punkt E8, jeweils im Anschluss an die z-Score Auswertung dargestellt.

Die Ermittlung der E<sub>n</sub>-Scores erfolgte gemäß nachfolgender Formel:

$$E_n - score = \frac{x_i - \bar{X}}{\sqrt{U(x_i)^2 + U(\bar{X})^2}}$$

Dabei ist:

$x_i$	Messergebnis des teilnehmenden Labors
$\bar{X}$	zugewiesener Wert Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen); im Regelfall: ausreißerbereinigter Mittelwert der Ergebnisse der Teilnehmenden. Eine davon abweichende Vorgehensweise wird unter Punkt D4 des Berichts beschrieben.
$U(x_i)$	erweiterte Messunsicherheit des Messergebnisses (Ergebnisse der Teilnehmenden), $k=2$
$U(\bar{X})$	erweiterte Messunsicherheit des zugewiesenen Wertes, $k=2$

### D2.3. Leistungsbewertung z-Score und $E_n$ -Score

#### Interpretation der z-Scores:

- $|z\text{-Score}| \leq 2.0$  Ergebnis gut
- $2.0 < |z\text{-Score}| < 3.0$  Ergebnis fragwürdig
- $|z\text{-Score}| \geq 3.0$  Ergebnis nicht zufriedenstellend

Hinweis: Bei der Bewertung mittels z-Score wird die Messunsicherheit der Teilnehmenden nicht berücksichtigt. Der Vergleich der Abweichung zum zugewiesenen Wert erfolgt über das Kriterium.

#### Interpretation der $E_n$ -Scores:

- $|E_n\text{-Score}| \leq 1.0$  zufriedenstellende Leistung
- $|E_n\text{-Score}| > 1.0$  nicht zufriedenstellende Leistung

Hinweis: Bei der Bewertung mittels  $E_n$ -Score erfolgt die Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheiten der Teilnehmenden und des zugewiesenen Wertes.  $|E_n\text{-Score}| > 1.0$  können darauf hinweisen, dass die Unsicherheitsschätzungen überprüft oder ein Messproblem korrigiert werden muss.

## D3. Darstellung und Interpretation der Messergebnisse

In der parameterorientierten Auswertung ist eine tabellarische Übersicht mit den Messergebnissen inklusive der Unsicherheit ( $\pm U$ ), der Wiederfindung zum zugewiesenen Wert und dem berechneten z-Score dargestellt. Weiterhin werden unter

Anmerkungen die Ausreißer gekennzeichnet. Die in der Tabelle angeführten Ergebnisse werden auch grafisch dargestellt.

In der labororientierten Auswertung werden pro Labor in anonymisierter Form die Ergebnisse der einzelnen Labore als Messergebnis  $\pm$  U sowie die Wiederfindungen und die ermittelten z-Scores bezugnehmend auf das Kriterium dargestellt. Weiters werden die E<sub>n</sub>-Scores unter Berücksichtigung der erweiterten Unsicherheiten in unabhängigen Tabellen ausgegeben. Die labororientierten Auswertungen enthalten jeweils die Bewertungsgrundlagen wie zugewiesener Wert samt erweiterter Messunsicherheit sowie das Kriterium.

Eine Erläuterung zu den Tabellen und Grafiken kann Punkt D5 entnommen werden.

#### **D4. Anmerkungen zur Auswertung**

Wie unter Punkt D2 ersichtlich, können die z-Scores auch unter Einbeziehung der Vergleichsstandardabweichung der ausreißerbereinigten Ergebnisse der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs berechnet werden. Das kann zur Folge haben, dass es bei Parametern mit hoher Ergebnistreuung dazu kommen kann, dass der Bereich z-Score - 2 bis z-Score + 2 einen ungewöhnlich hohen Wiederfindungsbereich abdeckt. Umgekehrt führt eine sehr geringe Streuung der Ergebnisse der Teilnehmenden dazu, dass z-Score - 2 bis z-Score + 2 einen ungewöhnlich kleinen Wiederfindungsbereich abdeckt.

Die Wiederfindungsrate wird unabhängig von der Streuung der Ergebnisse, als prozentuelle Abweichung vom zugewiesenen Wert berechnet und sollte bei der Bewertung von Ergebnissen im Rahmen des internen Qualitätsmanagementsystems der teilnehmenden Labore berücksichtigt werden.

Als Ergebnis einer Langzeitauswertung über die bisherigen Eignungsprüfungsrunden (2013–2021) in Realproben wurden Kriterien (RSDpool) zur Ergebnisbewertung berechnet. Diese wurden im Zuge der Auswertung den relativen Vergleichsstandardabweichungen (vR) des aktuellen Ringversuchs gegenübergestellt.

#### **Probe H114 A**

Bei den Parametern Aldrin, Summe Endosulfan, Summe Chlordan, Dieldrin, Lindan, Heptachlor, Summe DDD, Atrazin-desisopropyl, Atrazin-desethyl, Atrazin, Acetamiprid, Prometryn, Clothianidin, Thiacloprid, Imidacloprid, Bromacil, Thiamethoxam erfolgte die Berechnung der Scores nach D2.

Für Endrin und Propazin wurde die aktuelle Vergleichsstandardabweichung als Kriterium definiert (vR auf 2 signifikante Stellen gerundet).

Summe DDE, Cyanazin: Die auf Basis der Ergebnisse der Teilnehmenden berechneten Sollwerte lagen außerhalb der Messunsicherheit des Kontrollwertes und

es ist über das Kontrolllabor keine Rückführbarkeit möglich. Der zugewiesene Wert wurde daher über die ausreißerbereinigten Mittelwerte aus der Gruppe der akkreditierten Teilnehmenden berechnet. Bei Summe DDE wurde die Vergleichsstandardabweichung der Gruppe der akkreditierten Labore ohne Hampel-Ausreißer (H99) als Kriterium definiert, bei Cyanazin erfolgte die Berechnung der Scores nach D2 (RSD pooled).

Für die Summe DDT (H114 A) konnte aufgrund der zu hohen Streuungen zwischen den Ergebnissen der teilnehmenden Labore ( $vR > 50\%$ ) kein zugewiesener Wert festgelegt werden. Es wird im Rahmen der internen Qualitätssichernden Maßnahmen ein informativer Vergleich mit dem Mittelwert, berechnet aus den Ergebnissen der Gruppe der akkreditierten Labore ohne Hampel-Ausreißer (H95) empfohlen: Summe DDT MW (n=4): 0.184 +/- 0.0285 U(k=2) µg/l.

Dinotefuran, Nitenpyram: Bei diesen Parametern gab es nicht ausreichend Daten ( $n < 6$ ) um einen zugewiesenen Wert zu berechnen. Im Rahmen der internen Qualitätssichernden Maßnahmen wird ein informativer Vergleich mit dem Mittelwert der Ergebnisse der teilnehmenden Labore empfohlen:

Dinotefuran MW (n=2): 0.132 +/- 0.063 U(k=2) µg/l.

Nitenpyram MW (n=4): 0.0966 +/- 0.0545 U(k=2) µg/l.

### **Probe H114 B**

Bei den Parametern Aldrin, Summe Endosulfan, Summe Chlordan, Dieldrin, Lindan, Summe DDD, Atrazin-desisopropyl, Atrazin-desethyl, Atrazin, Acetamiprid, Cyanazin, Prometryn, Clothianidin, Thiacloprid, Bromacil, Thiamethoxam erfolgte die Berechnung der Scores nach D2.

#### **Endrin**

Die auf Basis der Ergebnisse der Teilnehmenden berechneten Sollwerte lagen außerhalb der Messunsicherheit des Kontrollwertes und es ist über das Kontrolllabor keine Rückführbarkeit möglich. Der zugewiesene Wert wurde daher über die ausreißerbereinigten Mittelwerte (H95) aus der Gruppe der akkreditierten Teilnehmenden berechnet und analog die Vergleichsstandardabweichung der Gruppe der akkreditierten Labore ohne Hampel-Ausreißer (H95) als Kriterium definiert.

Für Heptachlor (H114 B) wurde der Mittelwert über die Ergebnisse der teilnehmenden Labore ohne Hampel-Ausreißer (H95) ermittelt, die Berechnung der Scores erfolgte nach D2.

Für die Summe DDE und Summe DDT (H114 B) konnte aufgrund der zu hohen Streuungen zwischen den Ergebnissen der teilnehmenden Labore ( $vR > 50\%$ ) kein zugewiesener Wert festgelegt werden. Es wird im Rahmen der internen

Qualitätssichernden Maßnahmen ein informativer Vergleich mit dem Mittelwert, berechnet aus den Ergebnissen der Gruppe der akkreditierten Labore ohne Hampel-Ausreißer (H95) empfohlen:

Summe DDE MW (n=7): 0.423 +/- 0.177 U(k=2) µg/l.

Summe DDT MW (n=4): 0.469 +/- 0.0440 U(k=2) µg/l.

Dinotefuran, Nitenpyram: Bei diesen Parametern gab es nicht ausreichend Daten ( $n < 6$ ) um einen zugewiesenen Wert zu berechnen. Im Rahmen der internen Qualitätssichernden Maßnahmen wird ein informativer Vergleich mit dem Mittelwert der Ergebnisse der teilnehmenden Labore empfohlen:

Dinotefuran MW (n=2): 1.848 +/- 0.204 U(k=2) µg/l.

Nitenpyram MW (n=4): 2.11 +/- 0.966 U(k=2) µg/l.

Propazin: Die auf Basis der Ergebnisse der Teilnehmenden berechneten Sollwerte lagen außerhalb der Messunsicherheit des Kontrollwertes und es ist über das Kontrolllabor keine Rückführbarkeit möglich. Der zugewiesene Wert wurde daher über die ausreißerbereinigten Mittelwerte aus der Gruppe der akkreditierten Teilnehmenden berechnet, die Berechnung der Scores erfolgte nach D2.

## D5. Erläuterung zu Tabellen und Grafiken

### D5.1. Angaben und Abkürzungen in Tabellen

Parameter	Allgemeine Bezeichnung des Analysenparameters
Probe	Bezeichnung der übermittelten Probe
Einheit	Vorgegebene Einheit für Messwert und Ergebnisunsicherheit (z.B. µg/l)
Zugewiesener Wert	Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
U (k=2)	erweiterte Unsicherheit (k=2) des zugewiesenen Wertes, (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in der angegebenen Einheit (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium [%]	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in % des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 2 signifikante Stellen)
Mittelwert	Ausreißerbereinigter Mittelwert über die Ergebnisse der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen)


VB (99%)	99 % Vertrauensbereich (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Minimum	Minimales abgegebenes Messergebnis, ausreißerbereinigt (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Maximum	Maximales abgegebenes Messergebnis, ausreißerbereinigt (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
sR	Vergleichsstandardabweichung, berechnet aus den ausreißerbereinigten Ergebnissen der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
vR	relative Vergleichsstandardabweichung in %, berechnet aus den ausreißerbereinigten Ergebnissen der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs bezogen auf den Mittelwert (angegeben auf 2 signifikante Stellen)
Kontrollwert ± U (k=2)	Mittelwert der Kontrollmessungen des Veranstalters ± erweiterte Ergebnisunsicherheit des Kontrollwertes (jeweils angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Laborcode	anonymisierte, eindeutige Kennung des teilnehmenden Labors im jeweiligen Ringversuch
Messwert	einzelne(r) Messwert(e) lt. Angabe der Teilnehmenden (maximal 5 Nachkommastellen dargestellt)
Messergebnis	Für die Bewertung herangezogenes Ergebnis lt. Angabe der Teilnehmenden (maximal 5 Nachkommastellen dargestellt). Bei Eignungsprüfungsrounden mit Vorgabe von unabhängigen Mehrfachbestimmungen, entspricht dies dem berechneten Mittelwert aus den einzelnen Messwerten der Teilnehmenden.
± U	kombinierte Messunsicherheit ohne Erweiterungsfaktor (k=1) lt. Angabe der Teilnehmenden (maximal 5 Nachkommastellen dargestellt)
BG	Bestimmungsgrenze
NG	Nachweisgrenze
WF	Wiederfindungsrate in %, bezogen auf den zugewiesenen Wert (angegeben auf 3 signifikante Stellen, dargestellt maximal 1 Nachkommastelle)
MW	Mittelwert
z-Score	Abweichung des Messergebnisses zum zugewiesenen Wert, ausgedrückt als Vielfaches des Kriteriums (angegeben auf 3 signifikante Stellen, dargestellt maximal 2 Nachkommastellen)
E <sub>n</sub> -Score	Abweichung des Messergebnisses zum zugewiesenen Wert, ausgedrückt als Vielfaches der kombinierten

	Messunsicherheiten, bestehend aus erweiterter Unsicherheit des zugewiesenen Wertes und der erweiterten Unsicherheit der Messergebnisse der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen, dargestellt maximal 2 Nachkommastellen). Beim $E_n$ -Score erfolgt die Berücksichtigung der Messunsicherheit der Teilnehmenden.
- Anmerkungen	Keine Daten übermittelt bzw. keine Berechnung möglich Anmerkungen zum jeweiligen Messergebnis (z.B. H, FN, FP)
H	Ausreißer nach dem Hampel-Test
FN	Falsch negativ – Messergebnis kleiner Bestimmungs- bzw. Nachweisgrenze dessen Betrag die Bedingungen eines Ausreißers nach dem Hampeltest erfüllt.
FP	Falsch positiv – Falls aufgrund des geringen Analytgehalts kein zugewiesener Wert ermittelt werden kann ( $n < 6$ ), wird der Median der Beträge der übermittelten Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenzen ermittelt. Als falsch positiv wird ein Messergebnis bewertet, welches diesen Median um mehr als 100 % übersteigt.
Standardabweichung	Vergleichsstandardabweichung berechnet aus den Ergebnissen der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
rel. Standardabweichung	relative Vergleichsstandardabweichung in %, berechnet aus den Ergebnissen der Teilnehmenden des aktuellen Ringversuchs bezogen auf den Mittelwert (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
n	Anzahl der Messergebnisse
*	Kennzeichnung für Hinweise zur Erläuterung
**	Kennzeichnung für Parameter außerhalb der Akkreditierung gemäß EN ISO/IEC 17043

## D5.2. Graphische Darstellung der Ergebnisse


Nachfolgend wird die graphische Darstellung anhand von kommentierten Beispieldiagrammen erläutert.

### Beispieldiagramm: Messwerte

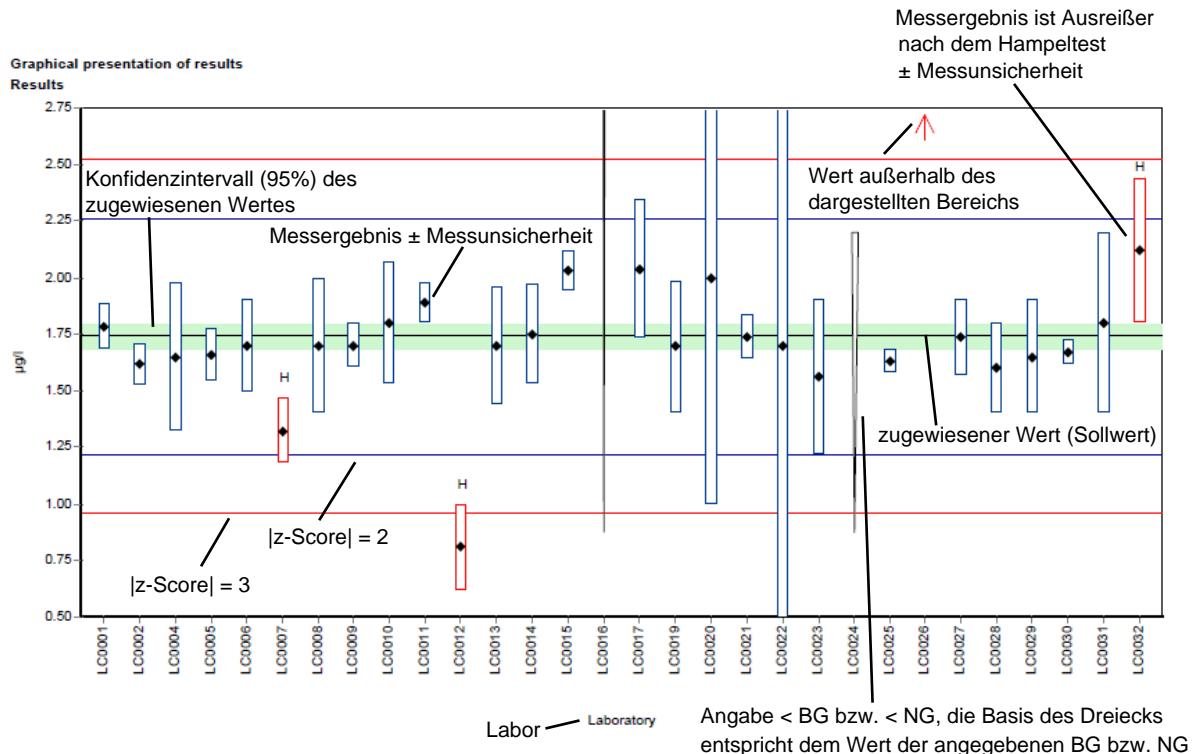


Unterschiedliche Analysenmethoden werden mit unterschiedlichen Farben kenntlich gemacht.

### Beispieldiagramm: Wiederfindung zum zugewiesenen Wert

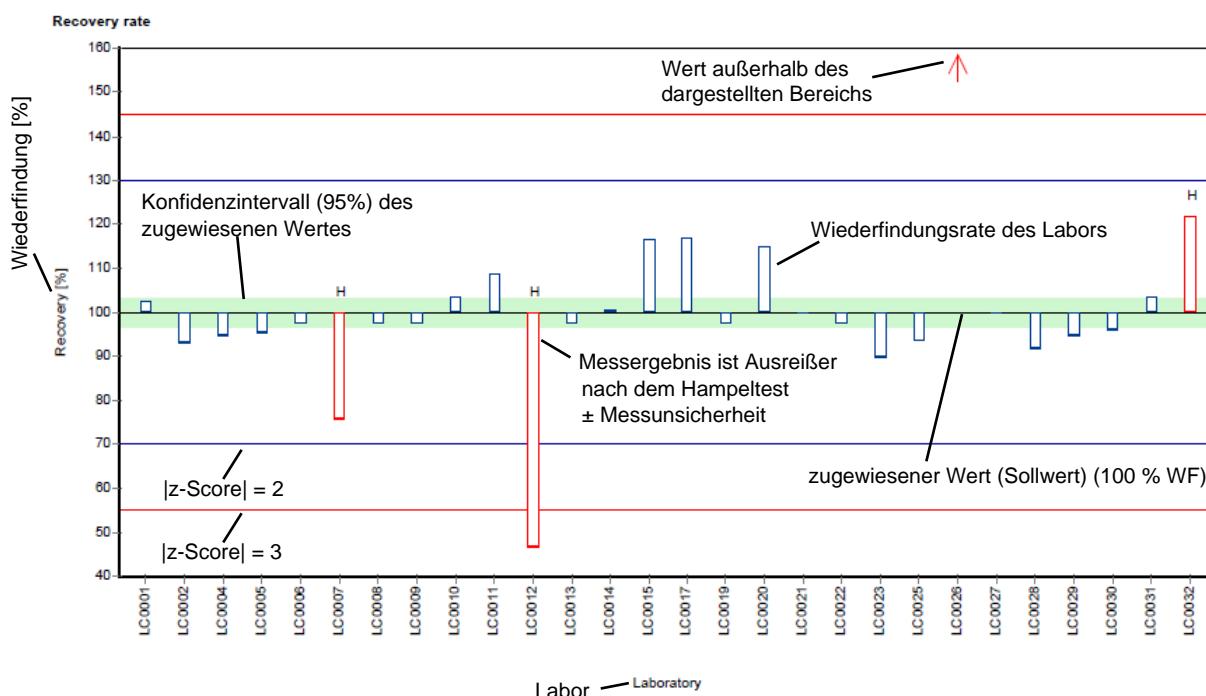


Unterschiedliche Analysenmethoden werden mit unterschiedlichen Farben kenntlich gemacht.

### Beispieldiagramm: z-Score

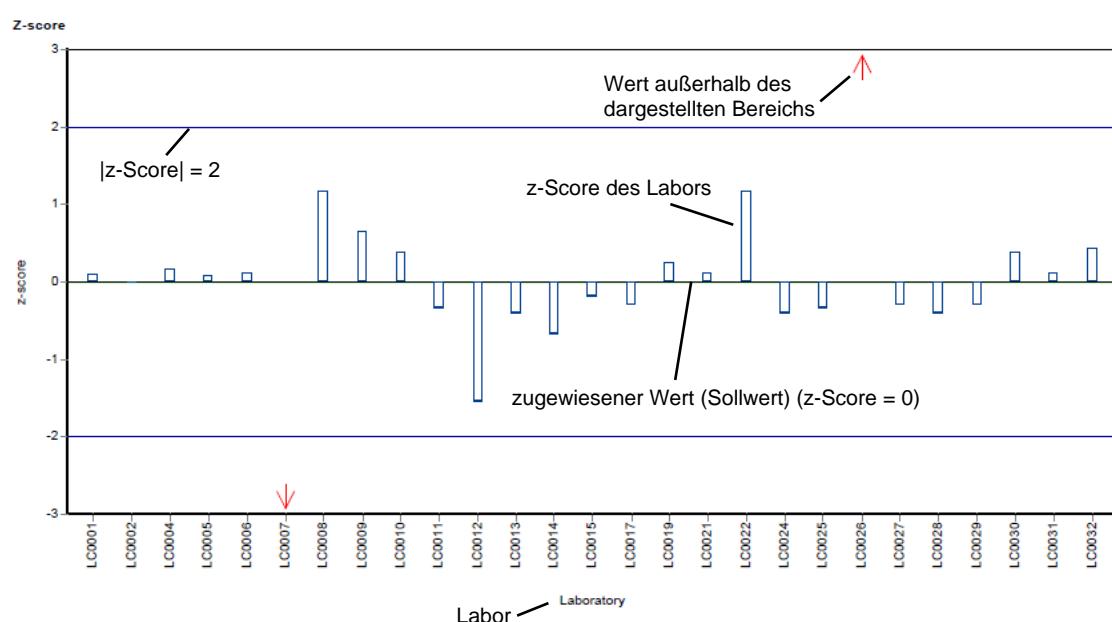


Unterschiedliche Analysenmethoden werden mit unterschiedlichen Farben kenntlich gemacht.

### Beispieldiagramm: z-Score (labororientierte Auswertung)

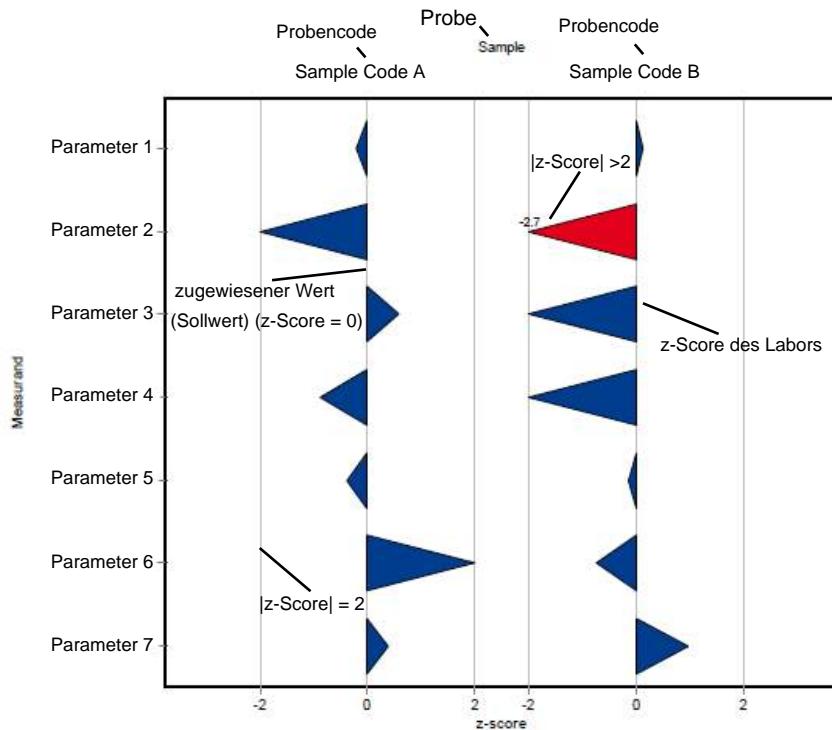

### Beispieldiagramm: En-Score (labororientierte Auswertung)

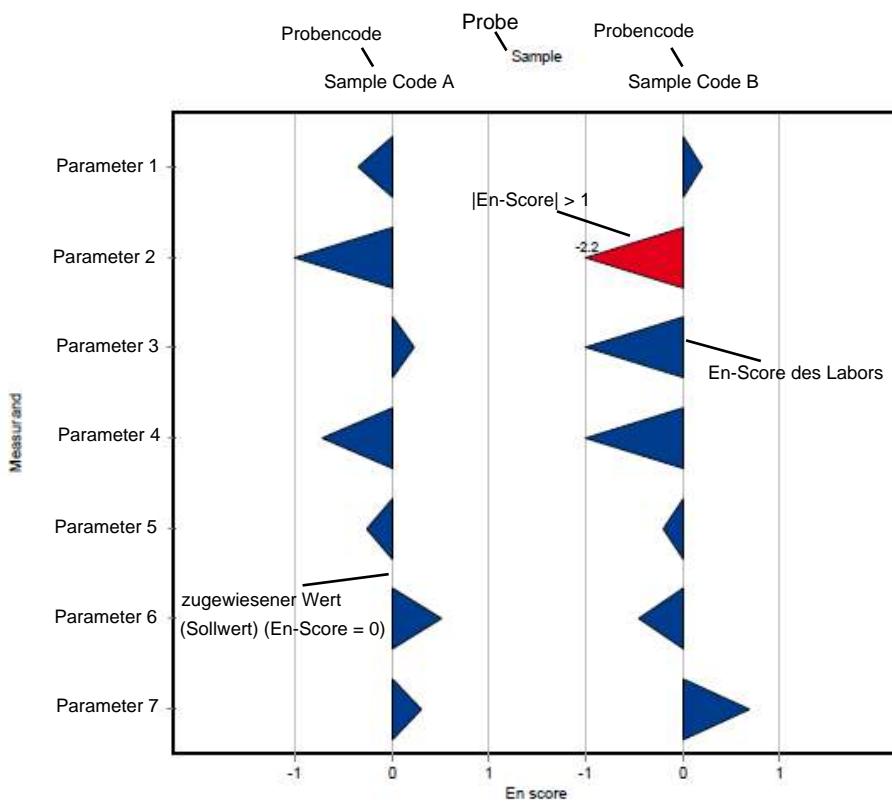

## D6. Zusammenfassung

### D6.1. Tabelle der zugewiesenen Werte

Parameter	Probe	Einheit	zugewiesener Wert	±	U (k=2)	Kriterium	Kriterium [%]
Acetamiprid	H114 A	µg/l	0.405	±	0.0168	0.0405	10
	H114 B	µg/l	1.22	±	0.0754	0.122	10
Aldrin	H114 A	µg/l	0.137	±	0.0149	0.0412	30
	H114 B	µg/l	0.674	±	0.0955	0.202	30
Atrazin	H114 A	µg/l	0.211	±	0.0115	0.0232	11
	H114 B	µg/l	1.89	±	0.163	0.208	11
Atrazin-Desethyl	H114 A	µg/l	0.225	±	0.0125	0.027	12
	H114 B	µg/l	2.12	±	0.139	0.254	12
Atrazin-Desisopropyl	H114 A	µg/l	0.303	±	0.023	0.0424	14
	H114 B	µg/l	2.28	±	0.151	0.32	14
Bromacil	H114 A	µg/l	0.222	±	0.0115	0.0311	14
	H114 B	µg/l	1.77	±	0.171	0.248	14
Clothianidin	H114 A	µg/l	0.123	±	0.0024	0.0135	11
	H114 B	µg/l	1.89	±	0.180	0.208	11
Cyanazin	H114 A	µg/l	0.195	±	0.0139	0.0274	14
	H114 B	µg/l	2.81	±	0.19	0.393	14
Dieldrin	H114 A	µg/l	0.174	±	0.0139	0.04	23
	H114 B	µg/l	0.487	±	0.0518	0.112	23
Dinotefuran*	H114 A	µg/l	-	±	-	-	-
	H114 B	µg/l	-	±	-	-	-
Endrin	H114 A	µg/l	0.147	±	0.0363	0.0543	37
	H114 B	µg/l	0.428	±	0.0902	0.111	26
Heptachlor	H114 A	µg/l	0.108	±	0.0312	0.0433	40
	H114 B	µg/l	0.349	±	0.0655	0.14	40
Imidacloprid	H114 A	µg/l	0.419	±	0.0225	0.0628	15
	H114 B	µg/l	2.18	±	0.116	0.327	15
Lindan (Gamma-HCH)	H114 A	µg/l	0.135	±	0.00809	0.0269	20
	H114 B	µg/l	0.729	±	0.0329	0.146	20
Nitenpyram*	H114 A	µg/l	-	±	-	-	-
	H114 B	µg/l	-	±	-	-	-
Prometryn	H114 A	µg/l	0.237	±	0.00991	0.0308	13
	H114 B	µg/l	2.24	±	0.107	0.291	13
Propazin	H114 A	µg/l	0.06	±	0.00973	0.0174	29
	H114 B	µg/l	2.02	±	0.141	0.262	13
Summe Chlordan	H114 A	µg/l	0.0674	±	0.00891	0.0202	30
	H114 B	µg/l	0.639	±	0.136	0.192	30
Summe DDD	H114 A	µg/l	0.251	±	0.0259	0.0752	30
	H114 B	µg/l	0.623	±	0.105	0.187	30
Summe DDE*	H114 A	µg/l	0.233	±	0.0583	0.0769	33
	H114 B	µg/l	-	±	-	-	-
Summe DDT*	H114 A	µg/l	-	±	-	-	-
	H114 B	µg/l	-	±	-	-	-
Summe Endosulfan	H114 A	µg/l	0.228	±	0.0326	0.0933	41
	H114 B	µg/l	0.666	±	0.14	0.273	41
Thiacloprid	H114 A	µg/l	0.102	±	0.0048	0.0142	14
	H114 B	µg/l	2.39	±	0.113	0.334	14
Thiamethoxam	H114 A	µg/l	0.122	±	0.0083	0.0208	17
	H114 B	µg/l	2.07	±	0.102	0.352	17

\*Aufgrund einer geringen Anzahl an übermittelten gültigen Ergebnissen der Teilnehmenden (Dinotefuran, Nitrenpyram) oder einer zu hohen Streuung zwischen den Ergebnissen der teilnehmenden Labore (Summe DDT, Summe DDE) ist die Festlegung eines zugewiesenen Wertes nicht möglich.

Für nachfolgende Substanzen sind zur Information die berechneten Mittelwerte MW +/- U(k=2) über die Daten der akkreditierten Labore (n) angeführt. Diese können zum Vergleich im Rahmen Ihrer QS-Maßnahmen herangezogen werden.

Dinotefuran:

H114 A: (n=2) 0.132 +/- 0.063 µg/l U(k=2)

H114 B: (n=2) 1.848 +/- 0.204 µg/l U(k=2)

Nitenpyram:

H114 A: (n=4) 0.0966 +/- 0.0545 µg/l U(k=2)

H114 B: (n=4) 2.11 +/- 0.966 µg/l U(k=2)

Summe DDT:

H114 A: (n=4) 0.184 +/- 0.0285 µg/l U(k=2)

H114 B: (n=4) 0.469 +/- 0.0440 µg/l U(k=2)

Summe DDE:

H114 B: (n=7) 0.423 +/- 0.177 µg/l U(k=2)

## D6.2. Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

Parameter	Probe	Anzahl Labors für Berechnung	Anzahl Ausreißer Labors	Einheit	Mittelwert	± VB (99%)	Minimum	Maximum	sR	vR [%]
Acetamiprid	H114 A	7	1	µg/l	0.405	± 0.0252	0.361	0.429	0.0222	5.5
	H114 B	7	1	µg/l	1.22	± 0.113	1.03	1.35	0.0998	8.2
Aldrin	H114 A	8	3	µg/l	0.137	± 0.0224	0.094	0.155	0.0211	15
	H114 B	9	2	µg/l	0.674	± 0.143	0.438	0.858	0.143	21
Atrazin	H114 A	13	1	µg/l	0.211	± 0.0173	0.18	0.246	0.0208	9.9
	H114 B	12	1	µg/l	1.89	± 0.244	1.18	2.2	0.282	15
Atrazin-Desethyl	H114 A	13	1	µg/l	0.225	± 0.0188	0.193	0.279	0.0226	10
	H114 B	13	1	µg/l	2.12	± 0.209	1.72	2.63	0.251	12
Atrazin-Desisopropyl	H114 A	14	0	µg/l	0.303	± 0.0345	0.22	0.368	0.043	14
	H114 B	14	0	µg/l	2.28	± 0.226	1.73	2.7	0.282	12
Bromacil	H114 A	14	0	µg/l	0.222	± 0.0173	0.198	0.272	0.0215	9.7
	H114 B	13	0	µg/l	1.77	± 0.256	1.18	2.22	0.307	17
Clothianidin	H114 A	7	4	µg/l	0.123	± 0.0036	0.119	0.127	0.00318	2.6
	H114 B	9	1	µg/l	1.89	± 0.269	1.53	2.23	0.269	14
Cyanazin	H114 A	11	0	µg/l	0.194	± 0.0197	0.169	0.23	0.0217	11
	H114 B	11	0	µg/l	2.81	± 0.285	2.45	3.35	0.315	11
Dieldrin	H114 A	10	2	µg/l	0.174	± 0.0208	0.135	0.219	0.022	13
	H114 B	12	0	µg/l	0.487	± 0.0777	0.317	0.63	0.0897	18
Dinotefuran	H114 A	2	0	µg/l	-	± -	0.1	0.163	-	-
	H114 B	2	0	µg/l	-	± -	1.75	1.95	-	-
Endrin	H114 A	9	0	µg/l	0.147	± 0.0545	0.053	0.224	0.0545	37
	H114 B	8	1	µg/l	0.441	± 0.105	0.245	0.531	0.0992	22
Heptachlor	H114 A	11	1	µg/l	0.108	± 0.0467	0.009	0.175	0.0517	48
	H114 B	9	2	µg/l	0.349	± 0.0982	0.229	0.546	0.0982	28
Imidacloprid	H114 A	12	1	µg/l	0.419	± 0.0338	0.371	0.477	0.039	9.3
	H114 B	11	1	µg/l	2.18	± 0.173	1.97	2.5	0.192	8.8
Lindan (Gamma-HCH)	H114 A	9	2	µg/l	0.135	± 0.0121	0.112	0.151	0.0121	9
	H114 B	9	2	µg/l	0.729	± 0.0494	0.636	0.81	0.0494	6.8
Nitenpyram	H114 A	4	0	µg/l	-	± -	0.0164	0.138	-	-
	H114 B	4	0	µg/l	-	± -	0.681	2.8	-	-
Prometryn	H114 A	9	3	µg/l	0.237	± 0.0149	0.22	0.266	0.0149	6.3

Parameter	Probe	Anzahl Labors für Berechnung	Anzahl Ausreißer Labors	Einheit	Mittelwert	± VB (99%)	Minimum	Maximum	sR	vR [%]
Prometryn	H114 B	8	4	µg/l	2.24	± 0.16	2.12	2.58	0.151	6.8
Propazin	H114 A	13	0	µg/l	0.06	± 0.0146	0.033	0.107	0.0175	29
	H114 B	11	2	µg/l	1.97	± 0.238	1.5	2.31	0.263	13
Summe Chlordan	H114 A	6	1	µg/l	0.0674	± 0.0134	0.054	0.083	0.0109	16
	H114 B	7	0	µg/l	0.639	± 0.205	0.291	0.83	0.181	28
Summe DDD	H114 A	7	0	µg/l	0.251	± 0.0388	0.208	0.293	0.0342	14
	H114 B	6	1	µg/l	0.623	± 0.158	0.435	0.822	0.129	21
Summe DDE	H114 A	8	1	µg/l	0.237	± 0.0767	0.091	0.328	0.0723	31
	H114 B	9	0	µg/l	0.494	± 0.262	0.017	0.921	0.262	53
Summe DDT	H114 A	6	1	µg/l	0.2	± 0.136	0.143	0.3995	0.111	56
	H114 B	8	0	µg/l	0.449	± 0.292	0.029	0.89	0.275	61
Summe Endosulfan	H114 A	9	1	µg/l	0.228	± 0.0489	0.15	0.306	0.0489	21
	H114 B	9	0	µg/l	0.666	± 0.21	0.206	0.915	0.21	32
Thiacloprid	H114 A	15	0	µg/l	0.102	± 0.0072	0.0852	0.118	0.00929	9.1
	H114 B	13	1	µg/l	2.39	± 0.17	1.94	2.6	0.204	8.5
Thiamethoxam	H114 A	12	1	µg/l	0.122	± 0.0124	0.0854	0.14	0.0144	12
	H114 B	10	2	µg/l	2.07	± 0.153	1.8	2.35	0.161	7.8

## **E1. Description of the proficiency test**

### **E1.1. Design and implementation**

- Number of registrations: 19
- Number of submitted data records: 19
- Dispatch of samples: October 11<sup>th</sup>, 2022
- Closing date for submission of data: November 15<sup>th</sup>, 2022

The results were submitted electronically by a password-protected online data entry. Upon completion of the data entry, the participant confirmed the complete and correct entry of all data and the authorization of the results for evaluation.

To anonymize results, each laboratory was given a laboratory code on a random basis.

### **E1.2. Description of the proficiency test items**

The sampling of ground water and surface water was carried out each on October 6<sup>th</sup>, 2022.

The following samples were made available

- 1 sample ground water (H114 A)
- 1 sample surface water (H114 B)

Both samples were stored at 4 +/- 3°C until further processing. The samples were filtered (40 µm) and partly spiked with specific substances in the stirring vessel.

The samples were filled into bottles under continuous stirring (stirring vessel) and stabilized by cooling.

The homogeneous proficiency test items were dispatched on October 11<sup>th</sup>, 2022.

All participating laboratories received (depending on the order):

- 2 samples (each 600 ml), filled in 2 x 300 ml aluminium bottles or
- 2 samples (each 2000 ml), filled in 2 x 1000 ml aluminium bottles or
- 2 samples (each 4000 ml), filled in 4 x 1000 ml aluminium bottles.

### **E1.3. Instructions for the participants**

For reasons of stability, it was recommended to start the analysis by the 19<sup>th</sup> of October 2022 at the latest.

The participants are expected to use the test method or measurement method of their choice, which should be consistent with their routine procedures. In E9 you will find the overview of applied methods in course of the proficiency testing.

#### **E1.4. Control testing for homogeneity evaluation**

During filling of the bottles, aliquots of each sample were collected randomly for control testing. From each of the samples A and B, n=5 control test samples and n=1 unspiked real water sample were transferred to the laboratory for control testing.

All parameters were analysed in the testing laboratory at the Environment Agency Austria (Prüfstelle für Umwelt-, GVO- & Treibstoffanalytik, accredited acc. to EN ISO/IEC 17025 for the parameters listed) close to the time of sample dispatch.

During evaluation the relative standard deviation between the individual results of the control test samples was assessed for each parameter by comparison with the reproducibility standard deviation of the actual proficiency test.

In the parameter-oriented evaluation (E7), the results of the control testing are given in the form of arithmetic means of the detected concentrations  $\pm$  expanded measurement uncertainty as control test value  $\pm U$  (expanded uncertainty, k=2).

#### **E1.5. Trend test for stability evaluation**

The evaluation of stability of the proficiency test items was performed using the data statistics of the results of previous proficiency testing rounds for real water samples of the period from 2013 to 2021.

The assessment of the stability of the proficiency test items of the current round was carried out by evaluation of all participant results sorted by analysis date (until submission deadline): No systematic trends were identified.

Using all participants results, it was furthermore tested if systematic trends could be detected depending on the order in which the bottles were filled for the proficiency test: No systematic trends could be identified.

According to data obtained from previous rounds for real water samples from 2013 to 2021 and based on the trend test evaluation of the current round, the stability of the test items for proficiency testing of real water samples can be confirmed for the recommended analysis period until deadline for submission of data.

## E1.6. Determination of the assigned values

The analytical results had to be made available to the organiser not later than 15<sup>th</sup> of November 2022. Any values received at a later date were not considered.

In the course of the plausibility assessment of all received data (e.g. check for correct units, indication of measurement uncertainty, ...) the participants with noticeable results were asked to perform a subsequent data check and to give a prompt feedback within 24 h.

After plausibility assessment an outlier test according to Hampel was performed to identify outliers. Values identified as conspicuous are marked specifically in the parameter-oriented evaluation ('H').

In justified cases, for instance, when the outlier test according to Hampel is not applicable (e.g. many similar or identical results of the participants or in case of a very limited number of highly scattering results) a different outlier identification method can be applied (e.g. Dean and Dixon outlier test or manual outlier elimination by expert judgement). In such a case, this procedure is documented in section E4 of the report.

Further data evaluation was performed in accordance with ISO 5725-2. A statistical evaluation of proficiency testing data was only carried out if at least 6 valid results per parameter were available. Results < LOQ or < LOD are not included in the calculation for the assigned value.

The assigned values are normally calculated as the mean over all submitted results, after removal of outliers.

For real water samples in some exceptional cases it might occur, that no assigned value based on participants' results can be calculated and no evaluation of the participants results can be made. E.g due to large variations in the participant results ( $\text{vR} > 50\%$ ) and/or insufficient traceability of the calculated mean of all participants after outlier-clearing to the mean of control testing or if the number of results (without outliers) of the group of accredited testing laboratories is too low.

In this case, a clear statement in section E7 of the report is made and all provided statistical data are for information only. In section E4 further information is given, when applicable, for each parameter and proficiency test item. In course of the internal quality measures, the participants can compare their results with the control test values.

## E2. Criteria of performance evaluation

### E2.1. Performance criterion z-Score

The adjusted average value (after removal of outliers) for all submitted results was used as a basis for the calculation of recovery rates and z-scores.

z-Scores were calculated on the basis of the following formula:

$$z\text{-score} = \frac{x_i - \bar{X}}{\text{Criteria}}$$

In this context,

$x_i$	is the measurement value (result) of the participating laboratory;
$\bar{X}$	assigned value the target value for the assessment of the performance of the participants (3 significant digits), normally the average value of the participants' results after removal of outliers; if this approach is not applicable, the target value is assigned according to the procedure given in section E4
Criteria	is the reproducibility standard deviation calculated from previous rounds for proficiency testing for real water samples from 2013 to 2021 (as RSD pooled) or from the participants' results after removal of outliers (sR) in the current round (if less than 6 previous rounds for the parameters of real water samples A and B are available). Where justified (e.g. results for real water samples are close to minimum quantification limit or in case of regulatory requirements) the criteria is defined by expert judgement and the procedure is clearly described in section E4 of the report.

### E2.2. Performance criterion E<sub>n</sub>-Score

Since 2019 additional assessment of the participants' results using E<sub>n</sub>-Scores for proficiency testing of real water samples is performed. This additional assessment takes into account the expanded measurement uncertainties of the participants results and the expanded uncertainty of the assigned value and is provided in the laboratory oriented part of the report (see E8 after the z-scores evaluation).

E<sub>n</sub>-Scores were calculated on the basis of the following formula:

$$E_n\text{-score} = \frac{x_i - \bar{X}}{\sqrt{U(x_i)^2 + U(\bar{X})^2}}$$

In this context,

$x_i$	is the measurement value (result) of the participating laboratory
$\bar{X}$	assigned value the target value for the assessment of the performance of the participants (3 significant digits), normally the average value of the participants' results after removal of outliers; if this approach is not applicable, the target value is assigned according to the procedure given in section E4
$U(x_i)$	expanded measurement uncertainty for the result of the participating laboratory, $k=2$
$U(\bar{X})$	expanded measurement uncertainty for the assigned value, $k=2$

### E2.3. Performance evaluation z-Score and $E_n$ -Score

#### Interpretation of z-Scores:

- $|z\text{-Score}| \leq 2.0$  good result
- $2.0 < |z\text{-Score}| < 3.0$  questionable result
- $|z\text{-Score}| \geq 3.0$  unsatisfactory result

Note: In case of assessment of the participants' performance by z-scores the measurement uncertainty of the participants' results is not taken into account. The difference between result of participants and the assigned value is evaluated by the criteria.

#### Interpretation of $E_n$ -Scores:

- $|E_n\text{-Score}| \leq 1.0$  satisfactory performance
- $|E_n\text{-Score}| > 1.0$  unsatisfactory performance

Note: In case of assessment of the participants' performance by  $E_n$ -Scores the expanded measurement uncertainties for the results and for the assigned values are taken into account.  $|E_n\text{-Score}| > 1.0$  might indicate to check the measurement uncertainty estimation or might point out to correct a measurement problem.

## E3. Representation and interpretation of measurement results

The parameter-oriented report provides the measurement values (results) including uncertainty ( $\pm U$ ), recovery rate, calculated z-Score and the outliers in tabular form. The results listed in the table are also represented graphically.

The laboratory oriented report shows the results of the individual laboratories (anonymous), including the measurement uncertainty ( $\pm U$ ), recovery rates, z-Scores and additionally evaluation of  $E_n$ -Scores on separate pages.

The tables also contain the basis for the data assessment as the assigned values and expanded measurement uncertainties and the criteria.

An annotation of the tables and graphics is given in section E5.

## **E4. Explanatory notes**

As explained in section E2, the z-Score can also be calculated using the reproducibility standard deviation, calculated from the participants' results (after removal of outliers) in the relevant test round. It might occur that the z-Score between -2 and 2 covers a large range of measurement values when the variance of the results is high. On the other hand, the range of good results can be very narrow, when the variation of the participants' results is small.

The recovery rate is calculated for the individual result based on the assigned value and is thus independent of the reproducibility standard deviation. In the case of a high variance of the results, participants should also consider recovery rates as additional criteria to decide on the necessity of internal quality assurance measures.

As a result of a long-term evaluation of previous proficiency testing rounds (2013–2021) in real samples, evaluation criteria (RSDpool) were calculated.

These criteria were compared with the relative reproducibility standard deviation (vR) of the current proficiency testing.

### **Sample H114 A**

For the parameters aldrin, sum endosulfan, sum chlordane, dieldrin, lindane, heptachlor, sum DDD, atrazine-desisopropyl, atrazine-desethyl, atrazine, acetamiprid, prometryn, clothianidin, thiacloprid, imidacloprid, bromacil, thiamethoxam the scores were calculated according to E2.

For endrin and propazine the reproducibility standard deviation (vR) of the actual proficiency testing round was defined as the criterion (vR rounded to 2 significant digits).

Sum DDE, cyanazine: The assigned values calculated based on the participants results were outside the measurement uncertainty of the control test value and thus traceability could not be proven by this procedure. Therefore, new assigned values were defined by the group of participating laboratories after outlier-assessment. For sum DDE, the reproducibility standard deviation of the group of accredited laboratories without Hampel-outliers (H99) was defined as criterion, for cyanazine the calculation of the scores was done according to E2 (RSD pooled).

For the sum DDT (H114 A) no assigned value could be determined due to the too high scatter between the results of the participating laboratories ( $vR > 50\%$ ). For this

parameter we recommend to compare your results with the calculated mean of the group of accredited laboratories without Hampel-outliers (H95) in course of your internal quality assurance measures (QA):

Sum DDT MV (n=4): 0.184 +/- 0.0285 U(k=2) µg/l.

Dinotefuran, Nitenpyram: Assigned values could not be calculated because of the small number of submitted valid results (n < 6).

For these parameters we recommend to compare your results with the mean of the results of the participating laboratories:

Dinotefuran MV (n=2): 0.132 +/- 0.063 U(k=2) µg/l.

Nitenpyram MV (n=4): 0.0966 +/- 0.0545 U(k=2) µg/l.

### **Sample H114 B**

For the parameters aldrin, sum endosulfan, sum chlordane, dieldrin, lindane, sum DDD, atrazine-desisopropyl, atrazine-desethyl, atrazine, acetamiprid, cyanazine, prometryn, clothianidin, thiacloprid, bromacil, thiamethoxam the scores were calculated according to E2.

Endrin: The assigned values calculated based on the participants results were outside the measurement uncertainty of the control test value and thus traceability could not be proven by this procedure. Therefore, a new assigned value was defined by the group of accredited participating laboratories after outlier-assessment (H95) and analogously the reproducibility standard deviation of the group of accredited laboratories without Hampel-outliers (H95) was defined as criterion.

For Heptachlor (H114 B) the mean value was calculated based on all results of participating laboratories without Hampel-outliers (H95), the scores were calculated according to E2.

For the parameters sum DDE and sum DDT (H114 B) no assigned values could be determined due to the too high scatter between the results of the participating laboratories ( $vR > 50\%$ ). For these parameters we recommend to compare your results with the calculated mean of the group of accredited laboratories without Hampel-outliers (H95) in course of your internal quality assurance measures (QA):

Sum DDE MV (n=7): 0.423 +/- 0.177 U(k=2) µg/l.

Sum DDT MV (n=4): 0.469 +/- 0.0440 U(k=2) µg/l.

Dinotefuran, Nitenpyram: Assigned values could not be calculated because of the small number of submitted valid results (n < 6).

For these parameters we recommend to compare your results with the mean of the results of the participating laboratories:

Dinotefuran MV (n=2): 1.848 +/- 0.204 U(k=2) µg/l.

Nitenpyram MV (n=4): 2.11 +/- 0.966 U(k=2) µg/l.

Propazine: The assigned values calculated based on the participants results were outside the measurement uncertainty of the control test value and thus traceability could not be proven by this procedure. Therefore, a new assigned value was defined by the group of accredited participating laboratories after outlier-assessment and scores were calculated according to E2.

## E5. Annotations on tables and charts

### E5.1. Information and abbreviations in tables


Parameter	Analyte identifier
Sample	Sample identifier
Unit	Given unit for result and uncertainty (e.g. µg/l)
Assigned value	Target value for proficiency assessment of the participants (3 significant digits)
U (k=2)	Expanded uncertainty (k=2) of the assigned value (3 significant digits)
Criteria	Specified value for the determination of the z-score in the given unit (3 significant digits)
Criteria [%]	Specified value for the determination of the z-score in % of the assigned value (2 significant digits)
Mean	Mean of the participants results, without outliers (3 significant digits)
CI (99 %)	99 % confidence interval (3 significant digits)
Minimum	Minimum of all submitted results, after removal of outliers (3 significant digits)
Maximum	Maximum of all submitted results, after removal of outliers (3 significant digits)
SD	Reproducibility standard deviation, calculated from the participants results, after removal of outliers (3 significant digits)
RSD %	Reproducibility standard deviation, calculated from the participants results relative to the target value, given in %, after removal of outliers (2 significant digits)
Control test value ±	Mean of control test value ± expanded measurement uncertainty (3 significant digits)
U (k=2)	Laboratory identifier (anonymized)
Labcode	Result as indicated by participant (max. 5 decimal places)
Result	

$\pm U$	combined measurement uncertainty without expansion factor ( $k=1$ ), as indicated by participant (max. 5 decimal places)
LOQ	Limit of quantification
LOD	Limit of detection
Recovery	Recovery rate in % based on assigned value (target value) (3 significant digits, max. one decimal place given)
z-Score	Deviation of result based on the assigned value (target value) given as a multiple of the criteria (3 significant digits, max. 2 decimal places given)
$E_n$ -Score	Deviation of result based on the assigned value (target value) given as a multiple of the combined expanded measurement uncertainty of the participant's results and expanded measurement uncertainty for the assigned value (3 significant digits, max. 2 decimal places given). Note: $E_n$ -Score assessment takes into account the measurement uncertainty of the participants.
-	No data available or no calculation possible
Comments	Comment on the respective result (e.g. H, FN, FP)
H	Outlier according to Hampel-Test
FN	False negative – for a result < LOQ or result < LOD: The absolute value of the LOQ or LOD fulfils the condition of an outlier according to the Hampel test.
FP	False positive – for parameters where no target value is available because of a too low analyte content ( $n < 6$ ): Result that exceeds the median of the absolute values of the transmitted LOQs or LODs by more than 100 %.
Standard deviation	Reproducibility standard deviation, calculated from the participants results (3 significant digits)
Rel. standard deviation	Reproducibility standard deviation, calculated from the participants results relative to the target value, given in %, (3 significant digits)
n	Number of results
*	mark for additional comments
**	mark for parameters outside the scope of accreditation according to EN ISO/IEC 17043

## E5.2. Graphical presentation of results


The graphic representation in the report is explained below by means of commented example diagrams:

### Example chart: Results

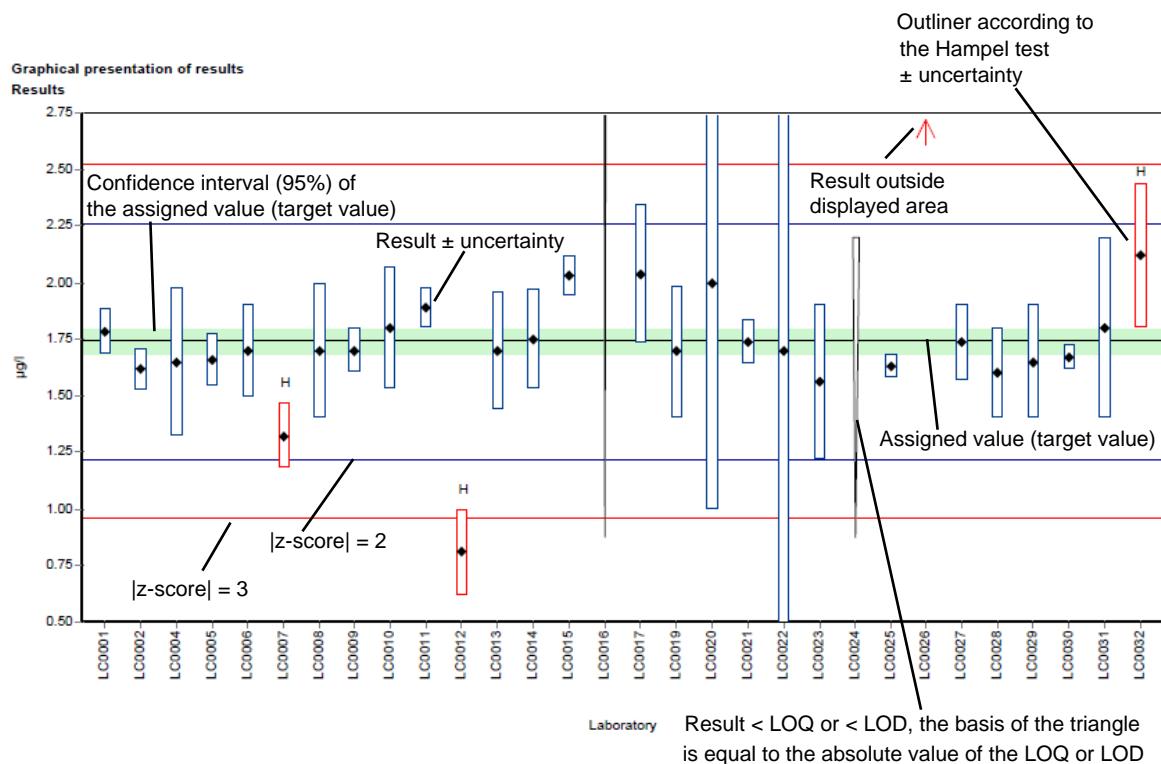


Different analysis methods are represented with different colors.

### Example chart: Recovery

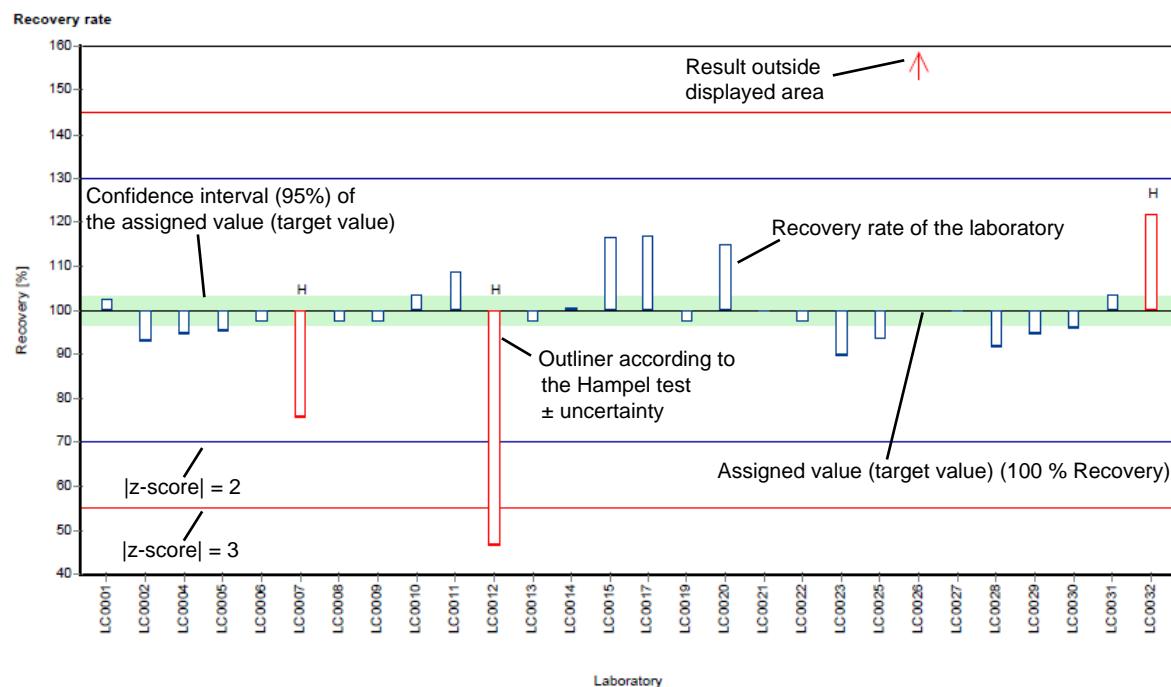


Different analysis methods are represented with different colors.

### Example chart: z-score

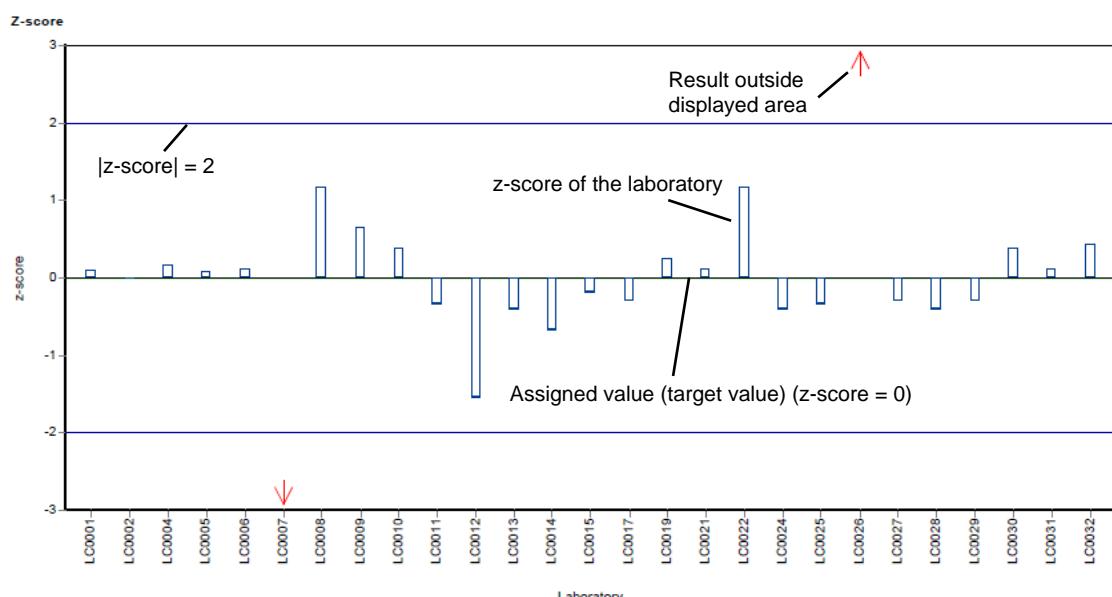


Different analysis methods are represented with different colors.

**Example chart: z-score (laboratory oriented report)**

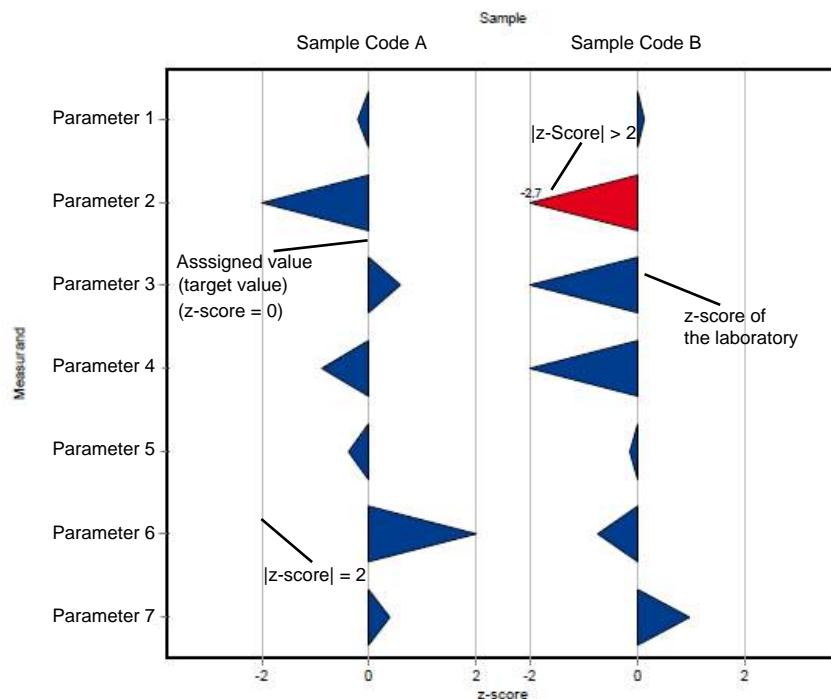

**Example chart: En-score (laboratory oriented report)**

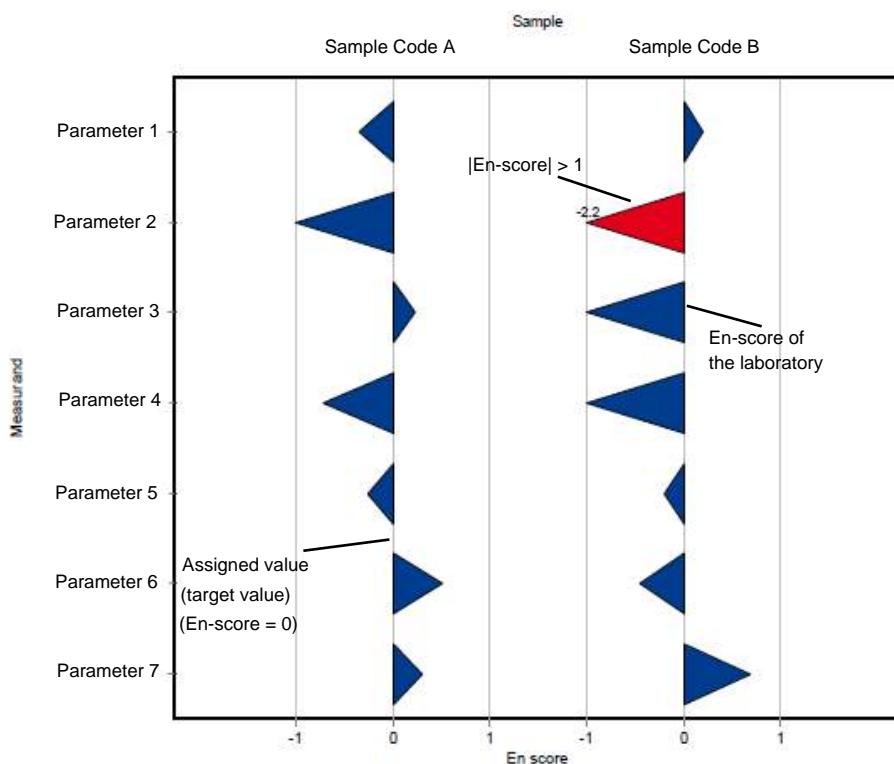

## E6. Summary

### E6.1. Table of assigned values

Parameter	Sample	Unit	Assigned value ±	U (k=2)	Criterion	Criterion [%]
Acetamiprid	H114 A	µg/l	0.405 ±	0.0168	0.0405	10
	H114 B	µg/l	1.22 ±	0.0754	0.122	10
Aldrin	H114 A	µg/l	0.137 ±	0.0149	0.0412	30
	H114 B	µg/l	0.674 ±	0.0955	0.202	30
Atrazine	H114 A	µg/l	0.211 ±	0.0115	0.0232	11
	H114 B	µg/l	1.89 ±	0.163	0.208	11
Atrazine-desethyl	H114 A	µg/l	0.225 ±	0.0125	0.027	12
	H114 B	µg/l	2.12 ±	0.139	0.254	12
Atrazine-desisopropyl	H114 A	µg/l	0.303 ±	0.023	0.0424	14
	H114 B	µg/l	2.28 ±	0.151	0.32	14
Bromacil	H114 A	µg/l	0.222 ±	0.0115	0.0311	14
	H114 B	µg/l	1.77 ±	0.171	0.248	14
Clothianidin	H114 A	µg/l	0.123 ±	0.0024	0.0135	11
	H114 B	µg/l	1.89 ±	0.180	0.208	11
Cyanazine	H114 A	µg/l	0.195 ±	0.0139	0.0274	14
	H114 B	µg/l	2.81 ±	0.19	0.393	14
Dieldrin	H114 A	µg/l	0.174 ±	0.0139	0.04	23
	H114 B	µg/l	0.487 ±	0.0518	0.112	23
Dinotefurane	H114 A	µg/l	- ±	-	-	-
	H114 B	µg/l	- ±	-	-	-
Endrin	H114 A	µg/l	0.147 ±	0.0363	0.0543	37
	H114 B	µg/l	0.428 ±	0.0902	0.111	26
Heptachlor	H114 A	µg/l	0.108 ±	0.0312	0.0433	40
	H114 B	µg/l	0.349 ±	0.0655	0.14	40
Imidacloprid	H114 A	µg/l	0.419 ±	0.0225	0.0628	15
	H114 B	µg/l	2.18 ±	0.116	0.327	15
Lindane (Gamma-HCH)	H114 A	µg/l	0.135 ±	0.00809	0.0269	20
	H114 B	µg/l	0.729 ±	0.0329	0.146	20
Nitenpyram	H114 A	µg/l	- ±	-	-	-
	H114 B	µg/l	- ±	-	-	-
Prometryn	H114 A	µg/l	0.237 ±	0.00991	0.0308	13
	H114 B	µg/l	2.24 ±	0.107	0.291	13
Propazine	H114 A	µg/l	0.06 ±	0.00973	0.0174	29
	H114 B	µg/l	2.02 ±	0.141	0.262	13
Sum Chlordane	H114 A	µg/l	0.0674 ±	0.00891	0.0202	30
	H114 B	µg/l	0.639 ±	0.136	0.192	30
Sum DDD	H114 A	µg/l	0.251 ±	0.0259	0.0752	30
	H114 B	µg/l	0.623 ±	0.105	0.187	30
Sum DDE	H114 A	µg/l	0.233 ±	0.0583	0.0769	33
	H114 B	µg/l	- ±	-	-	-
Sum DDT	H114 A	µg/l	- ±	-	-	-
	H114 B	µg/l	- ±	-	-	-
Sum Endosulfan	H114 A	µg/l	0.228 ±	0.0326	0.0933	41
	H114 B	µg/l	0.666 ±	0.14	0.273	41
Thiacloprid	H114 A	µg/l	0.102 ±	0.0048	0.0142	14
	H114 B	µg/l	2.39 ±	0.113	0.334	14
Thiamethoxam	H114 A	µg/l	0.122 ±	0.0083	0.0208	17
	H114 B	µg/l	2.07 ±	0.102	0.352	17

\*Due to the small number of submitted results (Dinotefuran, Nitrenpyram) or a too high scatter between the results of the participating laboratories (Sum DDT, Sum DDE) the definition of an assigned value is not possible.

For the following substances, the calculated mean values MV +/- U(k=2) based on the data of the accredited laboratories (n) are listed for Information.

These can be used for comparison as part of your internal QA measures.

Dinotefuran:

H114 A: (n=2) 0.132 +/- 0.063 µg/l U(k=2)

H114 B: (n=2) 1.848 +/- 0.204 µg/l U(k=2)

Nitenpyram:

H114 A: (n=4) 0.0966 +/- 0.0545 µg/l U(k=2)

H114 B: (n=4) 2.11 +/- 0.966 µg/l U(k=2)

Sum DDT:

H114 A: (n=4) 0.184 +/- 0.0285 µg/l U(k=2)

H114 B: (n=4) 0.469 +/- 0.0440 µg/l U(k=2)

Sum DDE:

H114 B: (n=7) 0.423 +/- 0.177 µg/l U(k=2)

## E6.2. Summary of results, after removal of outliers

Parameter	Sample	Number of results for calculation	Number of outliers	Unit	Mean	± CI (99%)	Minimum	Maximum	sR	vR [%]
Acetamiprid	H114 A	7	1	µg/l	0.405	± 0.0252	0.361	0.429	0.0222	5.5
	H114 B	7	1	µg/l	1.22	± 0.113	1.03	1.35	0.0998	8.2
Aldrin	H114 A	8	3	µg/l	0.137	± 0.0224	0.094	0.155	0.0211	15
	H114 B	9	2	µg/l	0.674	± 0.143	0.438	0.858	0.143	21
Atrazine	H114 A	13	1	µg/l	0.211	± 0.0173	0.18	0.246	0.0208	9.9
	H114 B	12	1	µg/l	1.89	± 0.244	1.18	2.2	0.282	15
Atrazine-desethyl	H114 A	13	1	µg/l	0.225	± 0.0188	0.193	0.279	0.0226	10
	H114 B	13	1	µg/l	2.12	± 0.209	1.72	2.63	0.251	12
Atrazine-desisopropyl	H114 A	14	0	µg/l	0.303	± 0.0345	0.22	0.368	0.043	14
	H114 B	14	0	µg/l	2.28	± 0.226	1.73	2.7	0.282	12
Bromacil	H114 A	14	0	µg/l	0.222	± 0.0173	0.198	0.272	0.0215	9.7
	H114 B	13	0	µg/l	1.77	± 0.256	1.18	2.22	0.307	17
Clothianidin	H114 A	7	4	µg/l	0.123	± 0.0036	0.119	0.127	0.00318	2.6
	H114 B	9	1	µg/l	1.89	± 0.269	1.53	2.23	0.269	14
Cyanazine	H114 A	11	0	µg/l	0.194	± 0.0197	0.169	0.23	0.0217	11
	H114 B	11	0	µg/l	2.81	± 0.285	2.45	3.35	0.315	11
Dieldrin	H114 A	10	2	µg/l	0.174	± 0.0208	0.135	0.219	0.022	13
	H114 B	12	0	µg/l	0.487	± 0.0777	0.317	0.63	0.0897	18
Dinotefurane	H114 A	2	0	µg/l	-	± -	0.1	0.163	-	-
	H114 B	2	0	µg/l	-	± -	1.75	1.95	-	-
Endrin	H114 A	9	0	µg/l	0.147	± 0.0545	0.053	0.224	0.0545	37
	H114 B	8	1	µg/l	0.441	± 0.105	0.245	0.531	0.0992	22
Heptachlor	H114 A	11	1	µg/l	0.108	± 0.0467	0.009	0.175	0.0517	48
	H114 B	9	2	µg/l	0.349	± 0.0982	0.229	0.546	0.0982	28
Imidacloprid	H114 A	12	1	µg/l	0.419	± 0.0338	0.371	0.477	0.039	9.3
	H114 B	11	1	µg/l	2.18	± 0.173	1.97	2.5	0.192	8.8
Lindane (Gamma-HCH)	H114 A	9	2	µg/l	0.135	± 0.0121	0.112	0.151	0.0121	9
	H114 B	9	2	µg/l	0.729	± 0.0494	0.636	0.81	0.0494	6.8
Nitenpyram	H114 A	4	0	µg/l	-	± -	0.0164	0.138	-	-
	H114 B	4	0	µg/l	-	± -	0.681	2.8	-	-
Prometryn	H114 A	9	3	µg/l	0.237	± 0.0149	0.22	0.266	0.0149	6.3

Parameter	Sample	Number of results for calculation	Number of outliers	Unit	Mean	± CI (99%)	Minimum	Maximum	sR	vR [%]
Prometryn	H114 B	8	4	µg/l	2.24	± 0.16	2.12	2.58	0.151	6.8
Propazine	H114 A	13	0	µg/l	0.06	± 0.0146	0.033	0.107	0.0175	29
	H114 B	11	2	µg/l	1.97	± 0.238	1.5	2.31	0.263	13
Sum Chlordane	H114 A	6	1	µg/l	0.0674	± 0.0134	0.054	0.083	0.0109	16
	H114 B	7	0	µg/l	0.639	± 0.205	0.291	0.83	0.181	28
Sum DDD	H114 A	7	0	µg/l	0.251	± 0.0388	0.208	0.293	0.0342	14
	H114 B	6	1	µg/l	0.623	± 0.158	0.435	0.822	0.129	21
Sum DDE	H114 A	8	1	µg/l	0.237	± 0.0767	0.091	0.328	0.0723	31
	H114 B	9	0	µg/l	0.494	± 0.262	0.017	0.921	0.262	53
Sum DDT	H114 A	6	1	µg/l	0.2	± 0.136	0.143	0.3995	0.111	56
	H114 B	8	0	µg/l	0.449	± 0.292	0.029	0.89	0.275	61
Sum Endosulfan	H114 A	9	1	µg/l	0.228	± 0.0489	0.15	0.306	0.0489	21
	H114 B	9	0	µg/l	0.666	± 0.21	0.206	0.915	0.21	32
Thiacloprid	H114 A	15	0	µg/l	0.102	± 0.0072	0.0852	0.118	0.00929	9.1
	H114 B	13	1	µg/l	2.39	± 0.17	1.94	2.6	0.204	8.5
Thiamethoxam	H114 A	12	1	µg/l	0.122	± 0.0124	0.0854	0.14	0.0144	12
	H114 B	10	2	µg/l	2.07	± 0.153	1.8	2.35	0.161	7.8

## E7. Parameterorientierte Auswertung / Parameter oriented report

Acetamiprid .....	37
Aldrin .....	45
Atrazine .....	53
Atrazine-desethyl.....	61
Atrazine-desisopropyl.....	69
Bromacil .....	77
Clothianidin .....	85
Cyanazine .....	93
Dieldrin .....	101
Dinotefurane.....	109
Endrin.....	113
Heptachlor .....	121
Imidacloprid.....	129
Lindane (Gamma-HCH).....	137
Nitenpyram.....	145
Prometryn.....	149
Propazine .....	157
Sum Chlordane .....	165
Sum DDD .....	173
Sum DDE .....	181
Sum DDT .....	189
Sum Endosulfan.....	197
Thiacloprid.....	205
Thiamethoxam.....	213

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Acetamiprid

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Acetamiprid

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.405 ± 0.0168
Criterion	0.0405 (10 %)
Minimum - Maximum	0.361 - 0.429
Control test value ± U (k=2)	0.4410 ± 0.0662

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.4	0.1	-	-	
LC0002	0.4058	0.1034	100	0.02	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	0.425	0.14	105	0.5	
LC0005	-	-	-	-	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	0.361	0.09	89.2	-1.08	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	0.429	0.17	106	0.6	
LC0012	0.2375	0.1188	58.7	-4.13	H
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.4	0.06	98.8	-0.12	
LC0016	0.403	0.065	99.5	-0.05	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.41	0.205	101	0.13	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.384 ± 0.0664	0.405 ± 0.0252	µg/l
Minimum	0.238	0.361	µg/l
Maximum	0.429	0.429	µg/l
Standard deviation	0.0626	0.0222	µg/l
rel. standard deviation	16.3	5.49	%
n	8	7	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Acetamiprid


#### Graphical presentation of results

##### Results

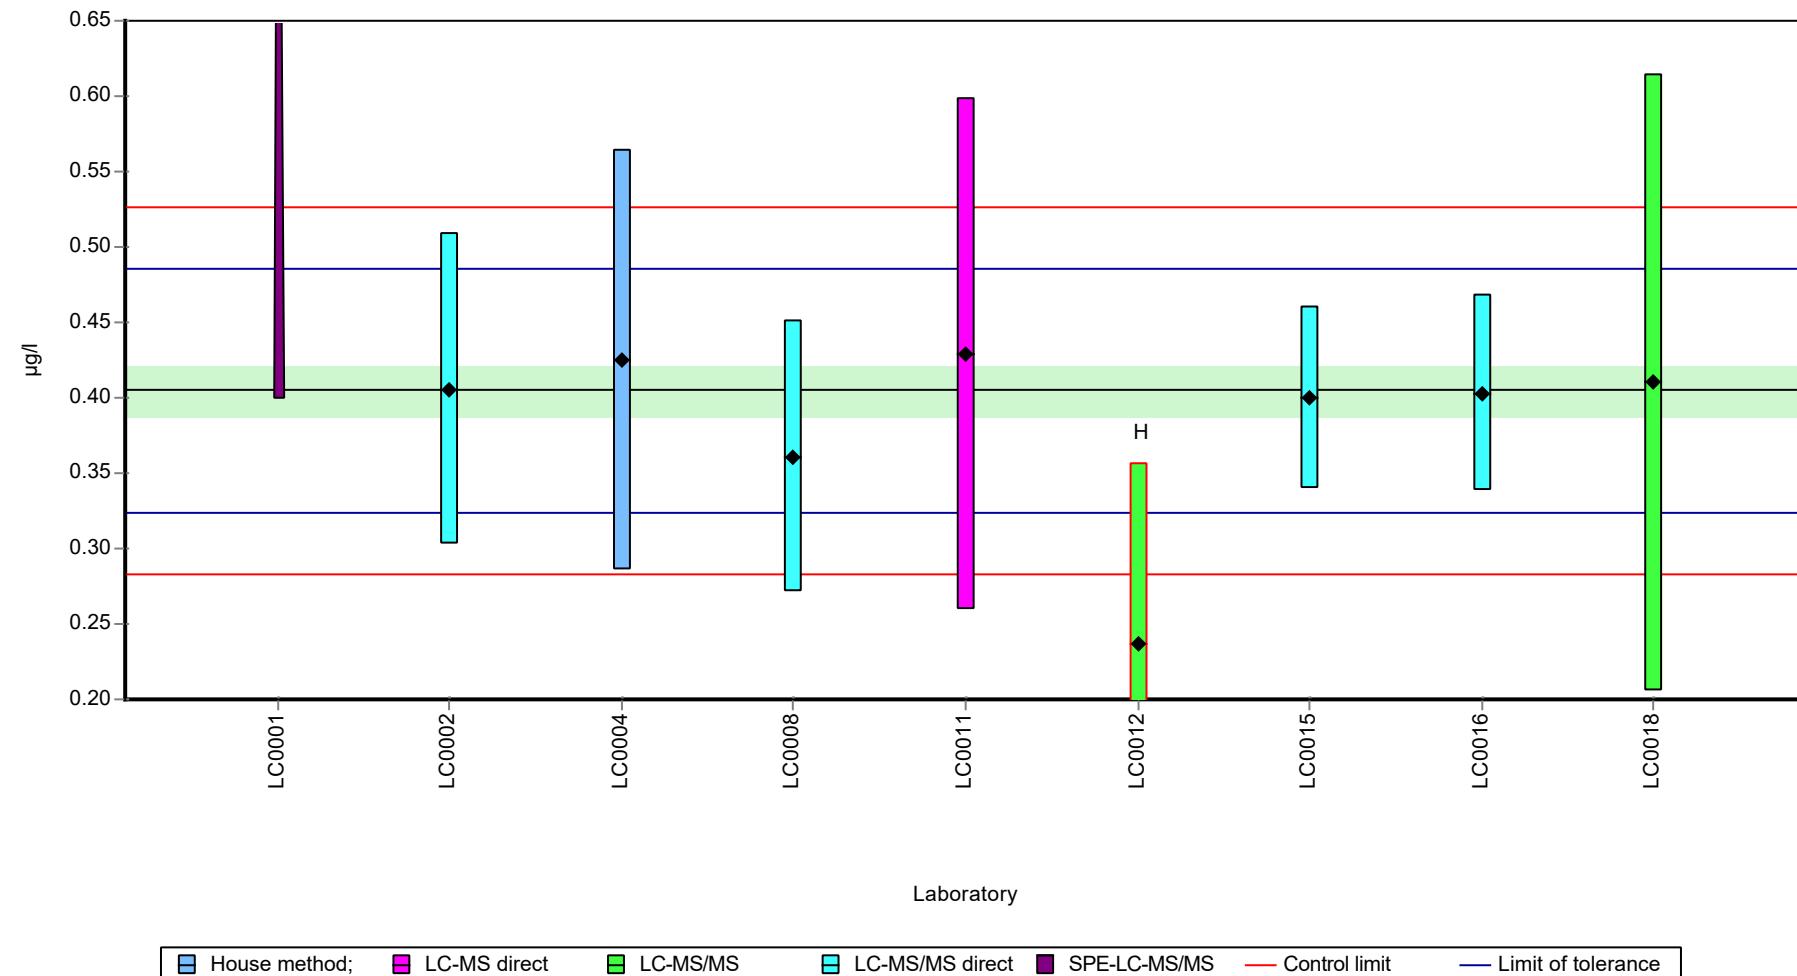


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Acetamiprid

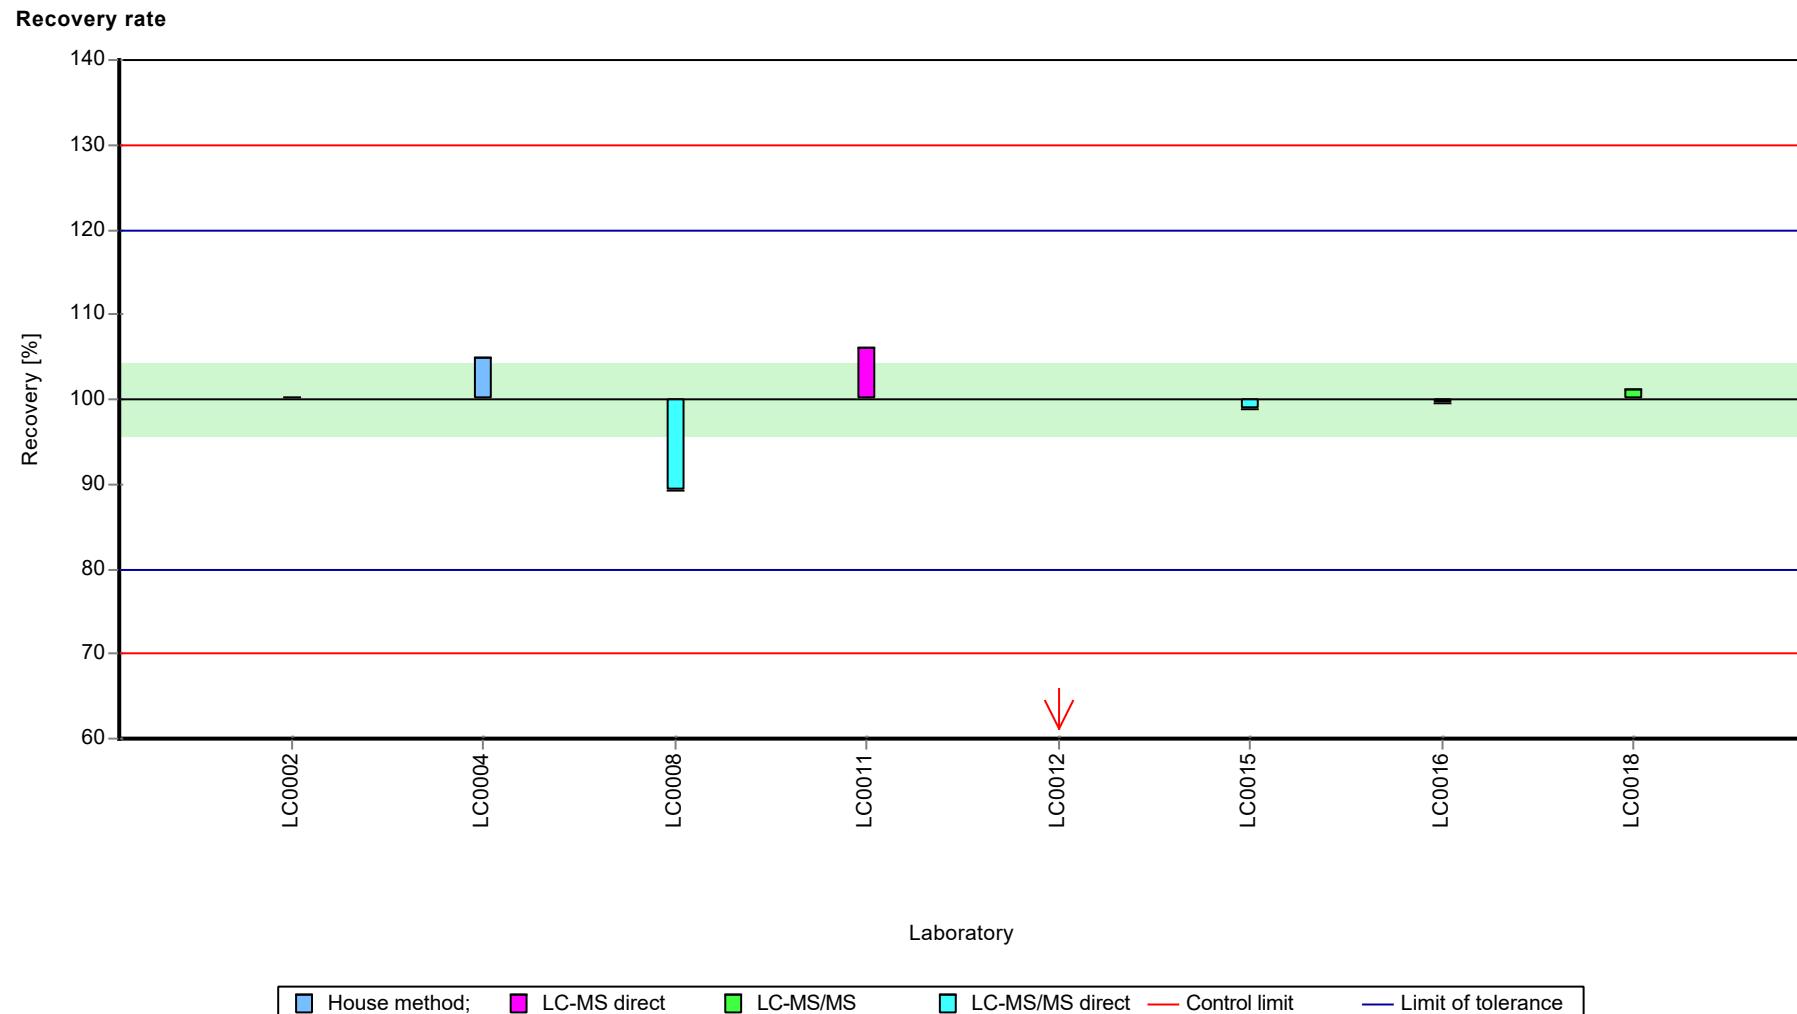

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Acetamiprid

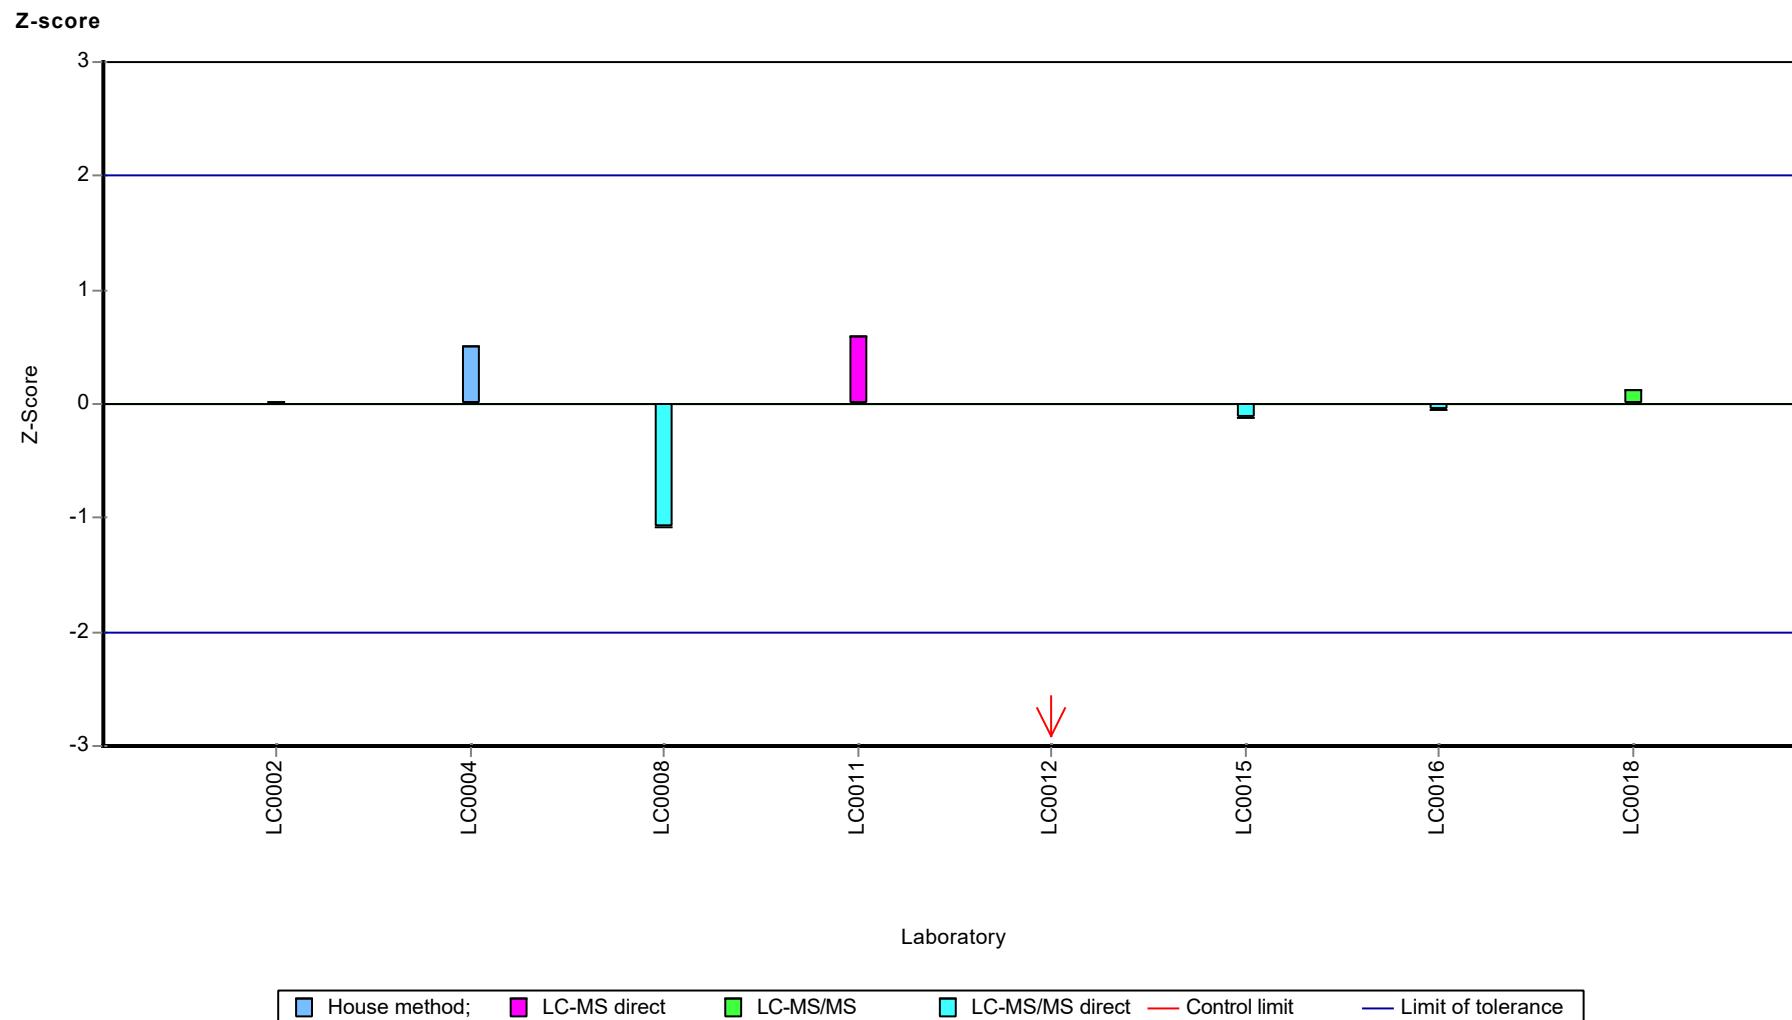

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Acetamiprid

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Acetamiprid

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	1.22 ± 0.0754
Criterion	0.122 (10 %)
Minimum - Maximum	1.03 - 1.35
Control test value ± U (k=2)	1.320 ± 0.197

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.4	0.1	-	-	
LC0002	1.1727	0.2989	96.2	-0.38	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	1.35	0.44	111	1.08	
LC0005	-	-	-	-	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	1.026	0.257	84.2	-1.58	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	1.255	0.4	103	0.3	
LC0012	0.5327	0.2664	43.7	-5.63	H
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	1.247	0.187	102	0.23	
LC0016	1.23	0.2	101	0.09	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	1.25	0.63	103	0.26	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	1.13 ± 0.275	1.22 ± 0.113	µg/l
Minimum	0.533	1.03	µg/l
Maximum	1.35	1.35	µg/l
Standard deviation	0.26	0.0998	µg/l
rel. standard deviation	22.9	8.19	%
n	8	7	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Acetamiprid


**Graphical presentation of results**

**Results**

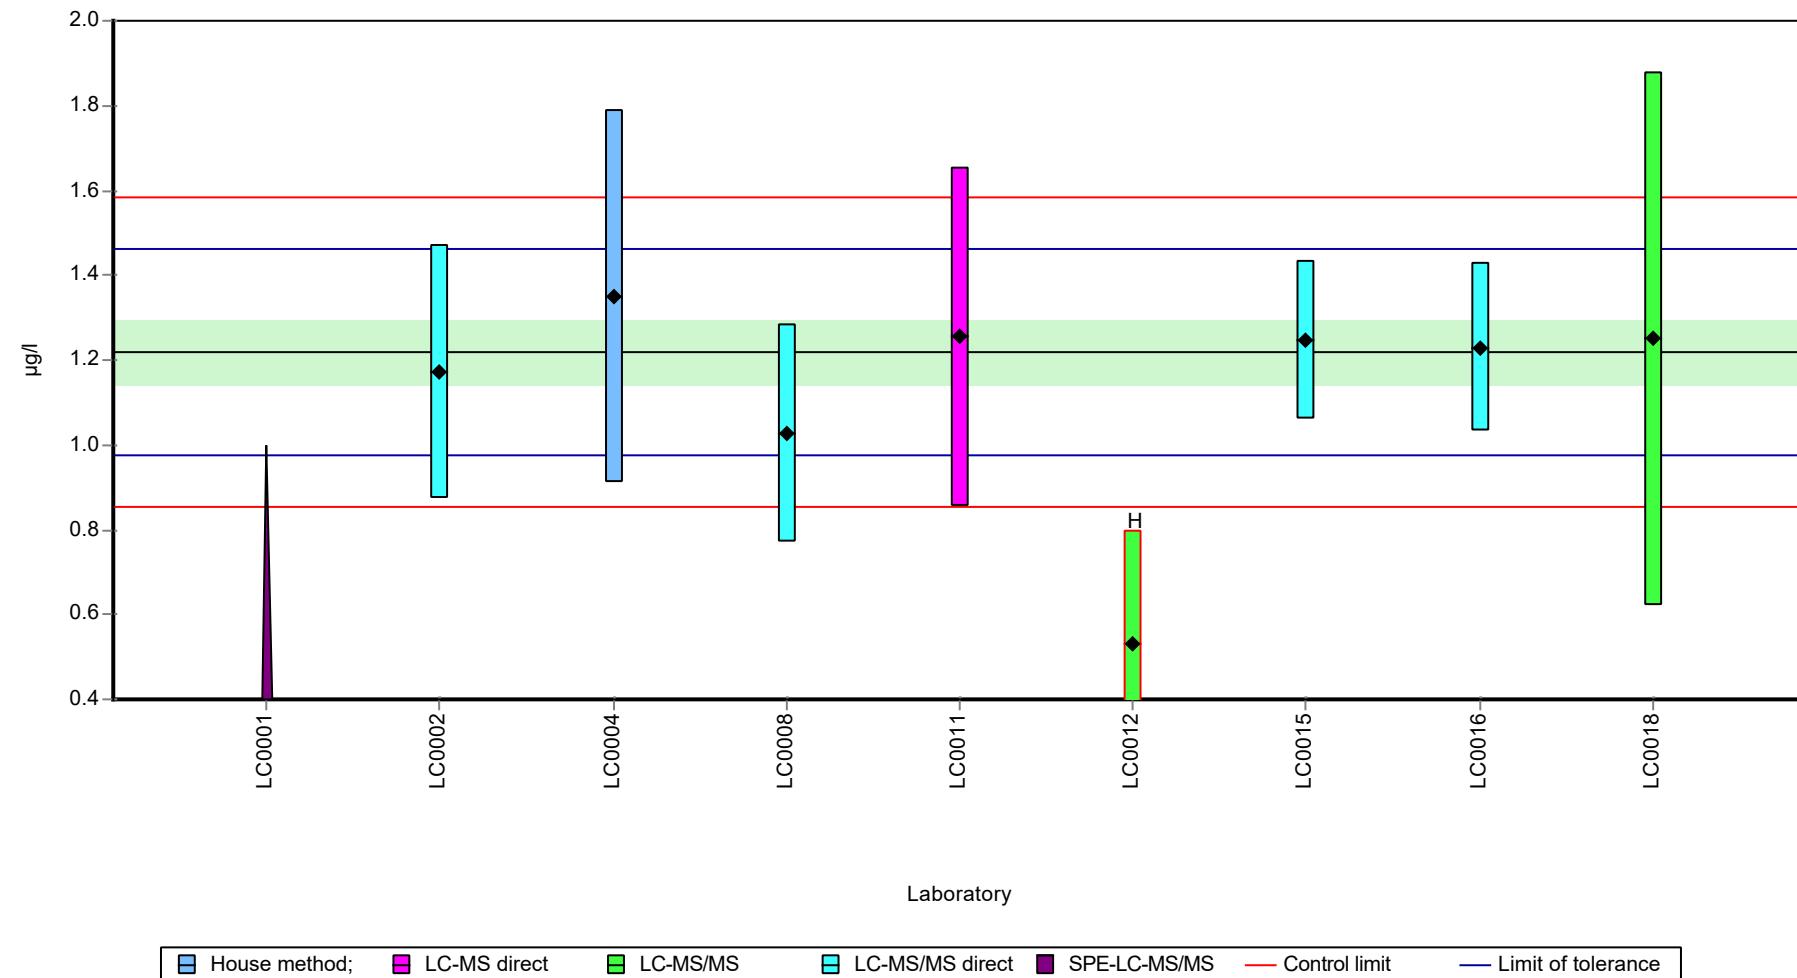


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Acetamiprid

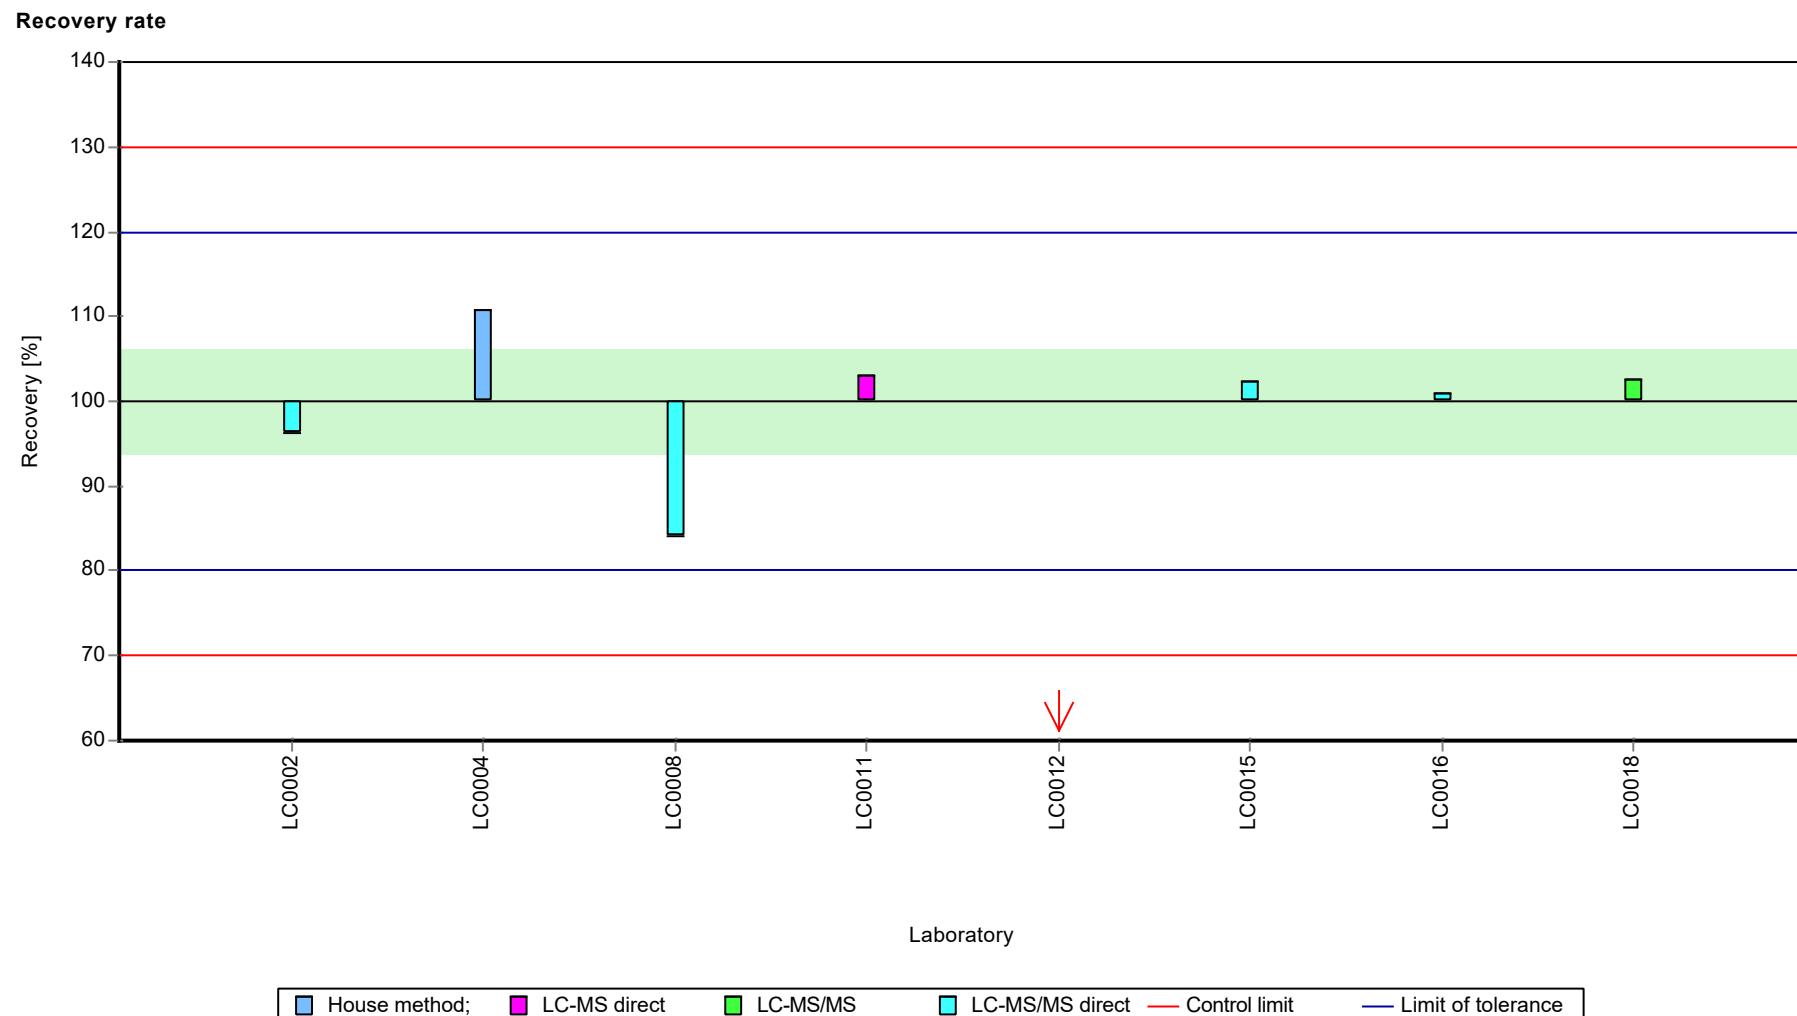

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Acetamiprid

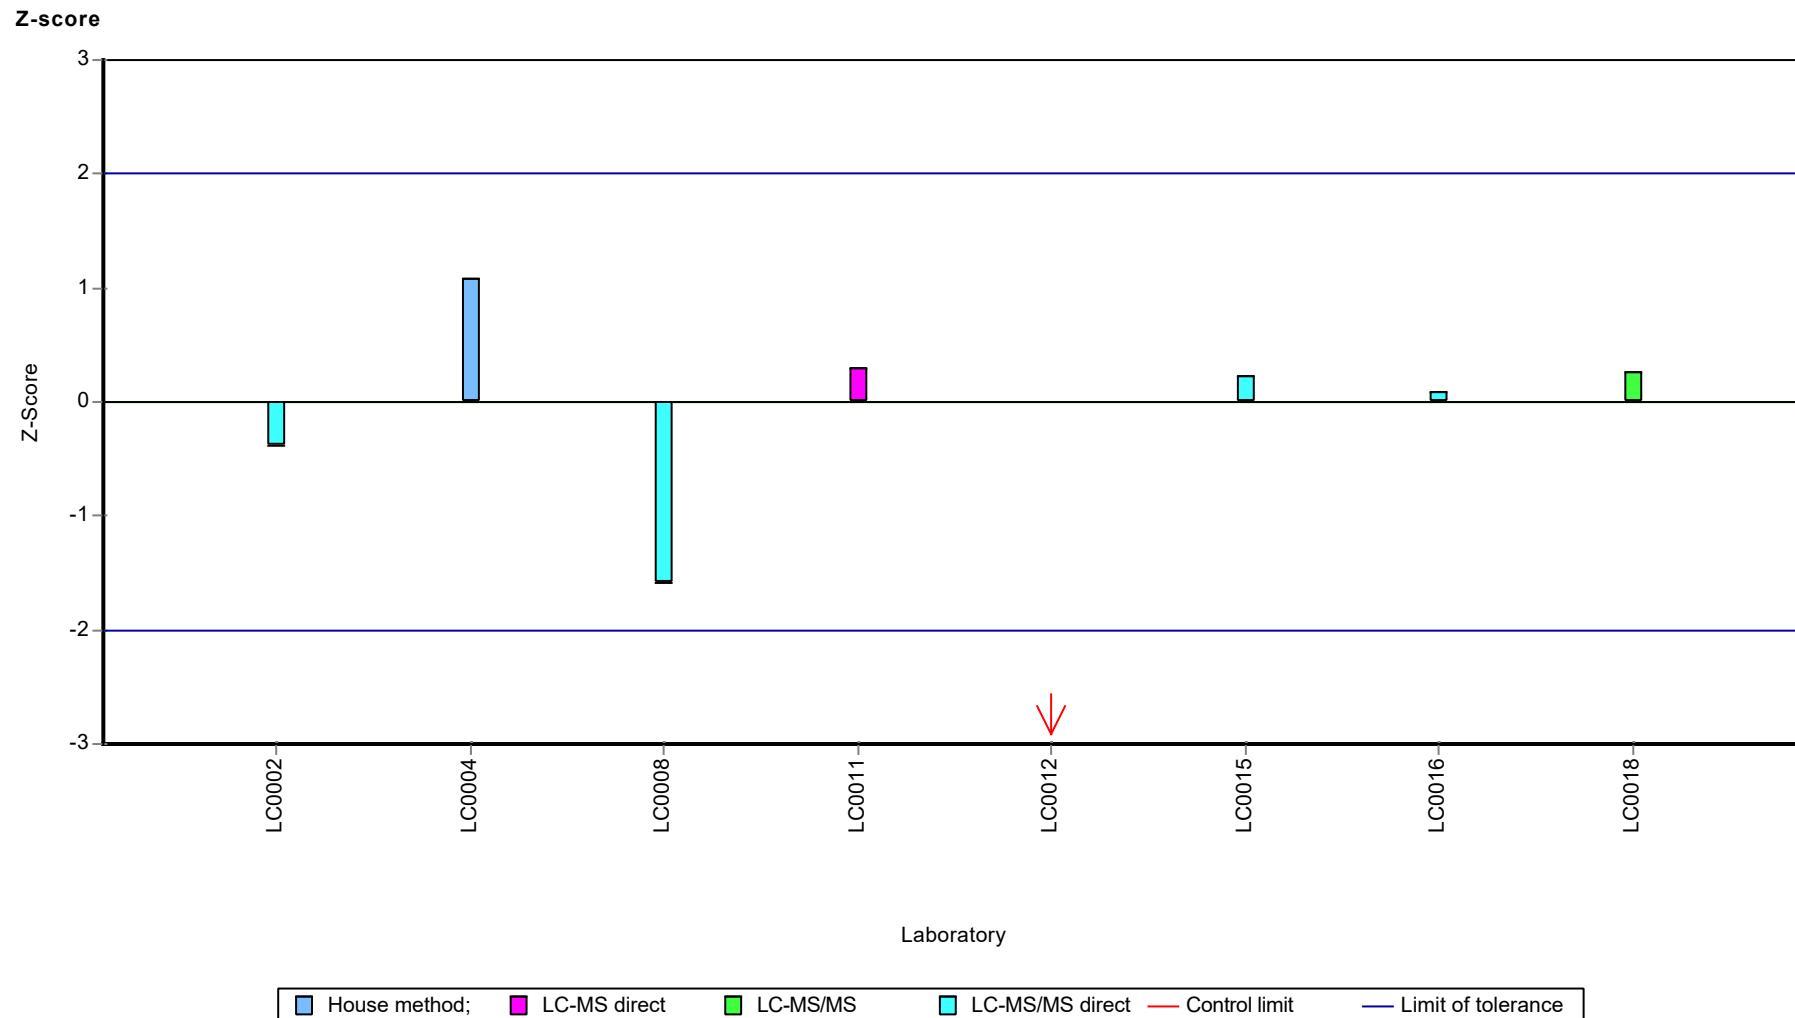

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Aldrin

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Aldrin

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.137 ± 0.0149
Criterion	0.0412 (30 %)
Minimum - Maximum	0.094 - 0.155
Control test value ± U (k=2)	0.1520 ± 0.0606

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.17	0.0425	-	-	
LC0002	0.1335	0.0464	97.3	-0.09	
LC0003	0.142	0.00425	103	0.12	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.143	0.026	104	0.14	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.155	0.031	113	0.43	
LC0008	0.017	0.004	12.4	-2.92	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.027	0.014	19.7	-2.68	H
LC0013	0.121	0.009	88.2	-0.39	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.253	0.038	184	2.81	H
LC0016	0.094	0.016	68.5	-1.05	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.155	0.0753	113	0.43	
LC0019	0.1543	0.023	112	0.41	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.127 ± 0.0586	0.137 ± 0.0224	µg/l
Minimum	0.017	0.094	µg/l
Maximum	0.253	0.155	µg/l
Standard deviation	0.0648	0.0211	µg/l
rel. standard deviation	51.1	15.4	%
n	11	8	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Aldrin


#### Graphical presentation of results

##### Results

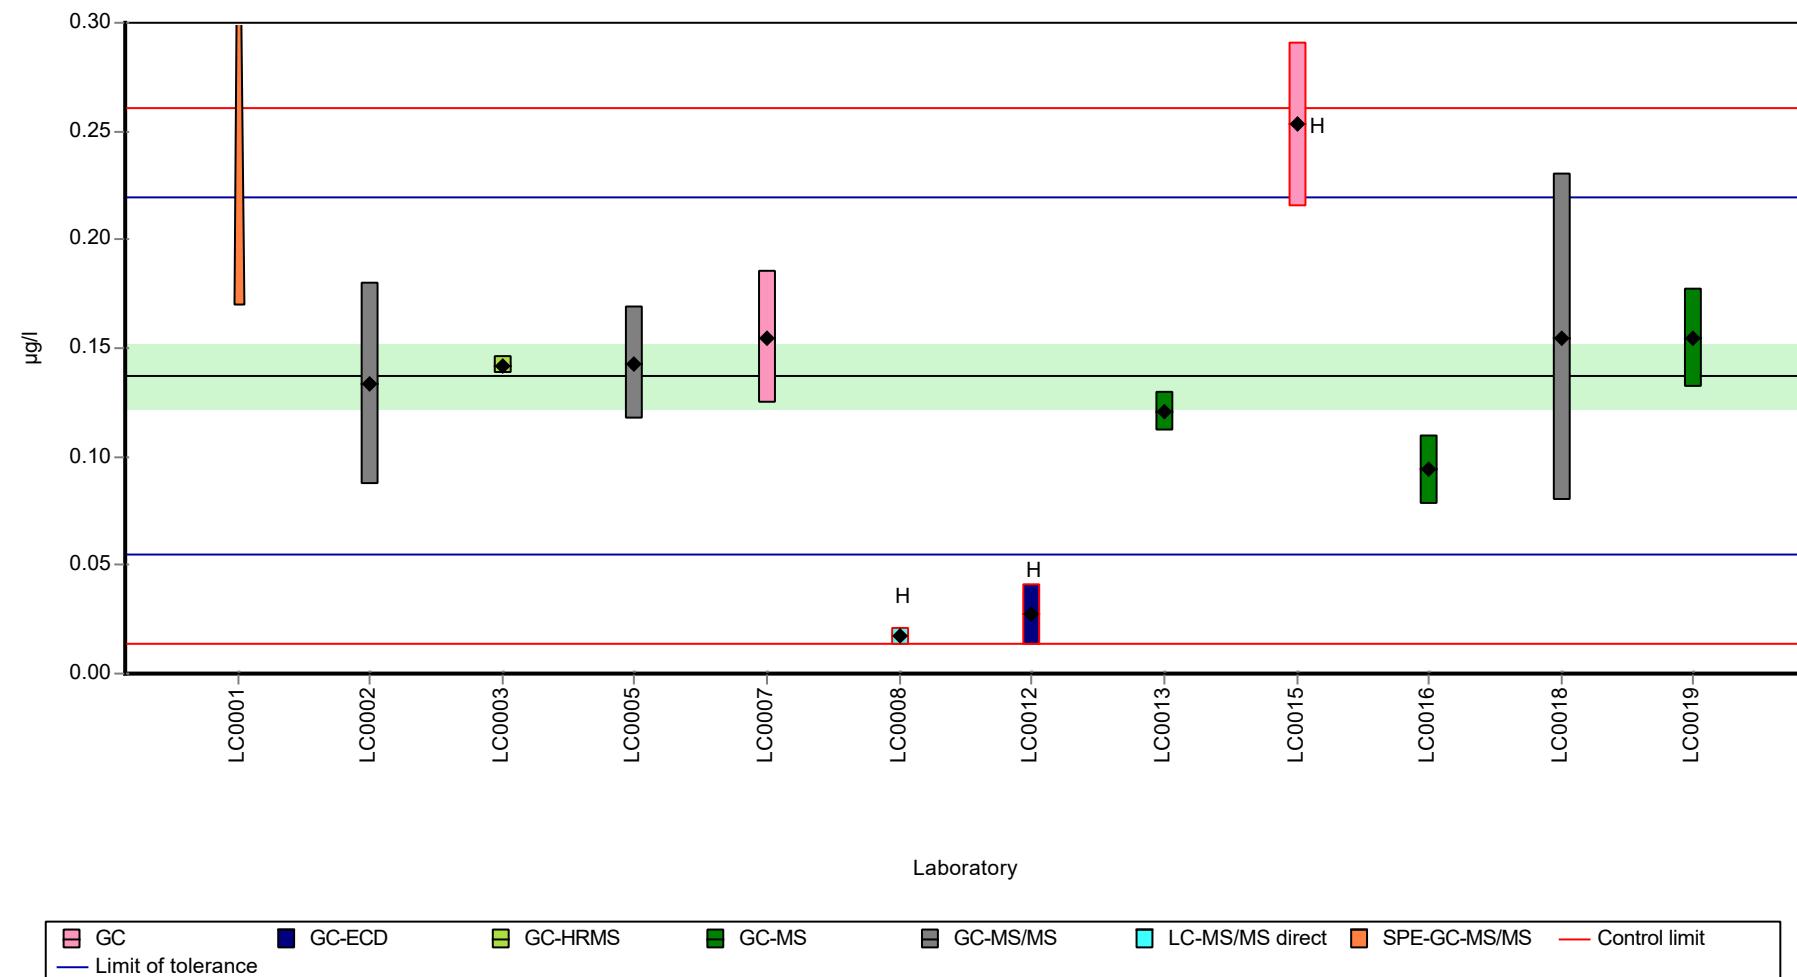


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Aldrin

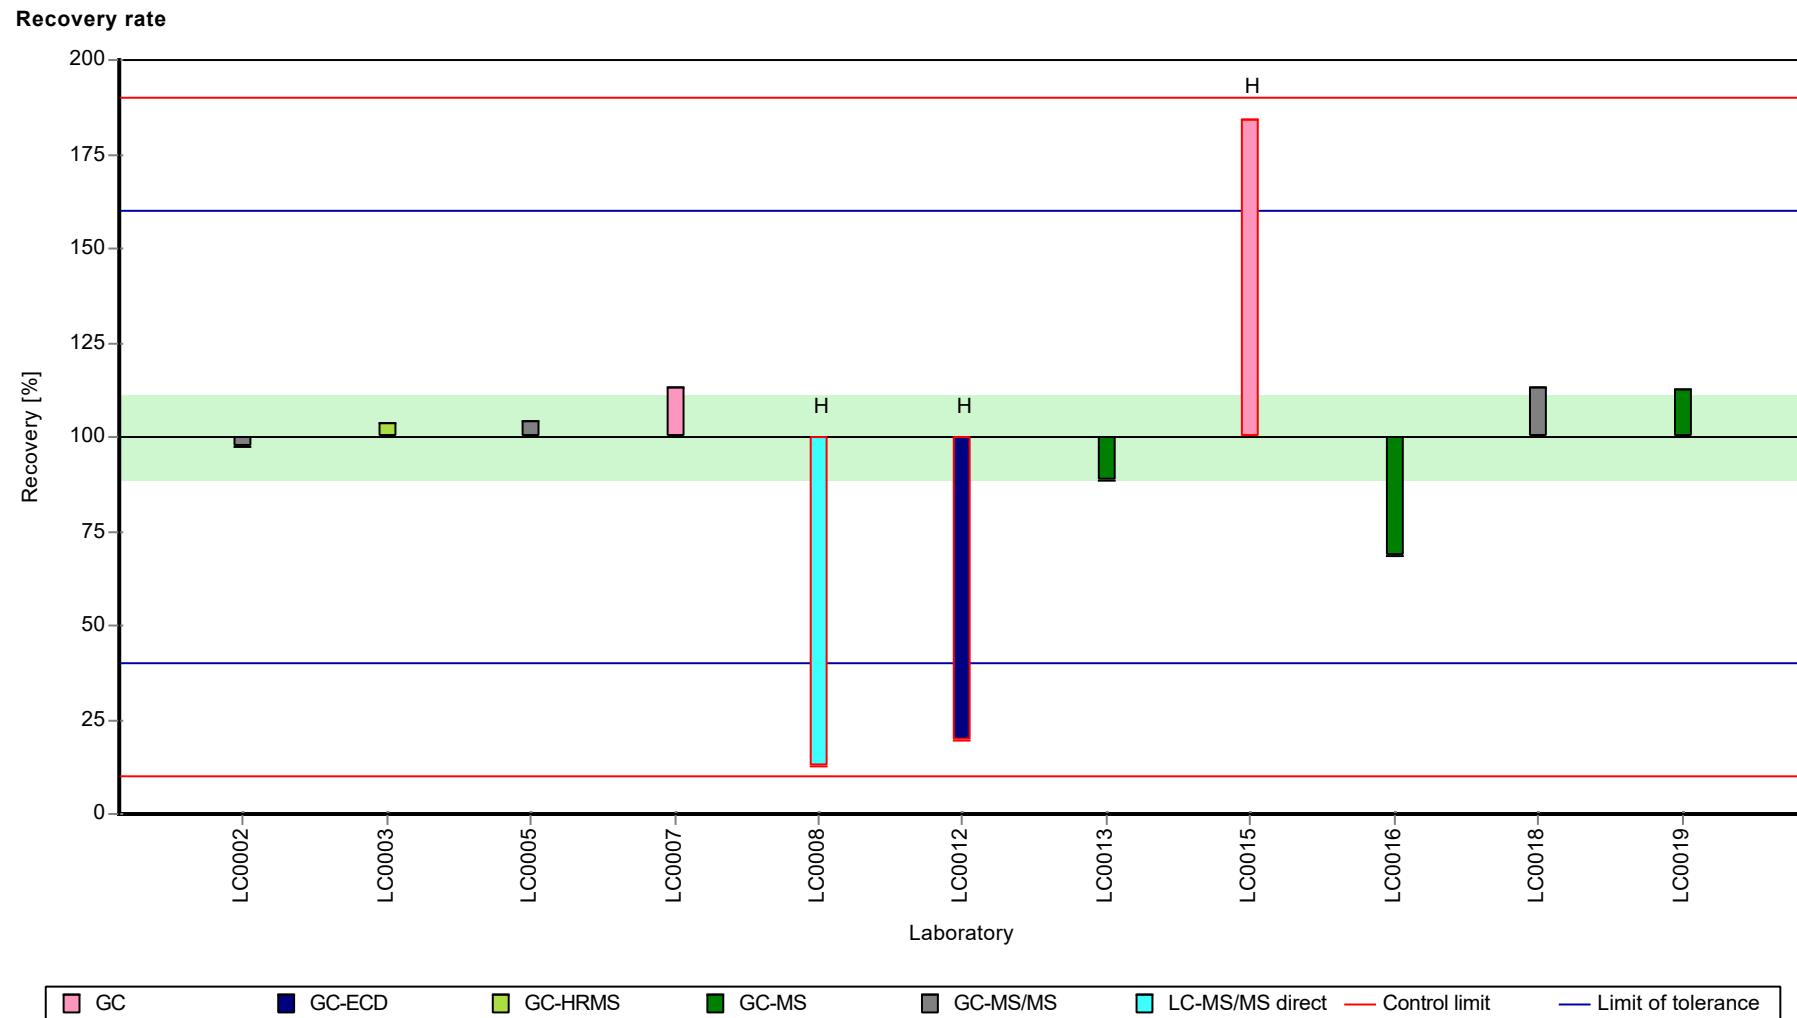

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Aldrin

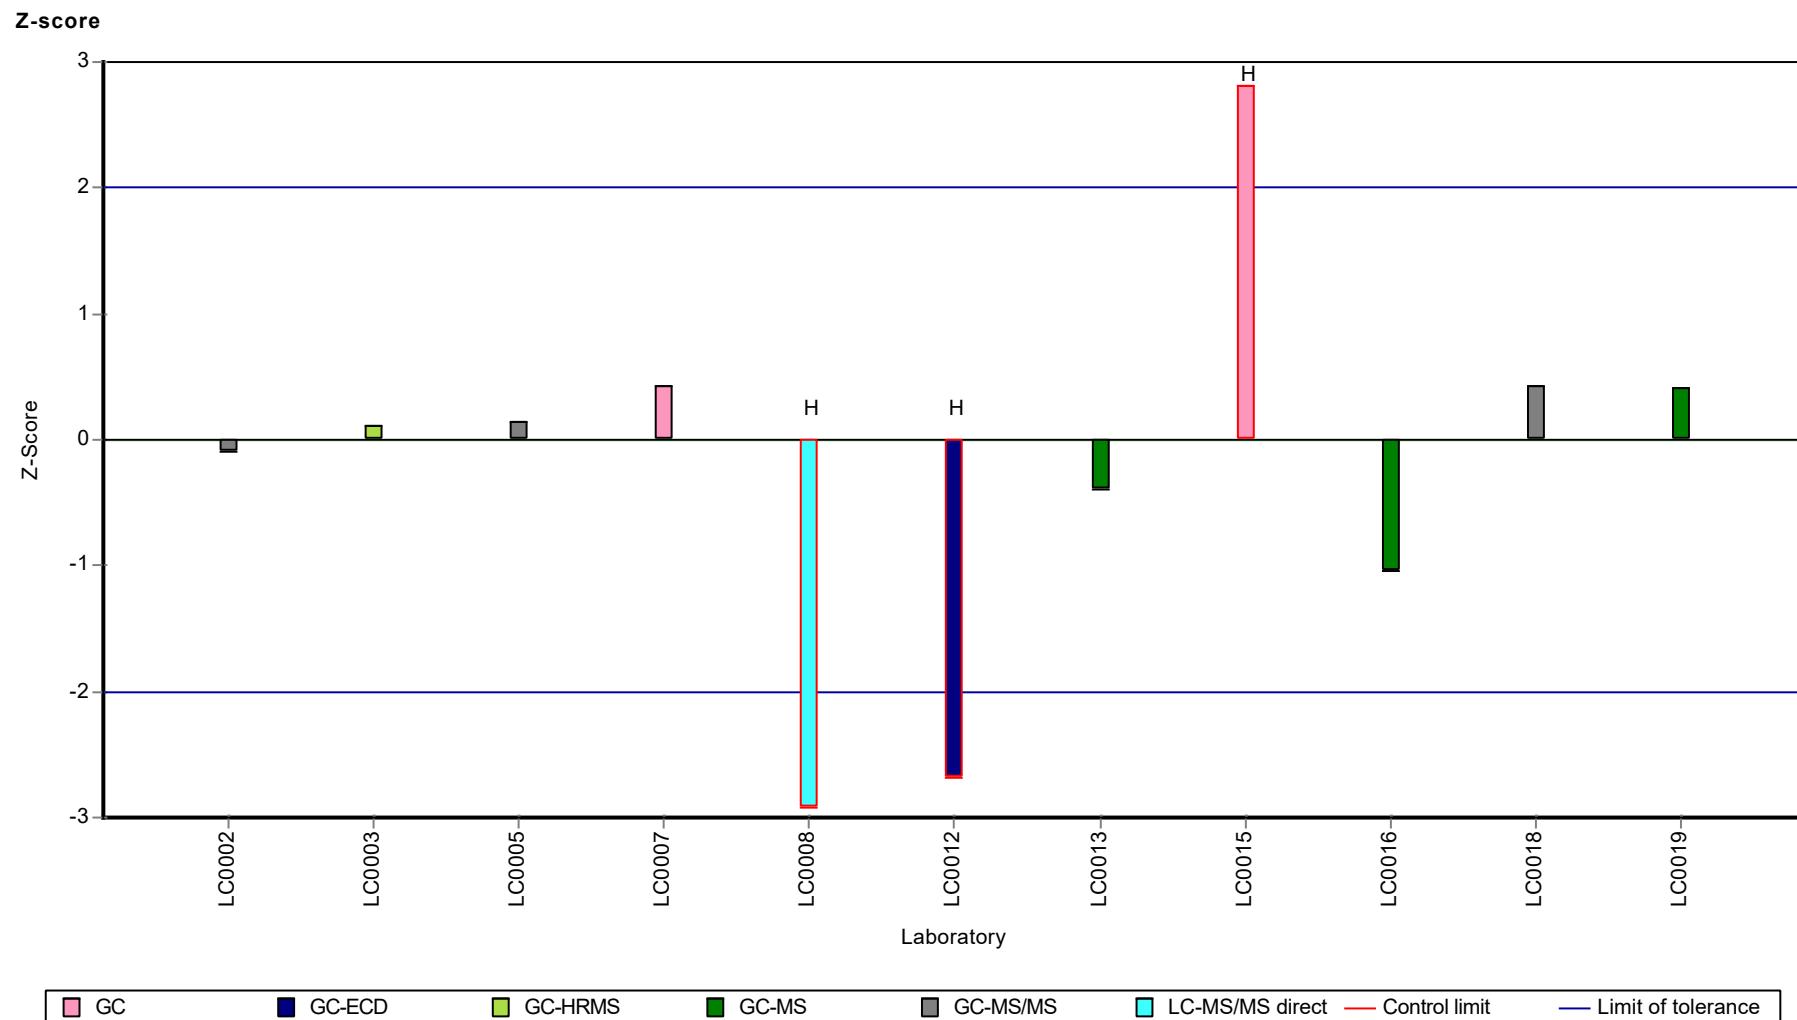

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Aldrin

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Aldrin

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.674 ± 0.0955
Criterion	0.202 (30 %)
Minimum - Maximum	0.438 - 0.858
Control test value ± U (k=2)	0.807 ± 0.323

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.17	0.0425	-	-	
LC0002	0.6526	0.2267	96.8	-0.11	
LC0003	0.438	0.0132	65	-1.17	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.755	0.136	112	0.4	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.757	0.152	112	0.41	
LC0008	0.067	0.017	9.9	-3	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.059	0.03	8.8	-3.04	H
LC0013	0.652	0.064	96.7	-0.11	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.858	0.128	127	0.91	
LC0016	0.455	0.077	67.5	-1.08	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.77	0.385	114	0.47	
LC0019	0.7302	0.11	108	0.28	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.563 ± 0.252	0.674 ± 0.143	µg/l
Minimum	0.059	0.438	µg/l
Maximum	0.858	0.858	µg/l
Standard deviation	0.278	0.143	µg/l
rel. standard deviation	49.5	21.3 %	
n	11	9	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Aldrin


### Graphical presentation of results

#### Results

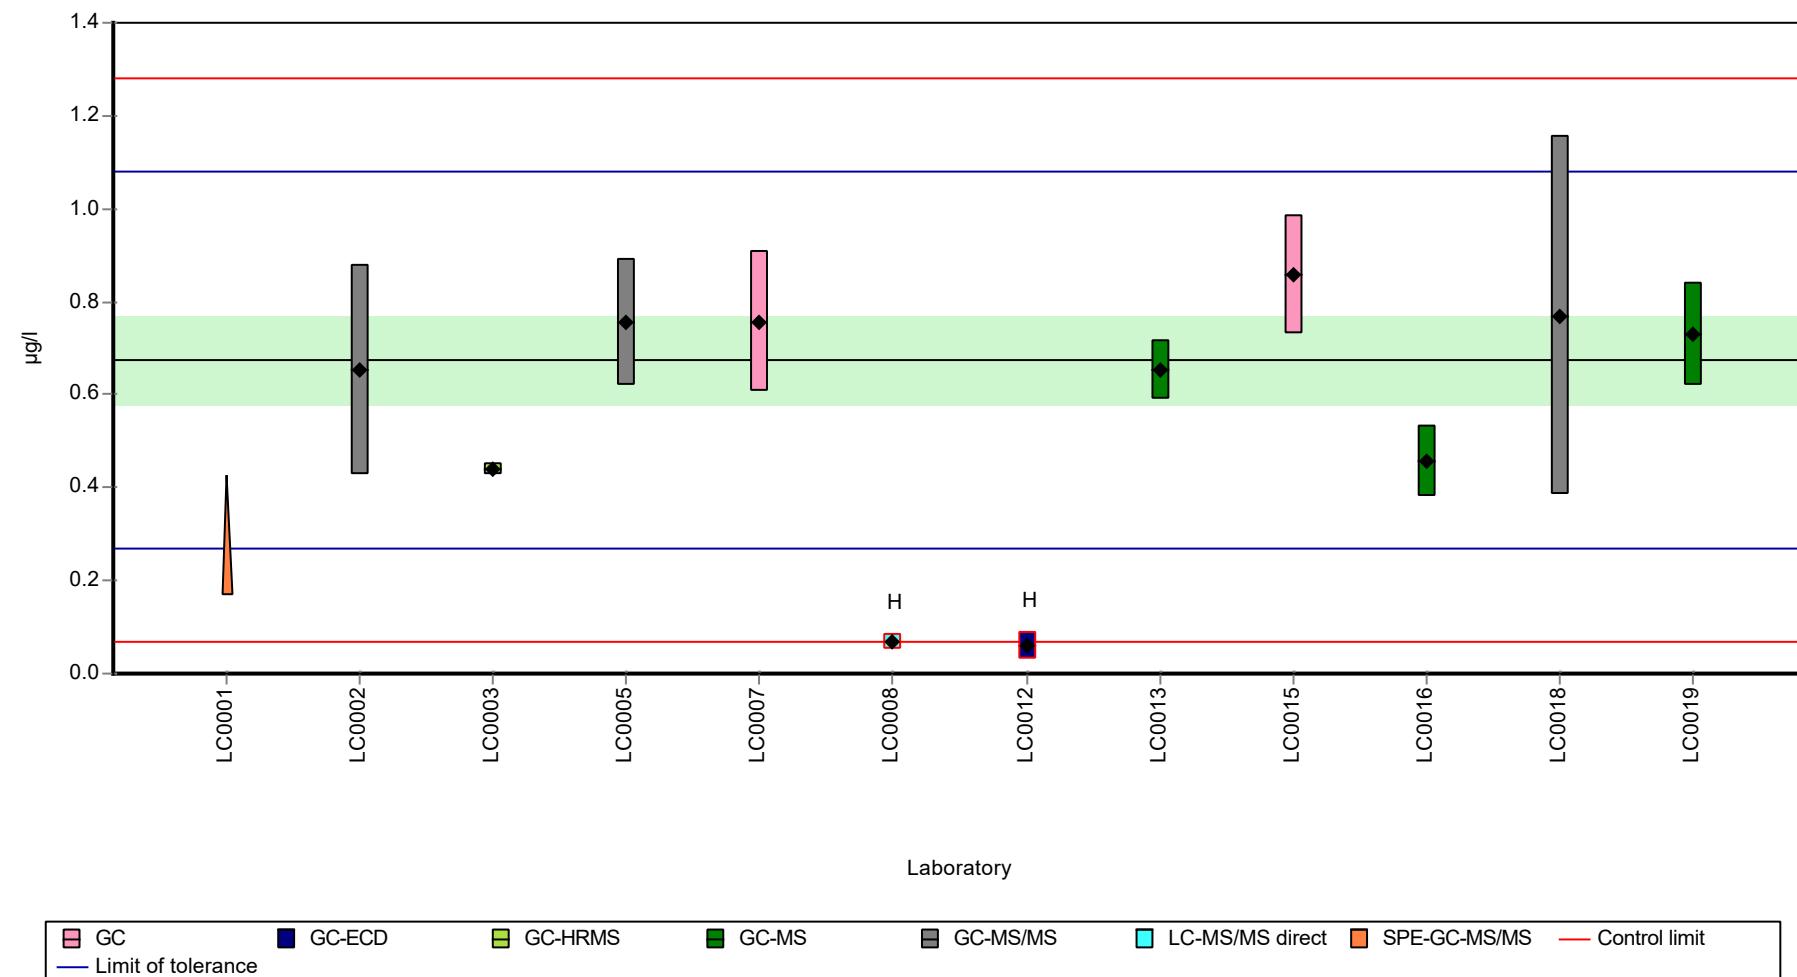


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Aldrin

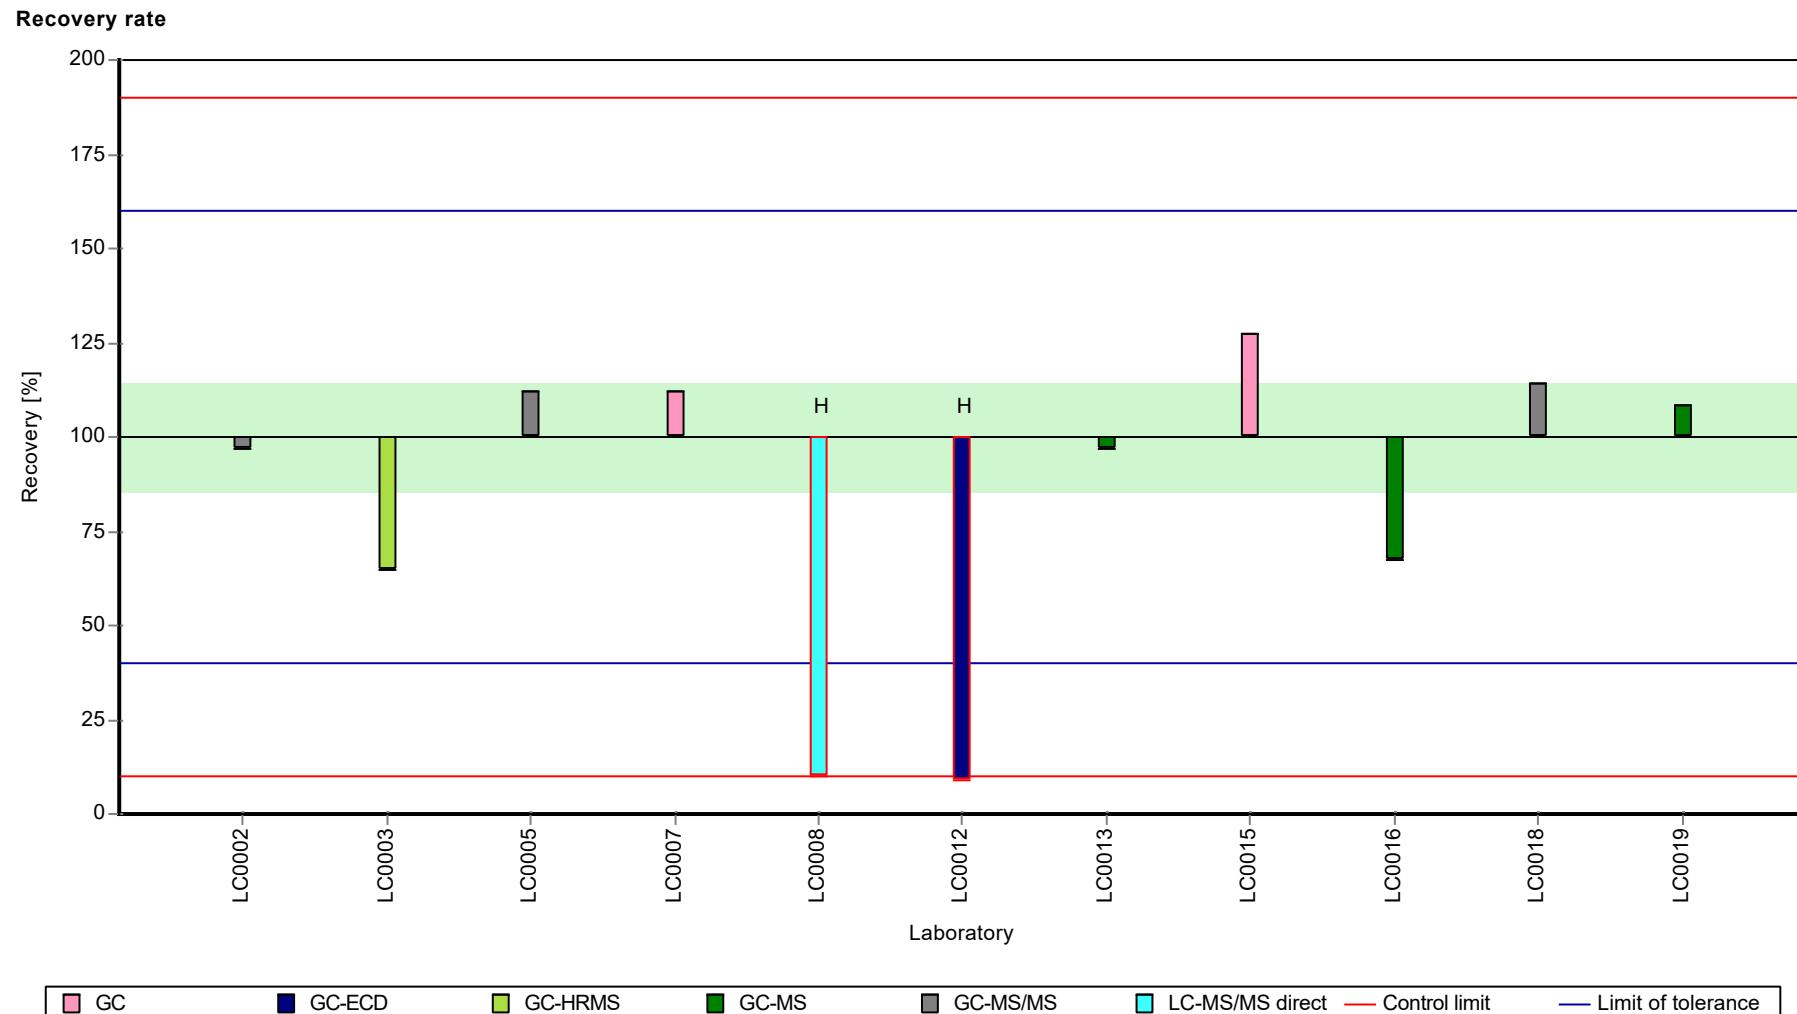

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Aldrin

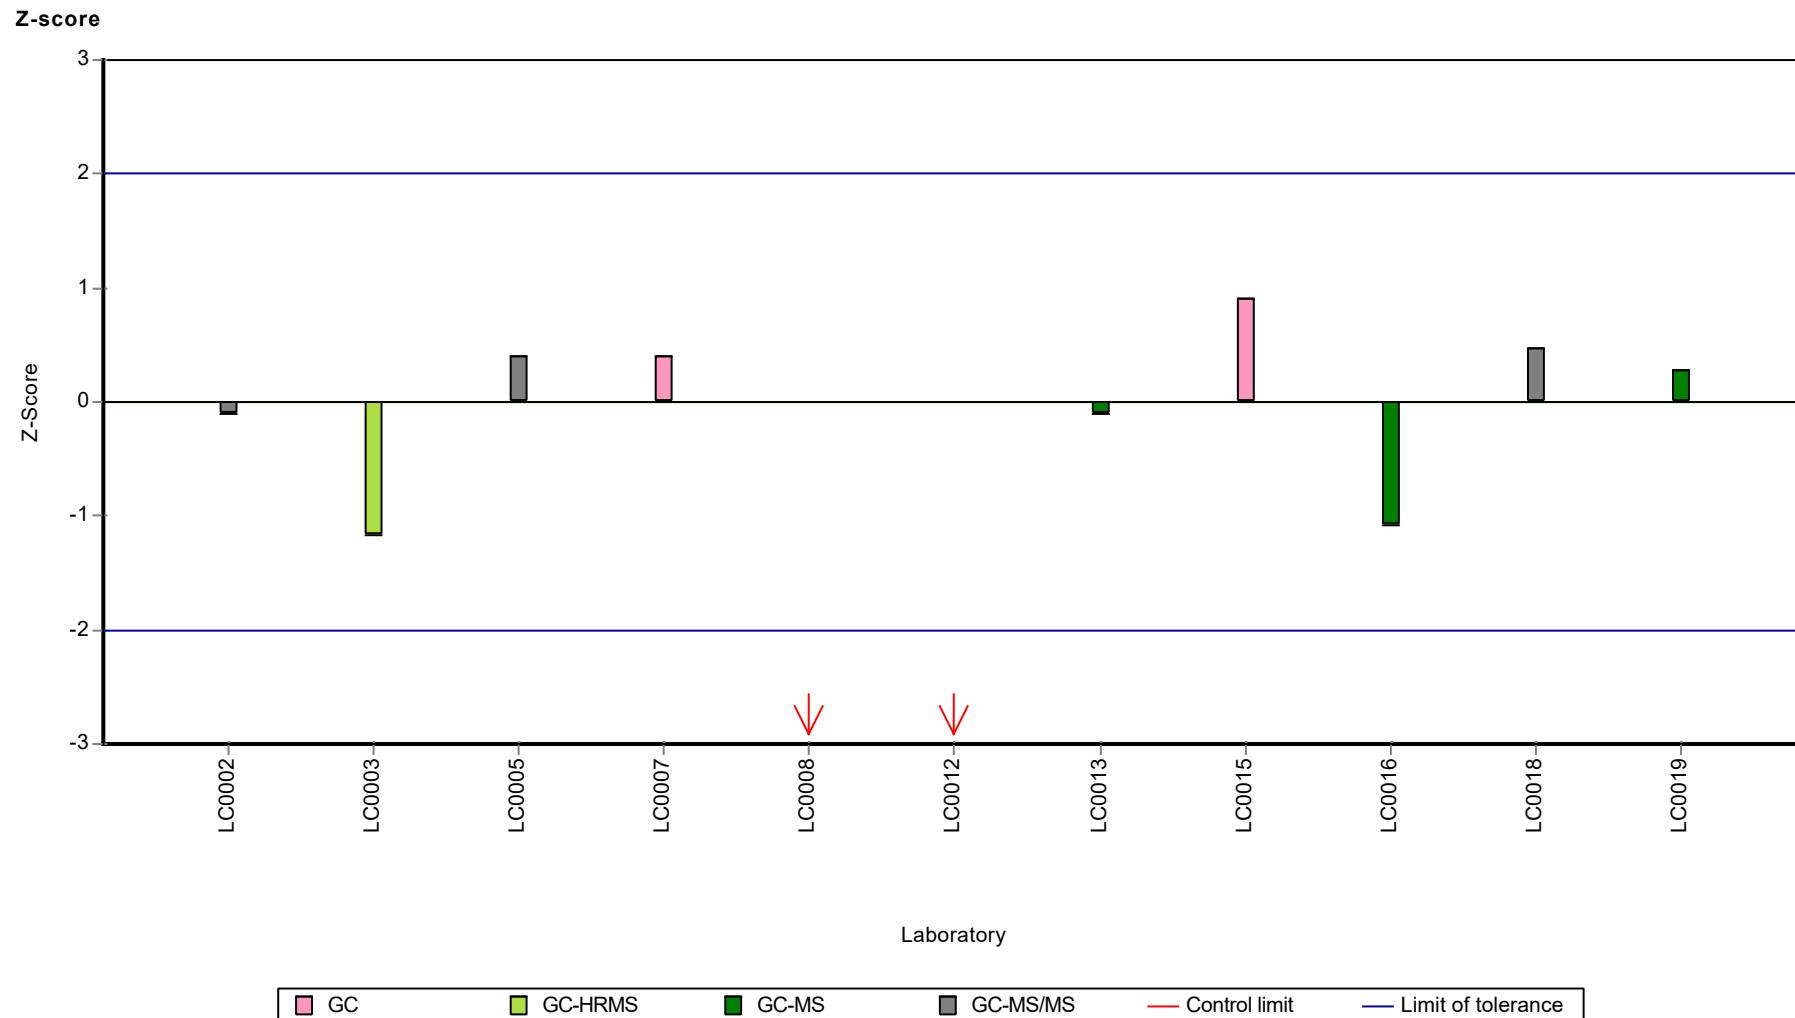

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Atrazine

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.211 ± 0.0115
Criterion	0.0232 (11 %)
Minimum - Maximum	0.18 - 0.246
Control test value ± U (k=2)	0.1860 ± 0.0279

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	0.2006	0.0502	95.2	-0.43	
LC0002	0.2458	0.0613	117	1.52	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.207	0.037	98.3	-0.16	
LC0006	0.18	0.002	85.4	-1.32	
LC0007	0.232	0.029	110	0.92	
LC0008	0.389	0.097	185	7.7	H
LC0009	0.211	0.042	100	0.01	
LC0010	0.22	0.026	104	0.4	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.1985	0.0993	94.2	-0.52	
LC0013	0.236	0.002	112	1.09	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.18	0.027	85.4	-1.32	
LC0016	0.212	0.035	101	0.06	
LC0017	0.19067	0.04195	90.5	-0.86	
LC0018	0.225	0.113	107	0.62	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.223 ± 0.0414	0.211 ± 0.0173	µg/l
Minimum	0.18	0.18	µg/l
Maximum	0.389	0.246	µg/l
Standard deviation	0.0517	0.0208	µg/l
rel. standard deviation	23.1	9.85	%
n	14	13	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine


#### Graphical presentation of results

##### Results

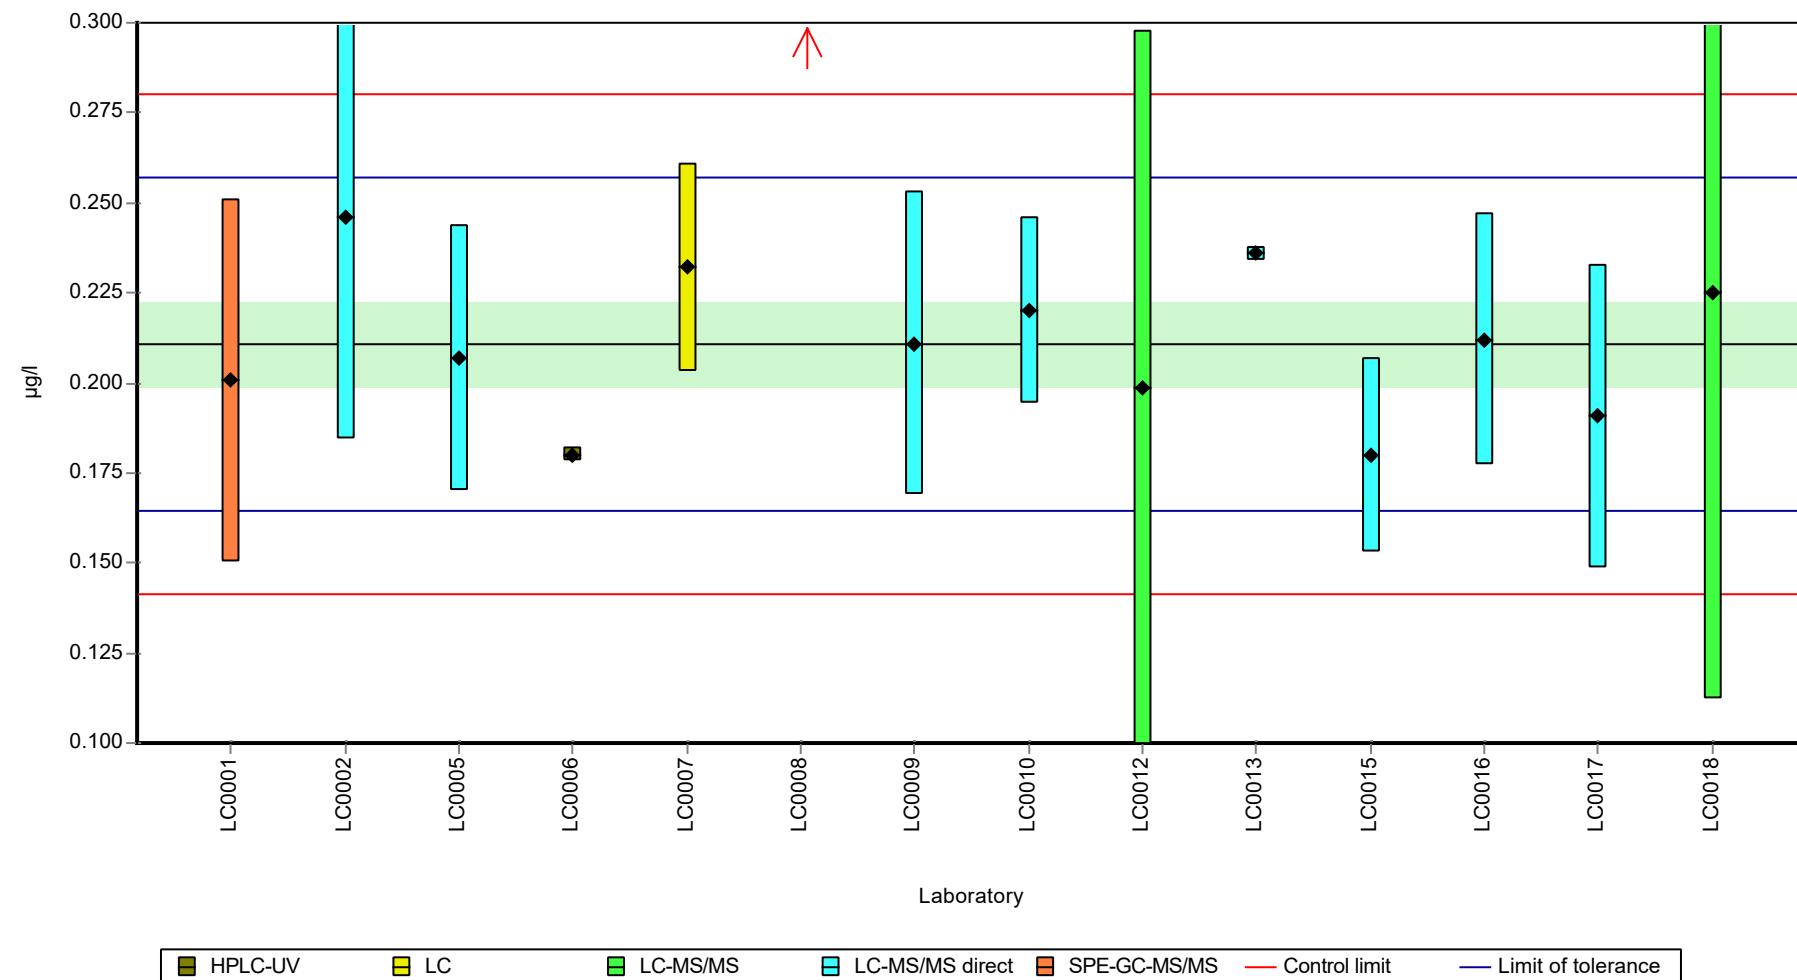


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine

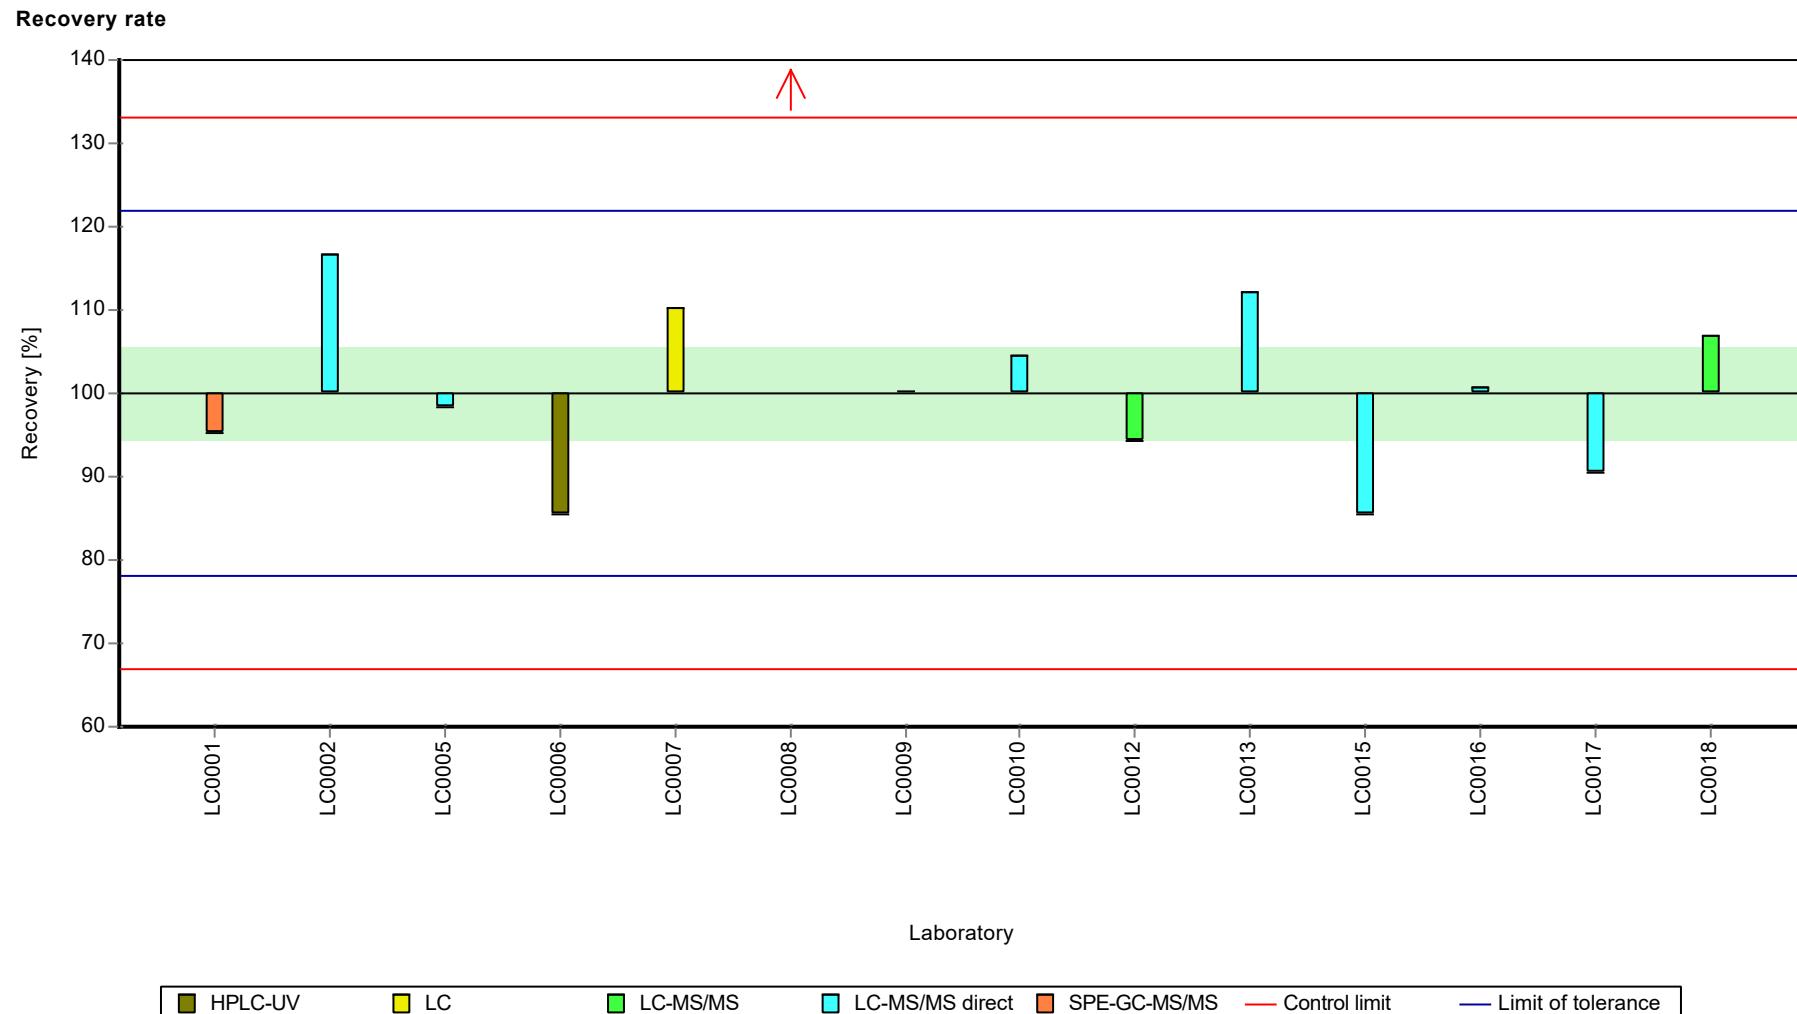

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine

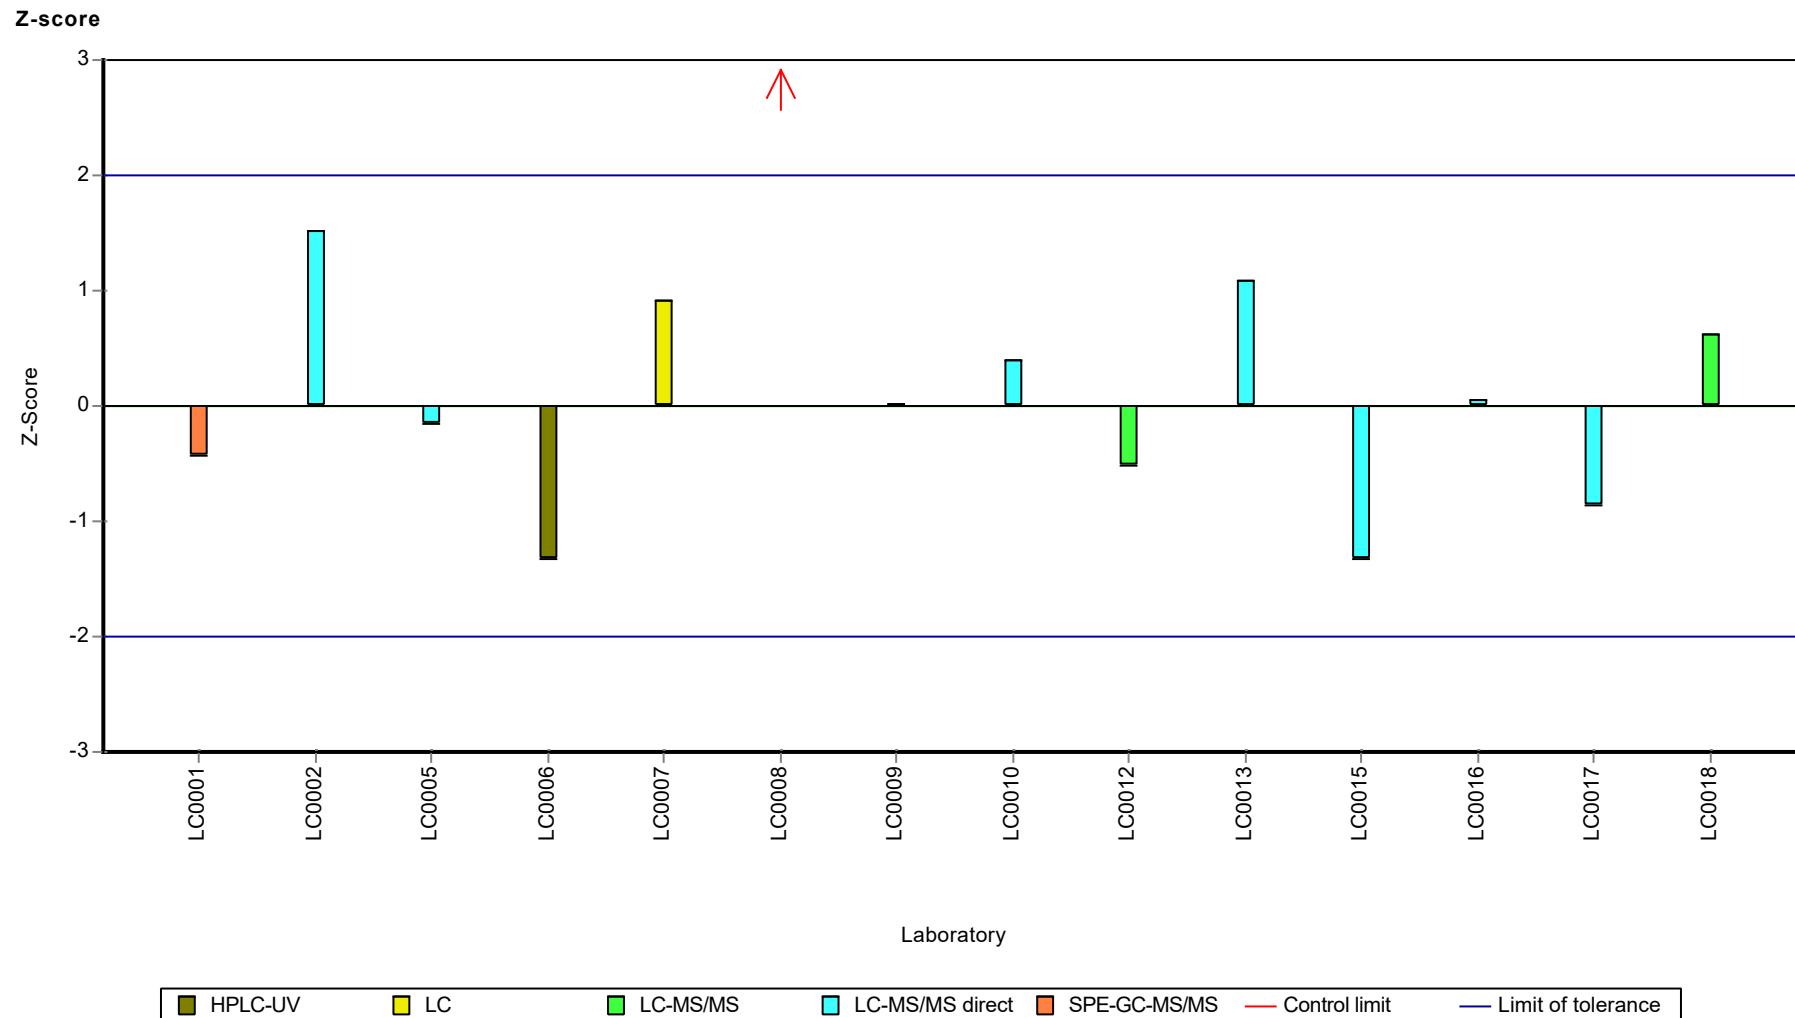

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Atrazine

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	1.89 ± 0.163
Criterion	0.208 (11 %)
Minimum - Maximum	1.18 - 2.2
Control test value ± U (k=2)	1.740 ± 0.261

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.4	0.1	-	-	
LC0002	2.0086	0.5007	106	0.56	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	1.947	0.35	103	0.27	
LC0006	1.71	0.009	90.4	-0.87	
LC0007	2.161	0.27	114	1.29	
LC0008	3.173	0.793	168	6.16	H
LC0009	1.901	0.38	100	0.04	
LC0010	2.12	0.25	112	1.1	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	1.1813	0.5907	62.4	-3.41	
LC0013	2.09	0.032	110	0.95	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	1.685	0.253	89.1	-0.99	
LC0016	1.94	0.32	103	0.23	
LC0017	1.75703	0.38655	92.9	-0.65	
LC0018	2.2	1.1	116	1.48	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	1.99 ± 0.371	1.89 ± 0.244	µg/l
Minimum	1.18	1.18	µg/l
Maximum	3.17	2.2	µg/l
Standard deviation	0.446	0.282	µg/l
rel. standard deviation	22.4	14.9	%
n	13	12	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine


### Graphical presentation of results

#### Results

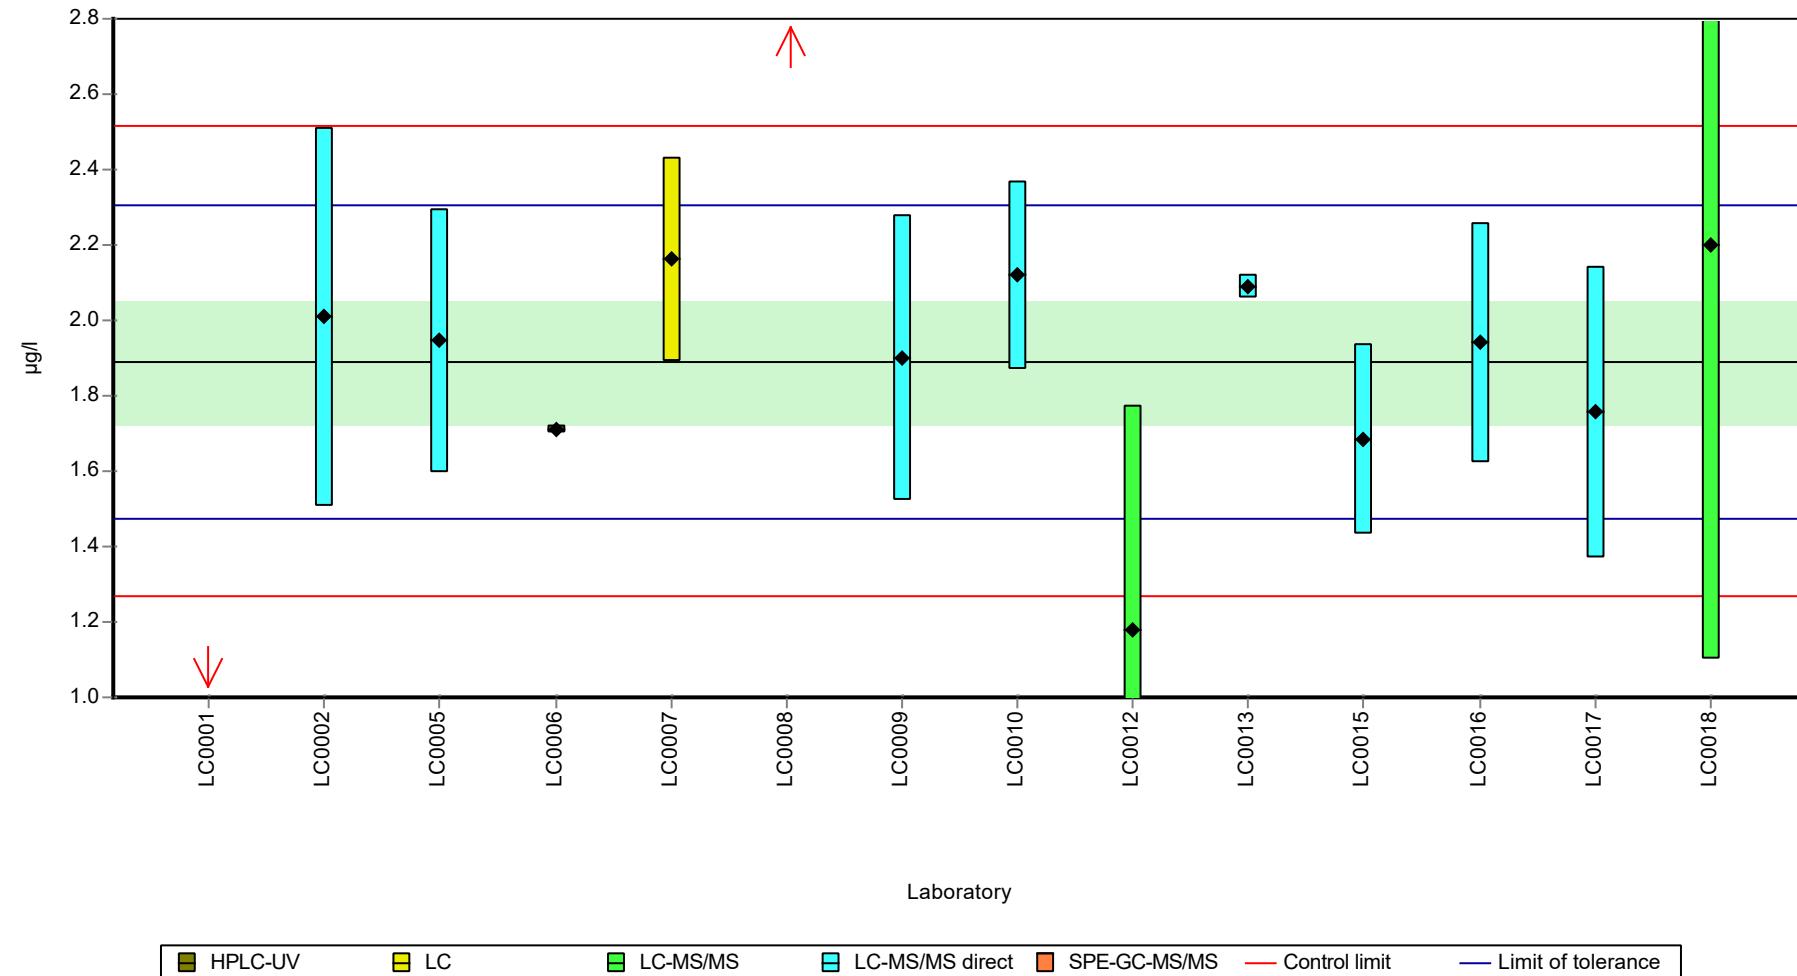


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine

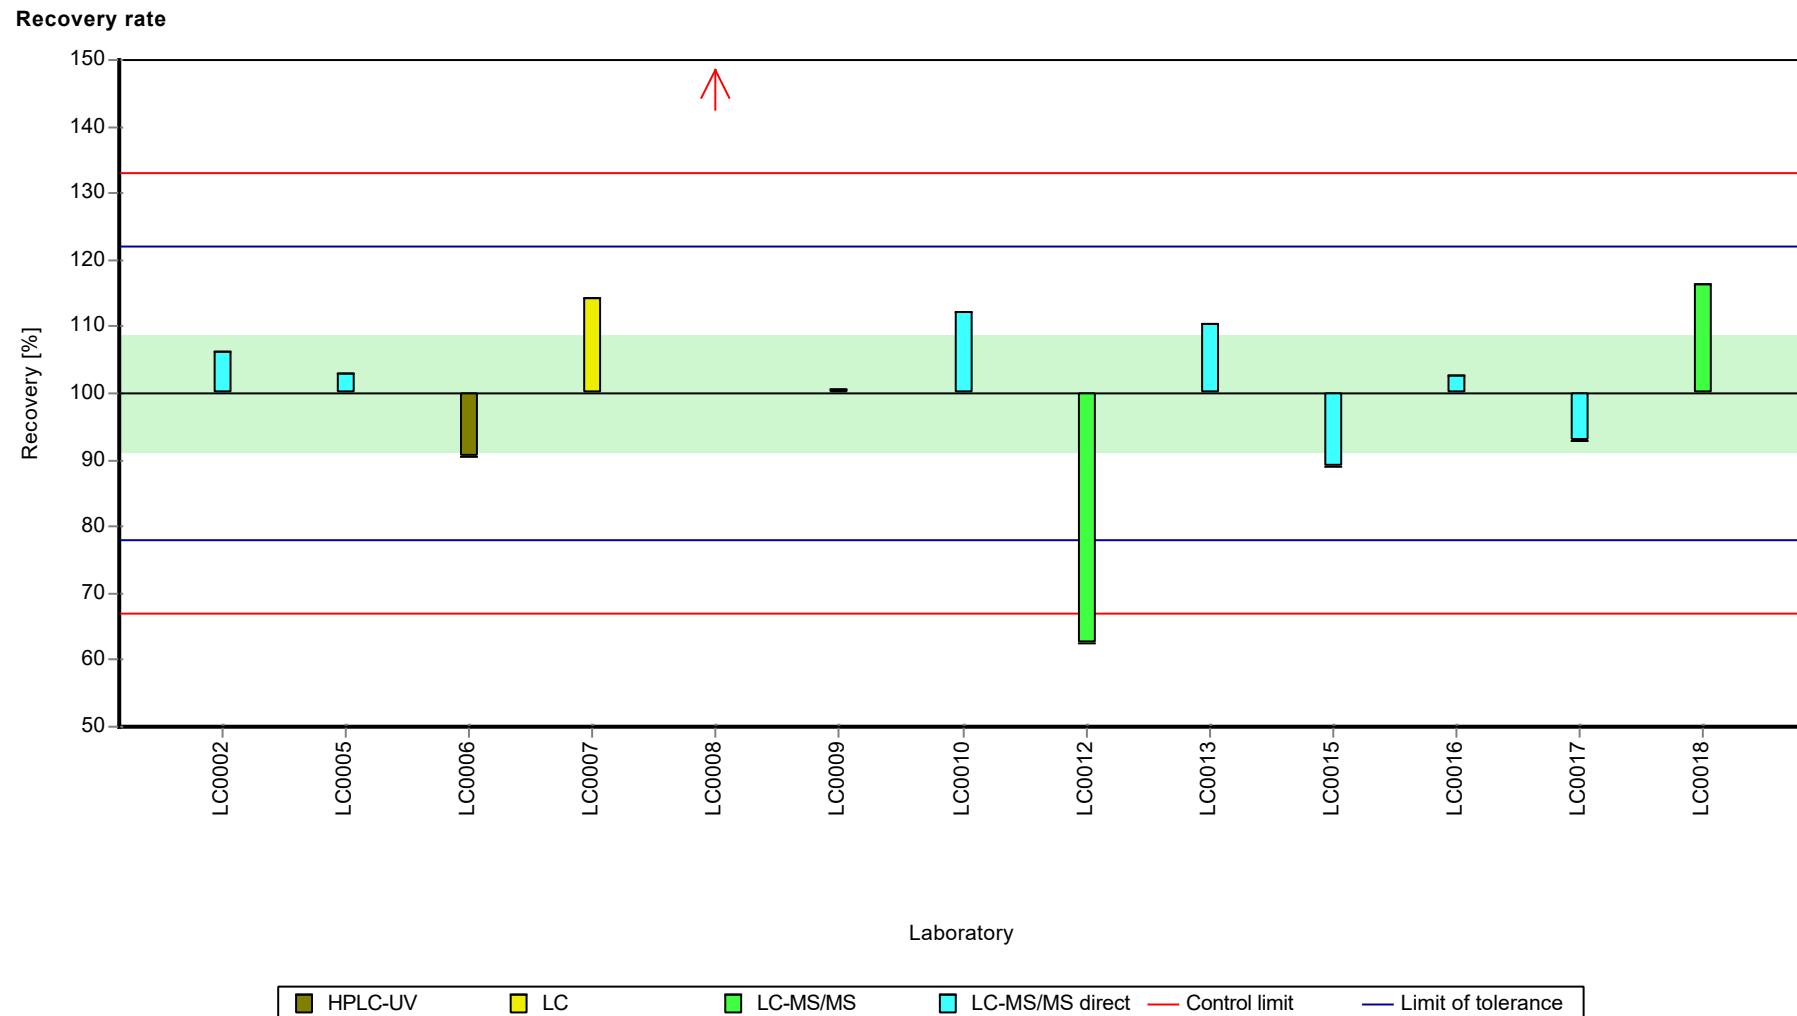

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine

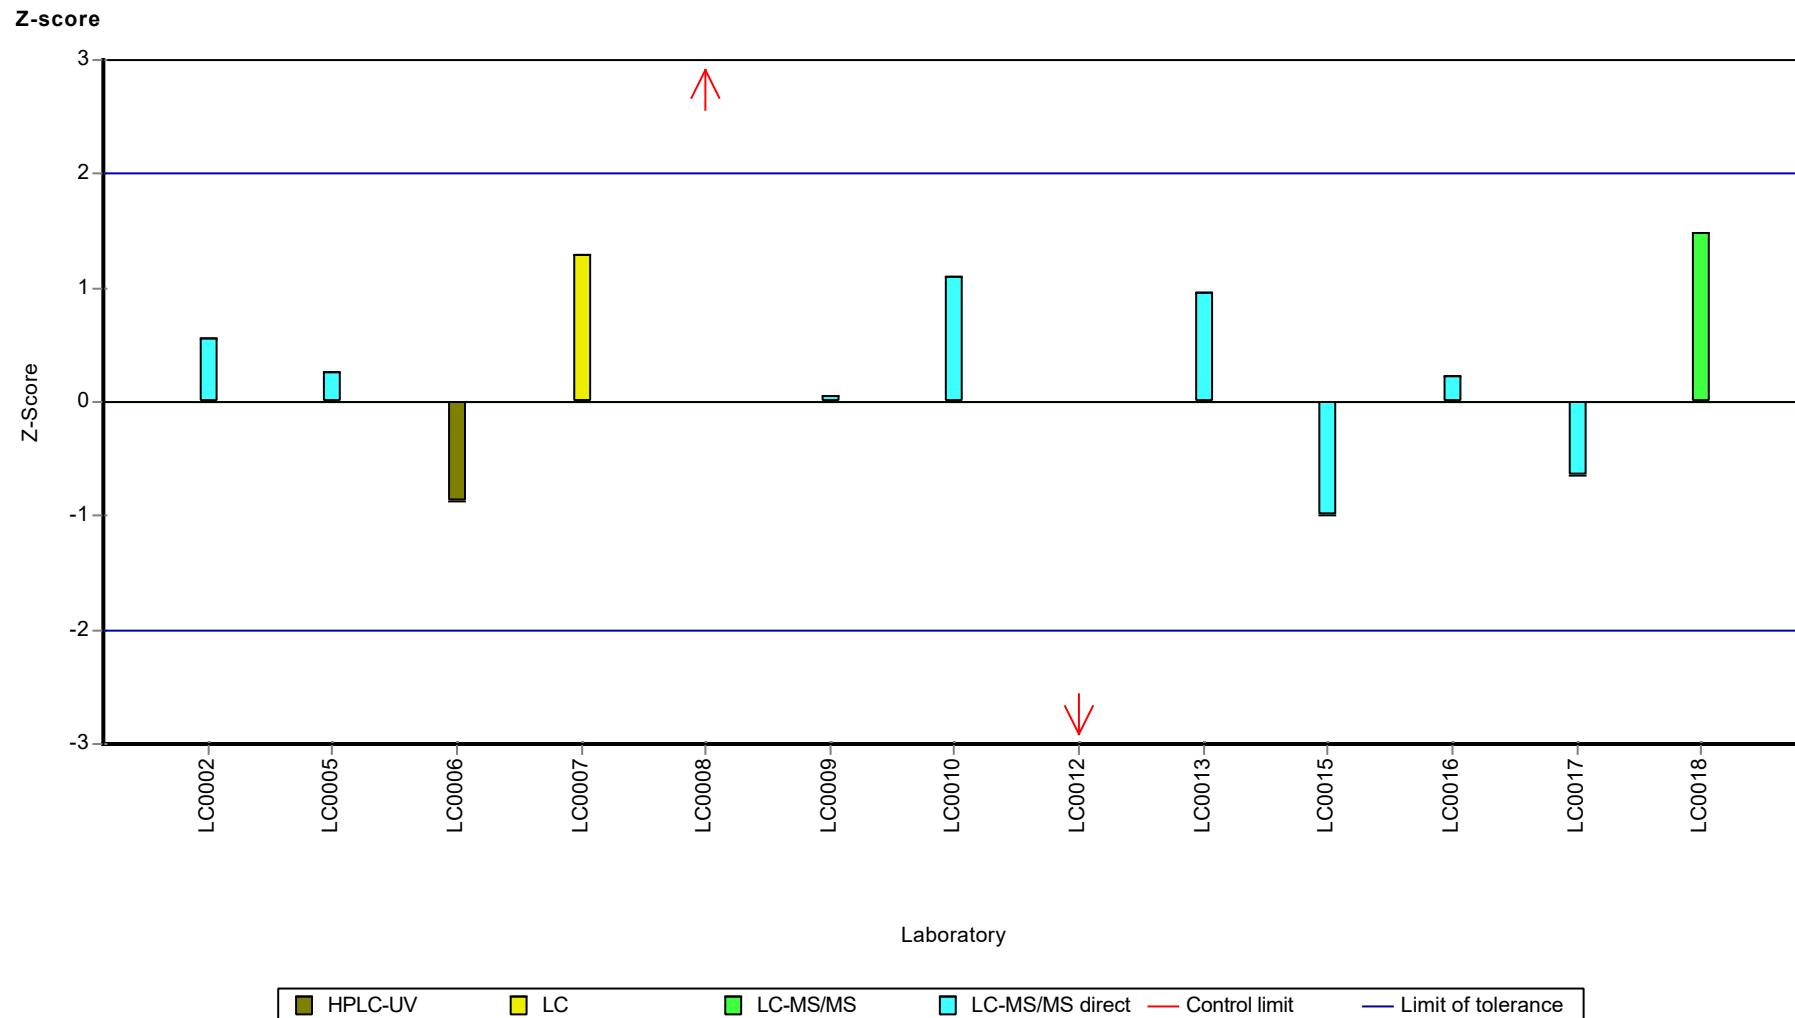

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine-desethyl

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Atrazine-desethyl

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.225 ± 0.0125
Criterion	0.027 (12 %)
Minimum - Maximum	0.193 - 0.279
Control test value ± U (k=2)	0.2120 ± 0.0317

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	0.232	0.0711	103	0.25	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.224	0.04	99.5	-0.05	
LC0006	0.209	0.003	92.8	-0.6	
LC0007	0.279	0.035	124	1.99	
LC0008	0.237	0.059	105	0.44	
LC0009	0.222	0.055	98.6	-0.12	
LC0010	0.243	0.051	108	0.66	
LC0011	0.193	0.08	85.7	-1.19	
LC0012	0.0495	0.0248	22	-6.5	H
LC0013	0.22	0.001	97.7	-0.19	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.196	0.029	87	-1.08	
LC0016	0.208	0.039	92.3	-0.64	
LC0017	0.22508	0.04952	99.9	-0.01	
LC0018	0.24	0.12	107	0.55	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.213 ± 0.0415	0.225 ± 0.0188	µg/l
Minimum	0.0495	0.193	µg/l
Maximum	0.279	0.279	µg/l
Standard deviation	0.0517	0.0226	µg/l
rel. standard deviation	24.3	10 %	
n	14	13	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine-desethyl


#### Graphical presentation of results

##### Results

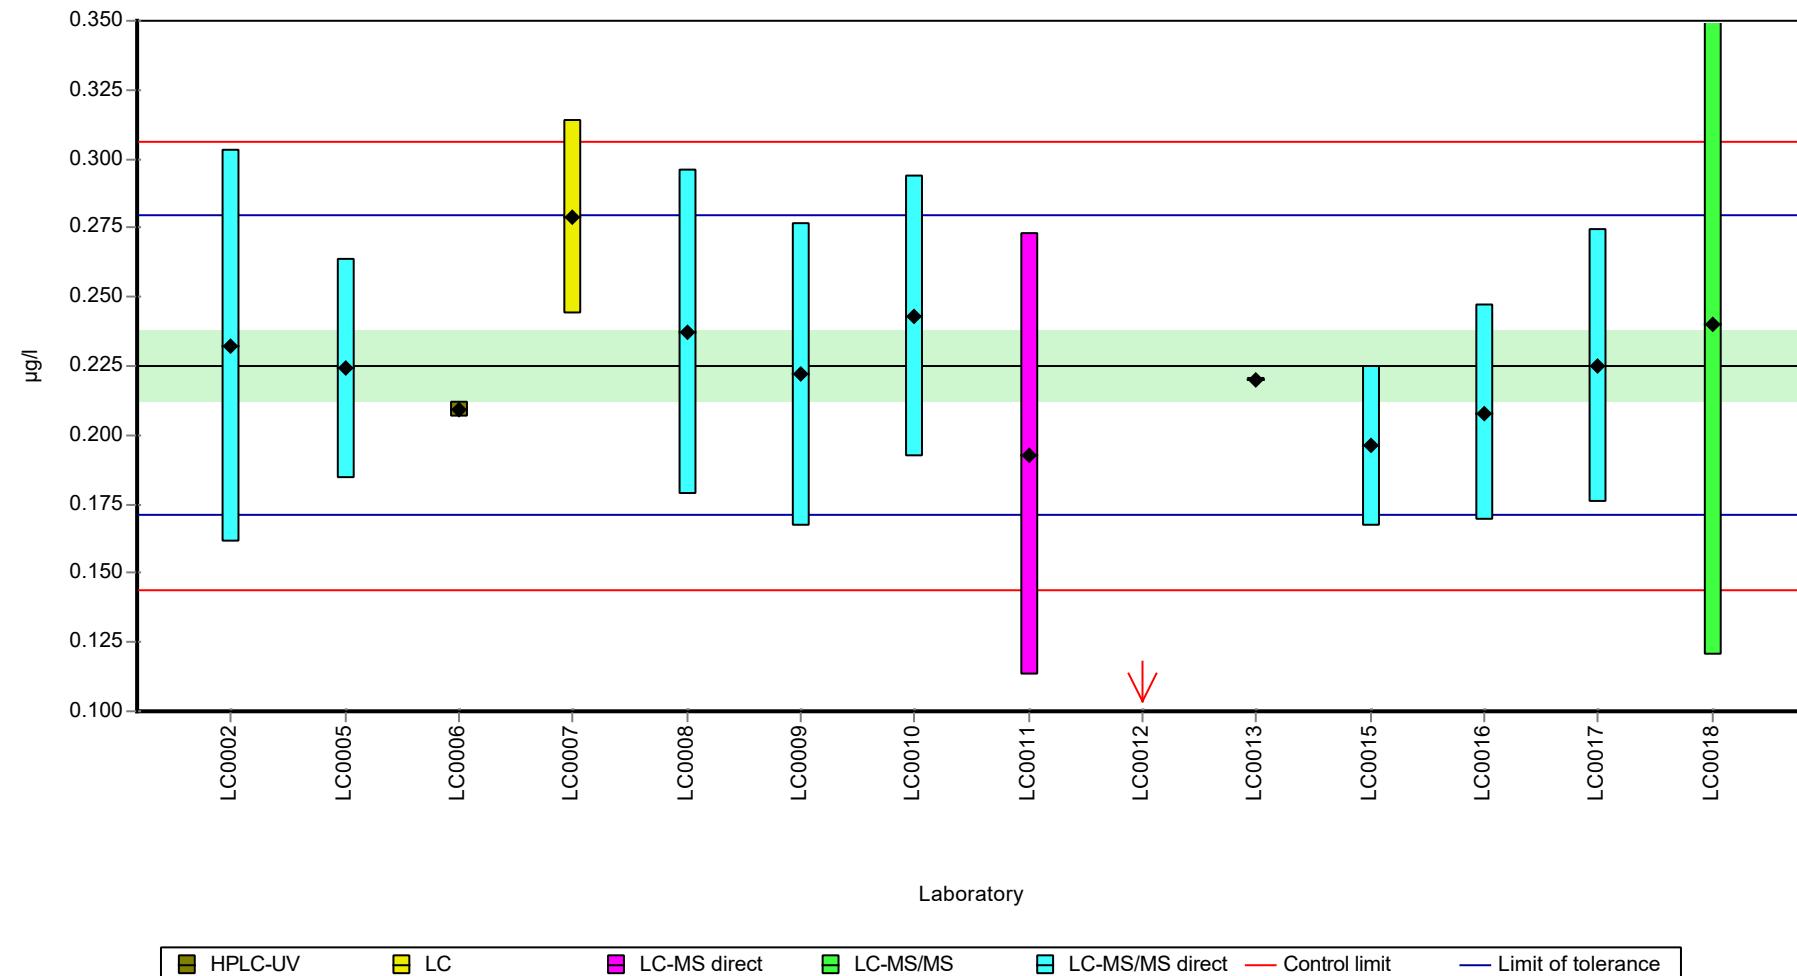


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine-desethyl

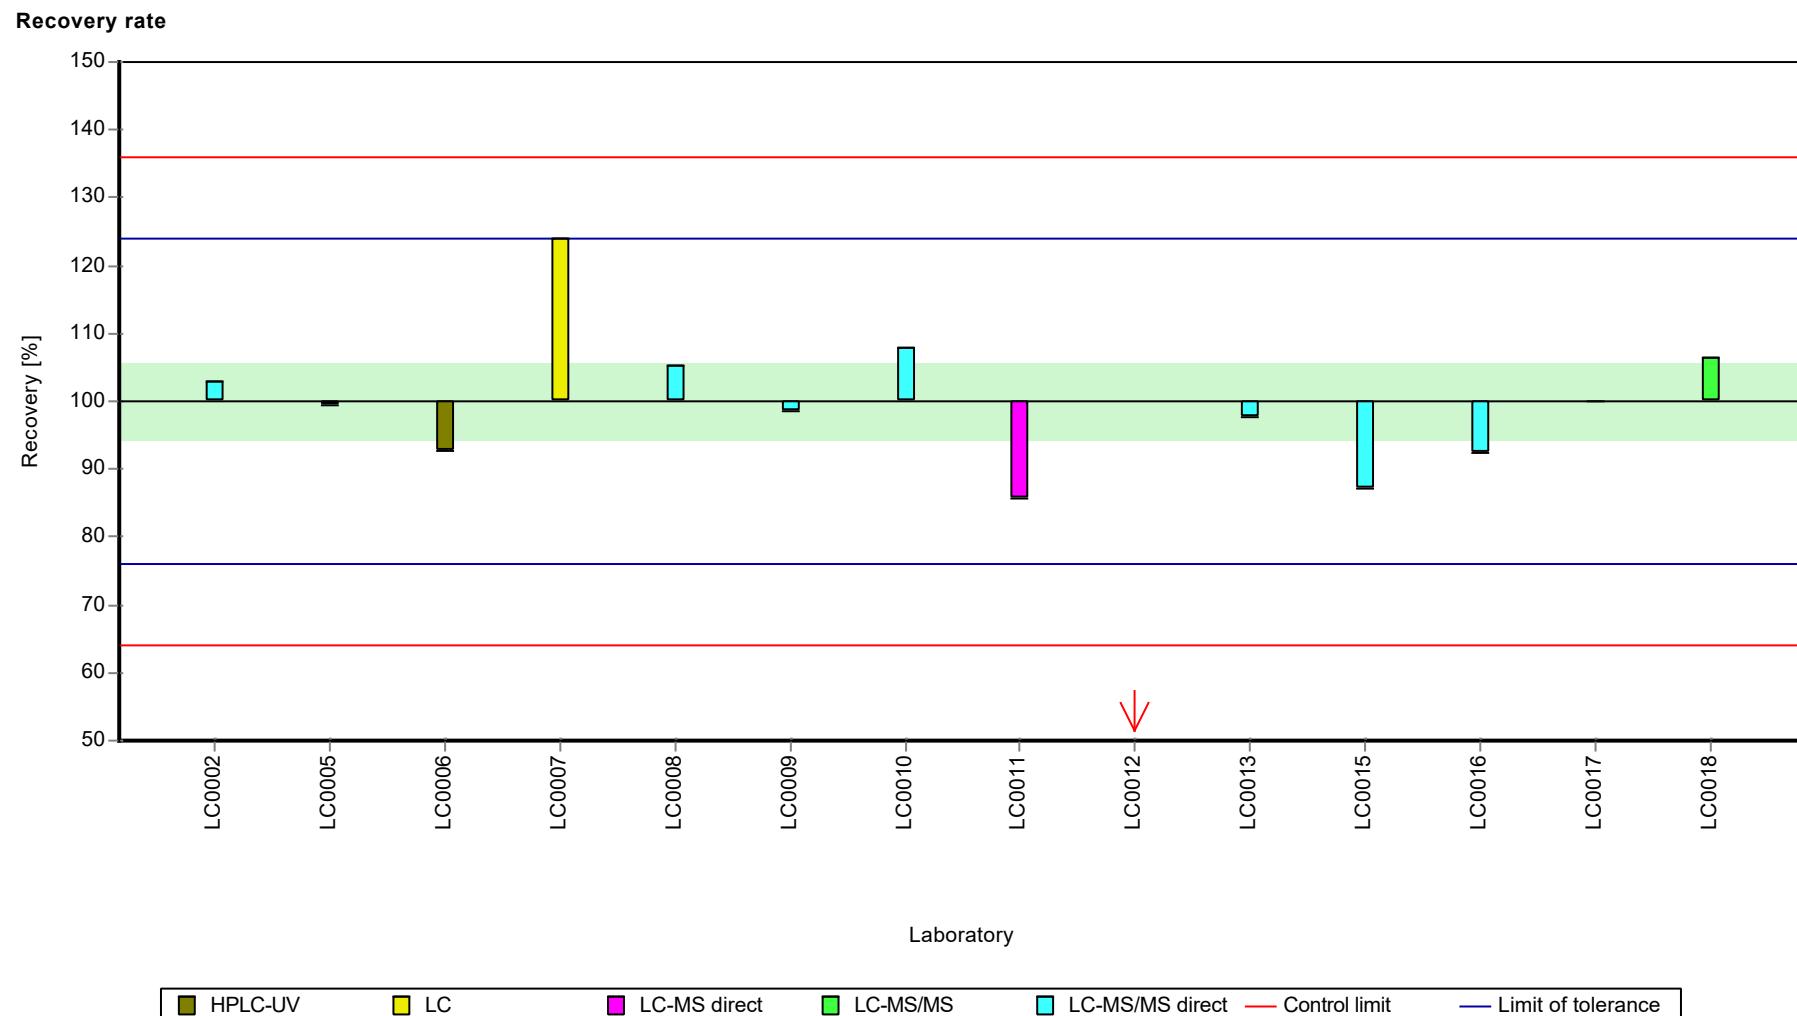

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine-desethyl

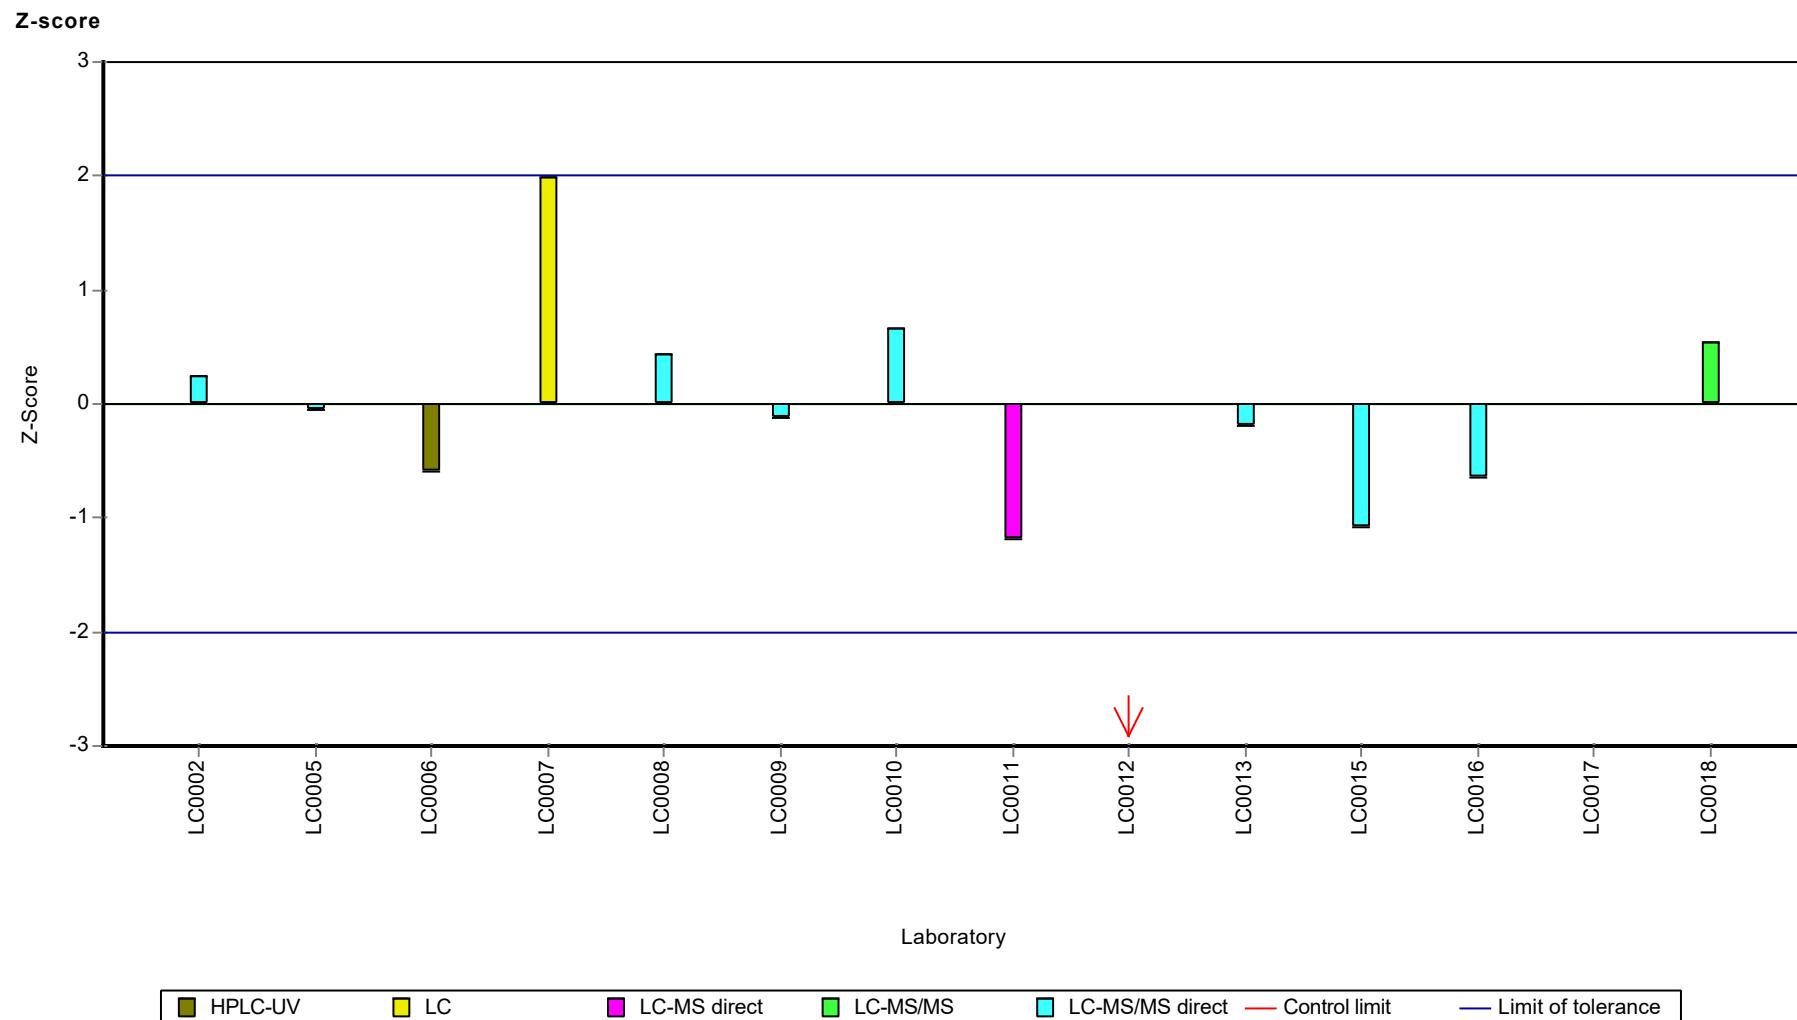

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine-desethyl

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Atrazine-desethyl

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	2.12 ± 0.139
Criterion	0.254 (12 %)
Minimum - Maximum	1.72 - 2.63
Control test value ± U (k=2)	1.960 ± 0.294

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	2.0336	0.6233	96.1	-0.33	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	2.11	0.38	99.7	-0.02	
LC0006	2.03	0.014	95.9	-0.34	
LC0007	2.435	0.304	115	1.25	
LC0008	2.08	0.52	98.3	-0.14	
LC0009	2.629	0.657	124	2.02	
LC0010	2.34	0.49	111	0.88	
LC0011	1.715	0.5	81	-1.58	
LC0012	0.5606	0.2803	26.5	-6.13	H
LC0013	2.1	0.02	99.2	-0.06	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	1.973	0.296	93.2	-0.56	
LC0016	1.89	0.36	89.3	-0.89	
LC0017	1.87688	0.41291	88.7	-0.94	
LC0018	2.3	1.15	109	0.72	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	2.01 ± 0.385	2.12 ± 0.209	µg/l
Minimum	0.561	1.72	µg/l
Maximum	2.63	2.63	µg/l
Standard deviation	0.481	0.251	µg/l
rel. standard deviation	24	11.8	%
n	14	13	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine-desethyl


#### Graphical presentation of results

##### Results

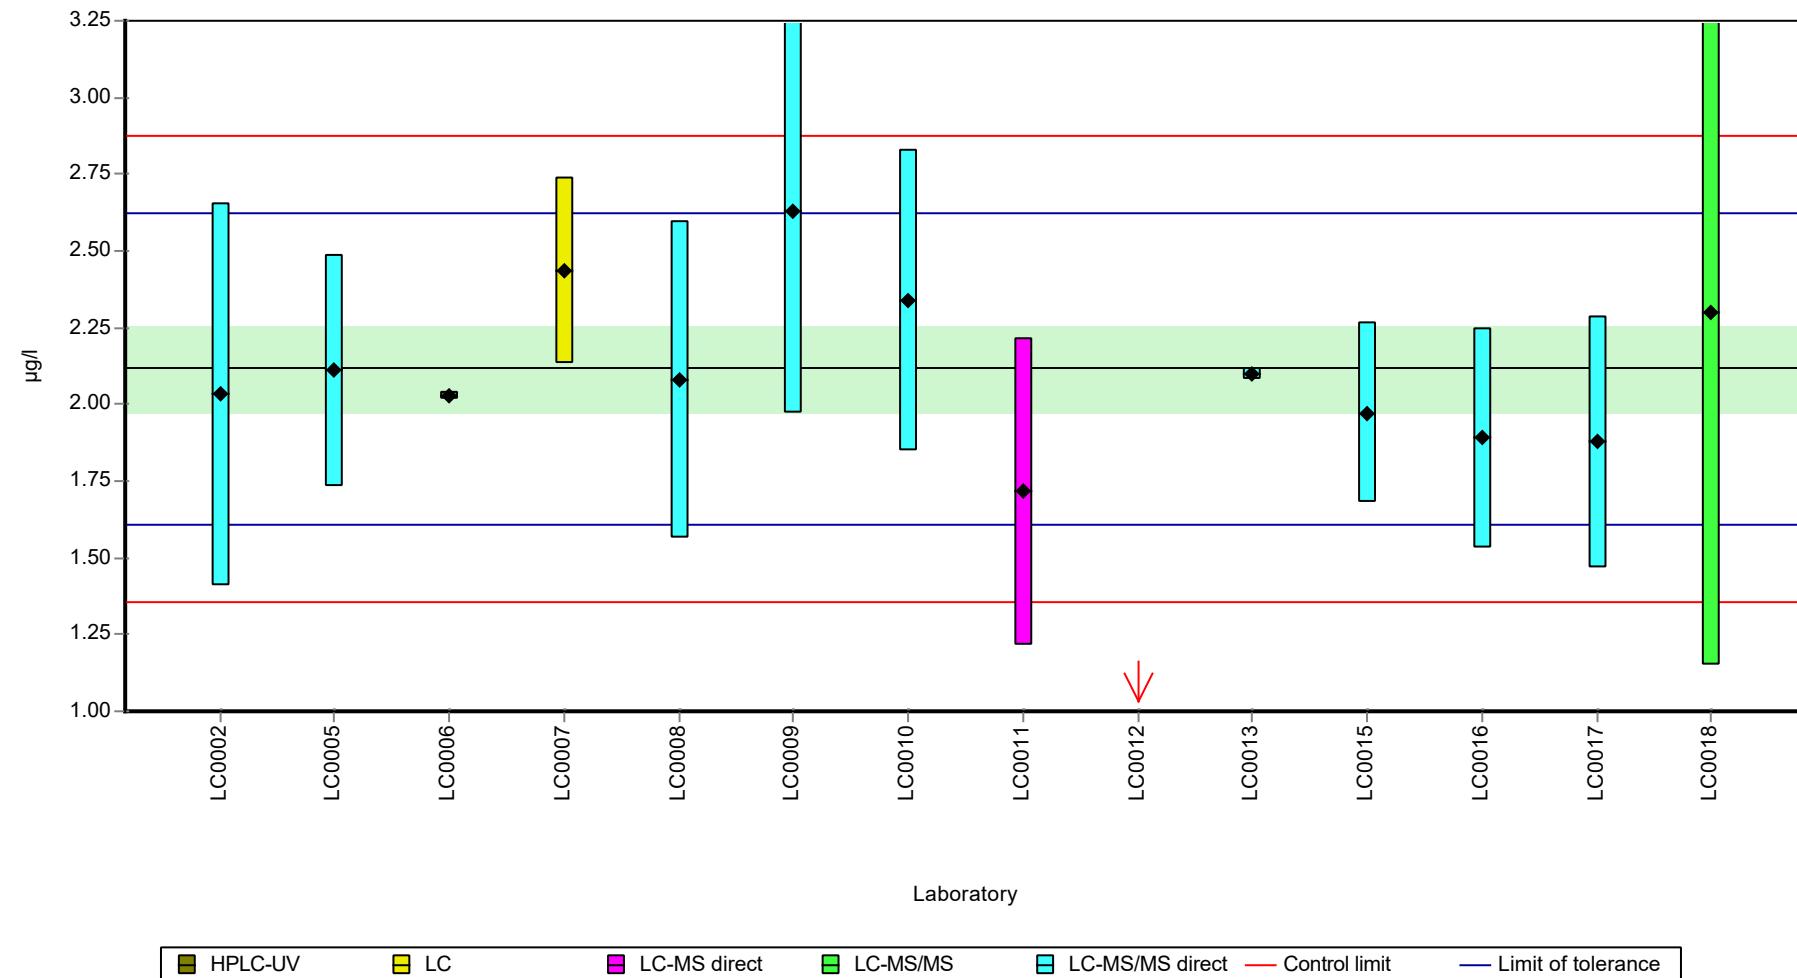


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine-desethyl

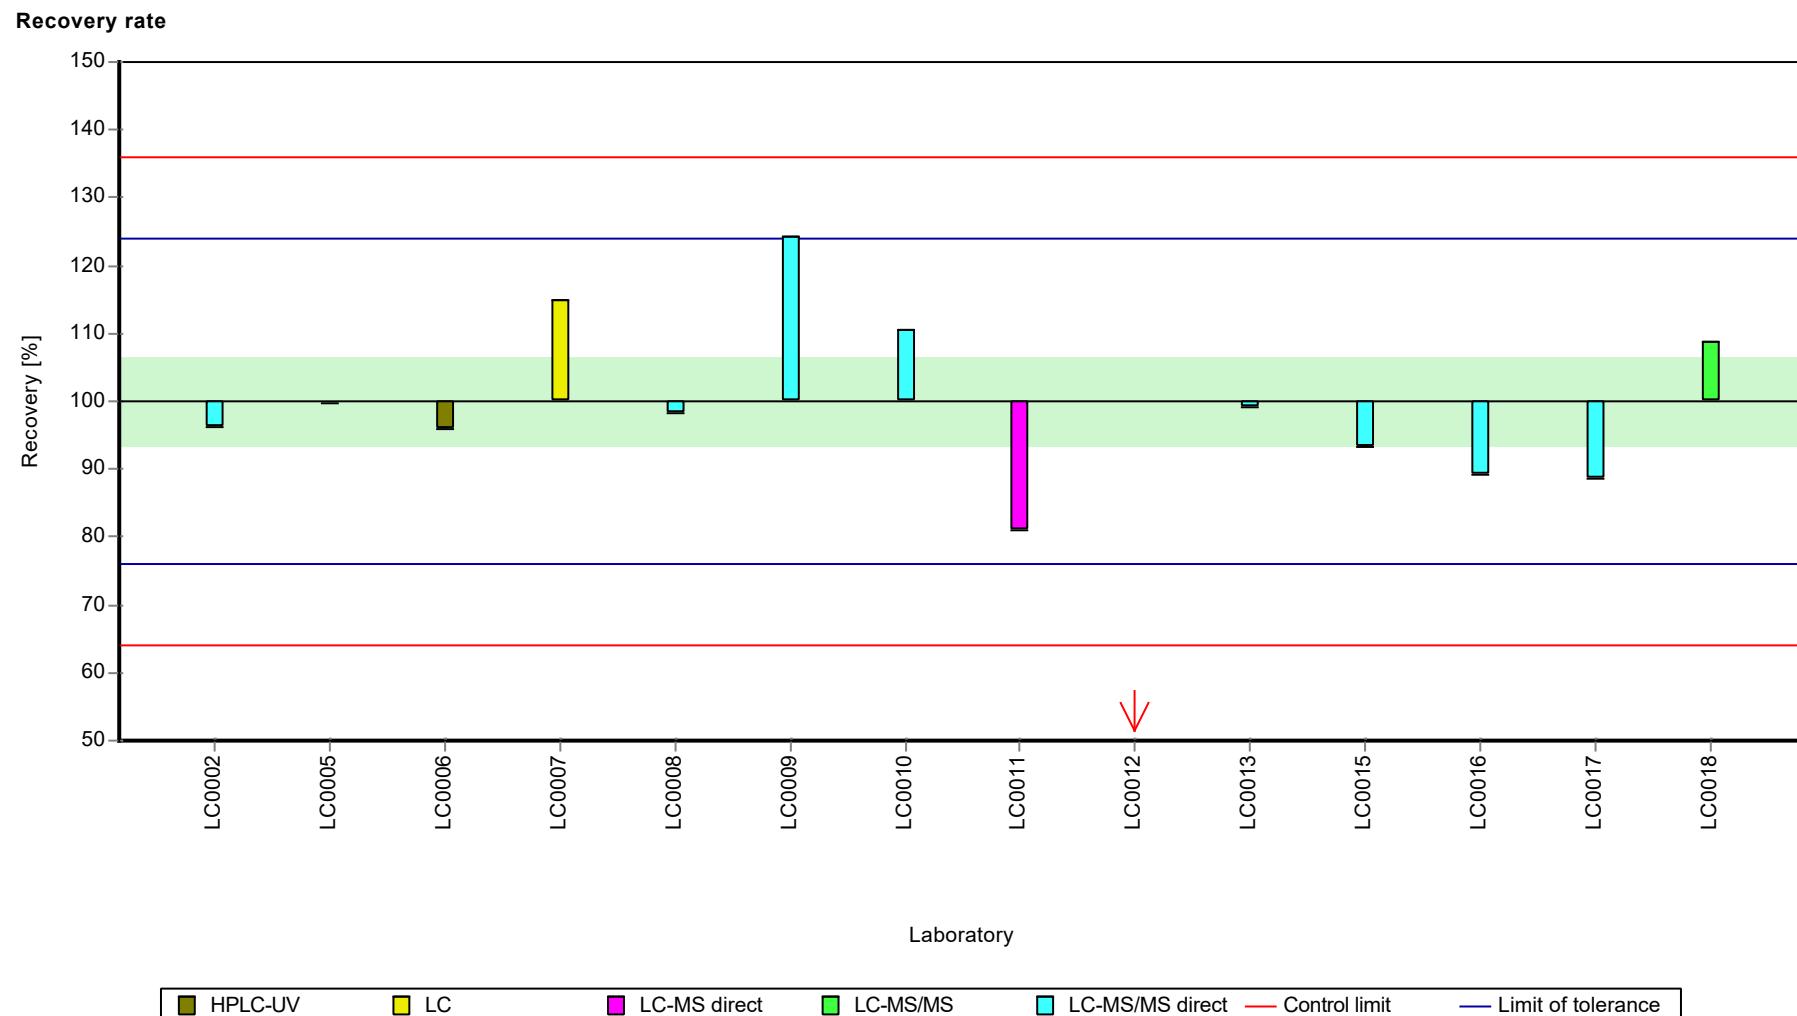

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine-desethyl

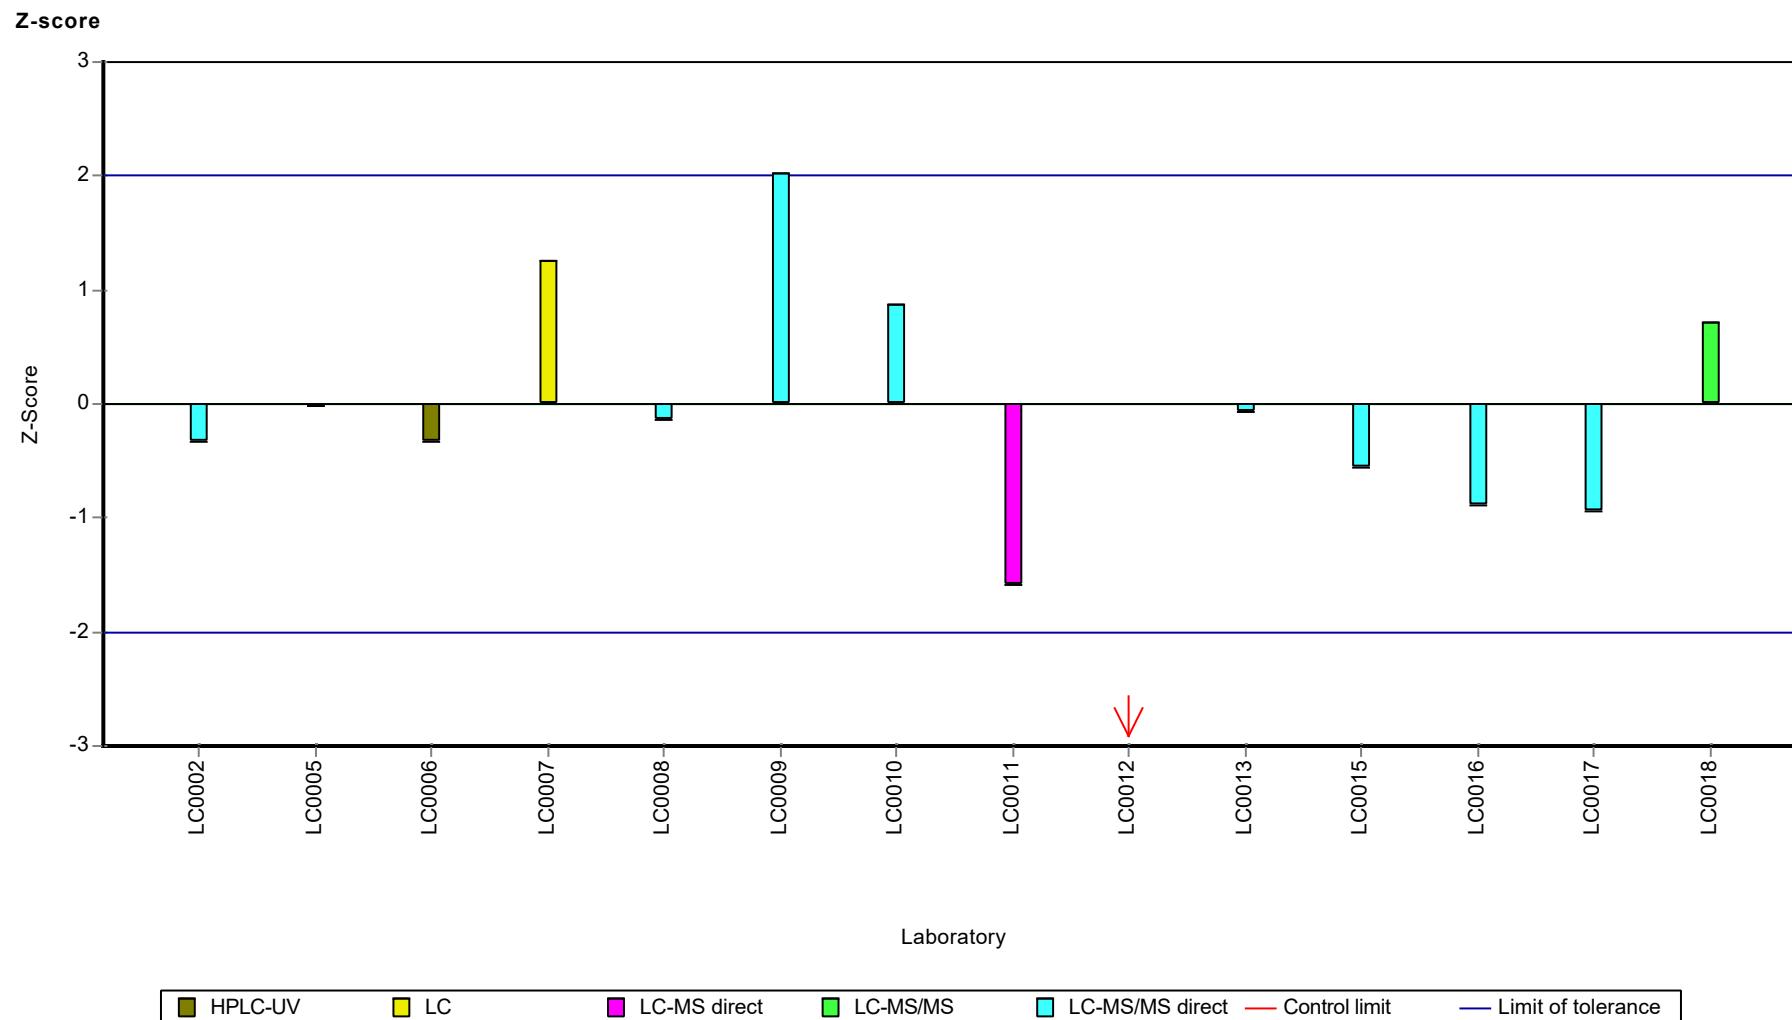

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine-desisopropyl

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Atrazine-desisopropyl

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.303 ± 0.023
Criterion	0.0424 (14 %)
Minimum - Maximum	0.22 - 0.368
Control test value ± U (k=2)	0.2630 ± 0.0394

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	-
LC0002	0.309	0.0873	102	0.15	
LC0003	-	-	-	-	-
LC0004	0.278	0.122	91.8	-0.58	
LC0005	0.341	0.061	113	0.9	
LC0006	0.239	0.005	79	-1.5	
LC0007	0.368	0.046	122	1.54	
LC0008	0.352	0.088	116	1.16	
LC0009	0.31	0.062	102	0.17	
LC0010	0.319	0.048	105	0.38	
LC0011	0.255	0.11	84.2	-1.13	
LC0012	-	-	-	-	-
LC0013	0.302	0.006	99.8	-0.02	
LC0014	-	-	-	-	-
LC0015	0.22	0.033	72.7	-1.95	
LC0016	0.287	0.071	94.8	-0.37	
LC0017	0.33768	0.07429	112	0.83	
LC0018	0.32	0.16	106	0.41	
LC0019	-	-	-	-	-

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.303 ± 0.0345	0.303 ± 0.0345	µg/l
Minimum	0.22	0.22	µg/l
Maximum	0.368	0.368	µg/l
Standard deviation	0.043	0.043	µg/l
rel. standard deviation	14.2	14.2	%
n	14	14	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine-desisopropyl


#### Graphical presentation of results

##### Results

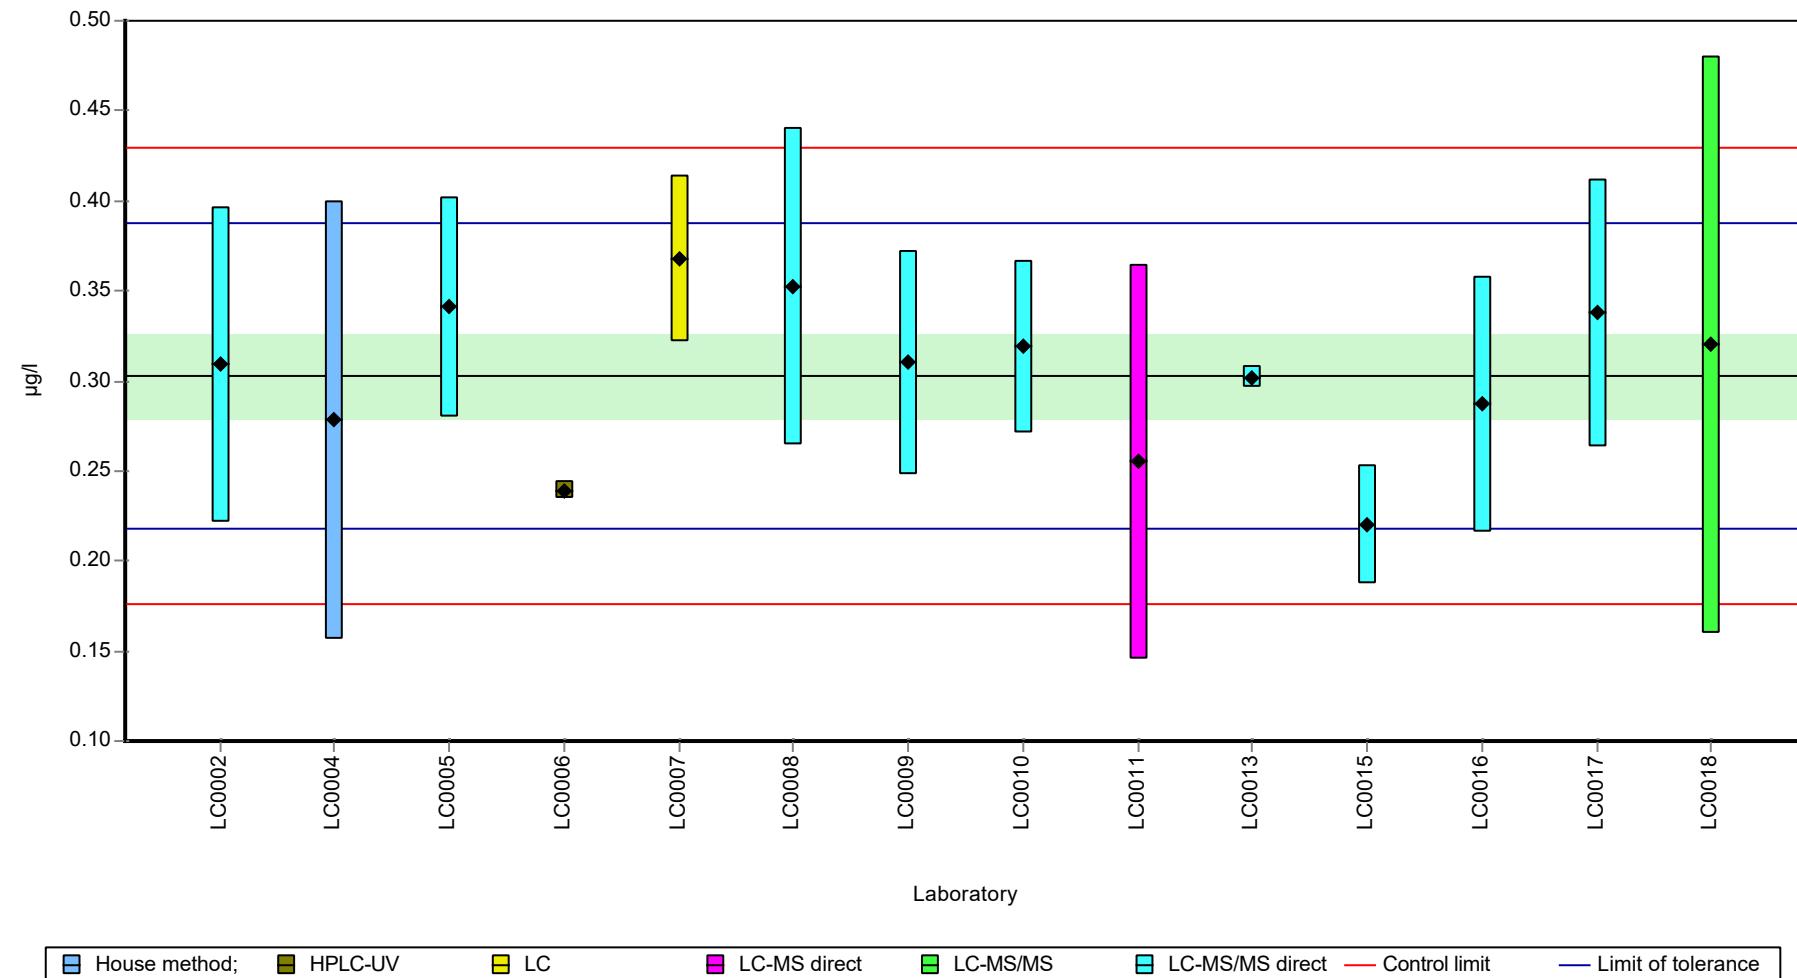


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine-desisopropyl

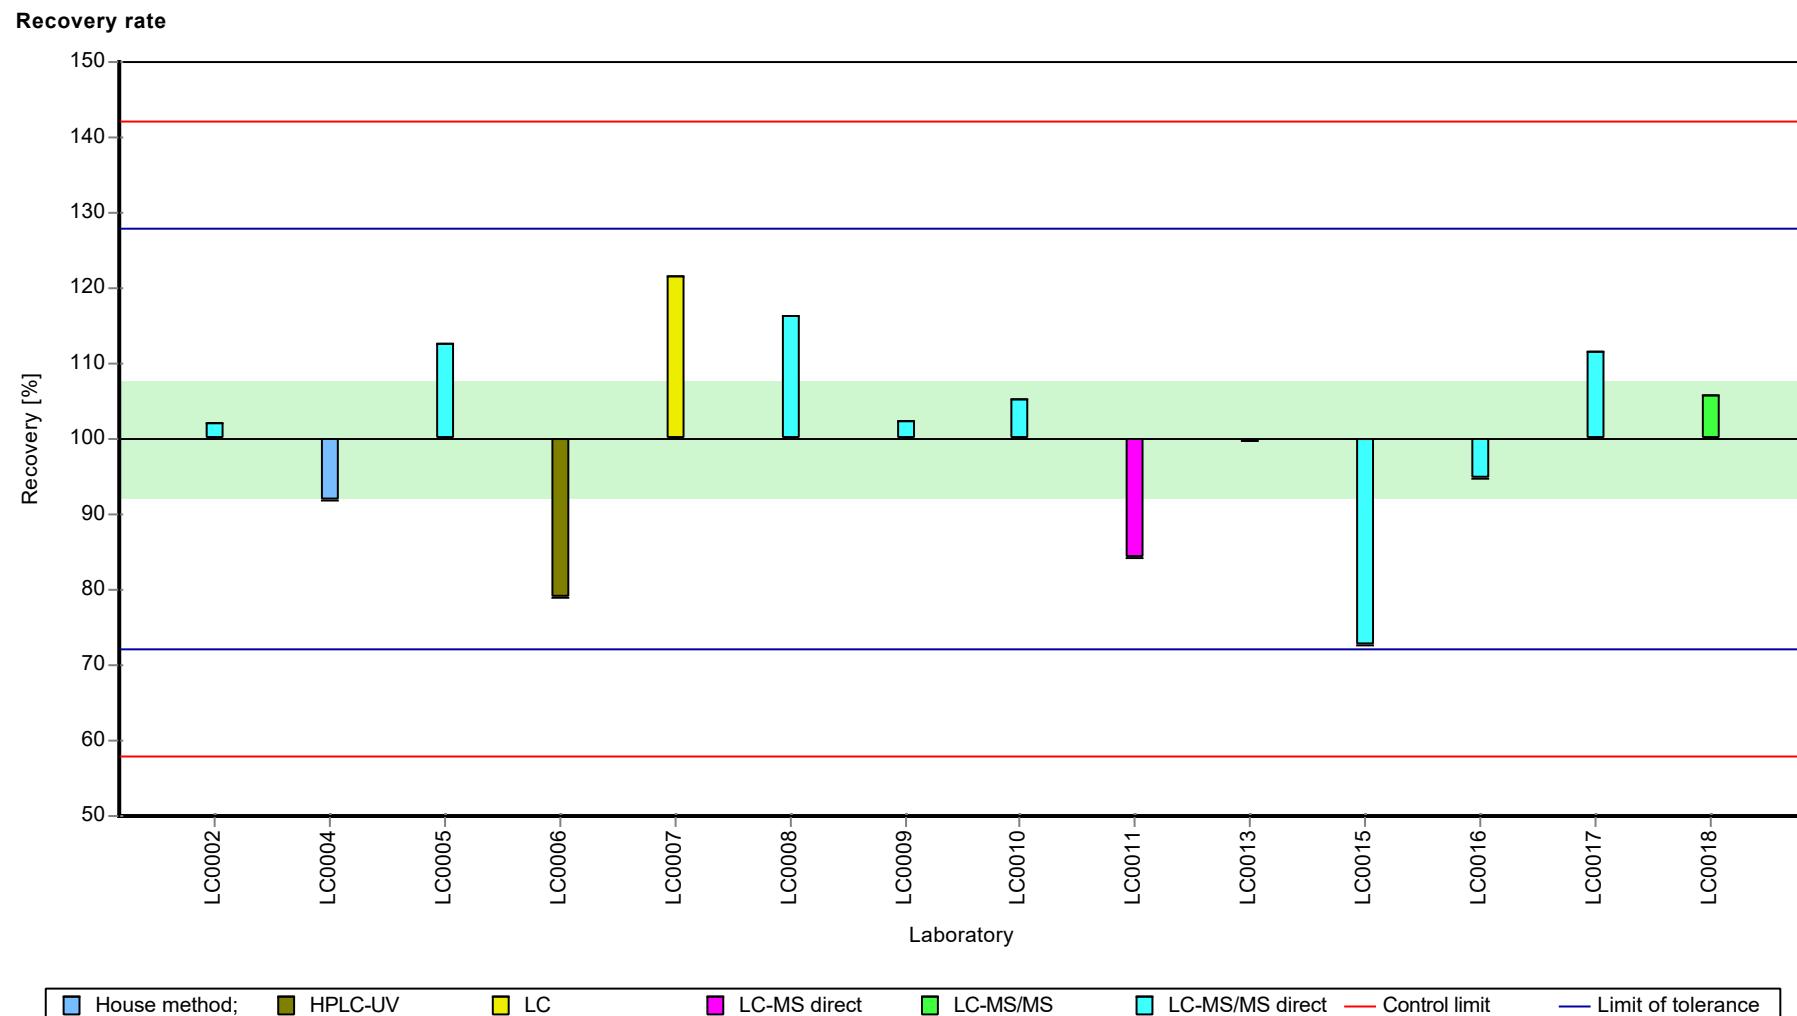

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Atrazine-desisopropyl

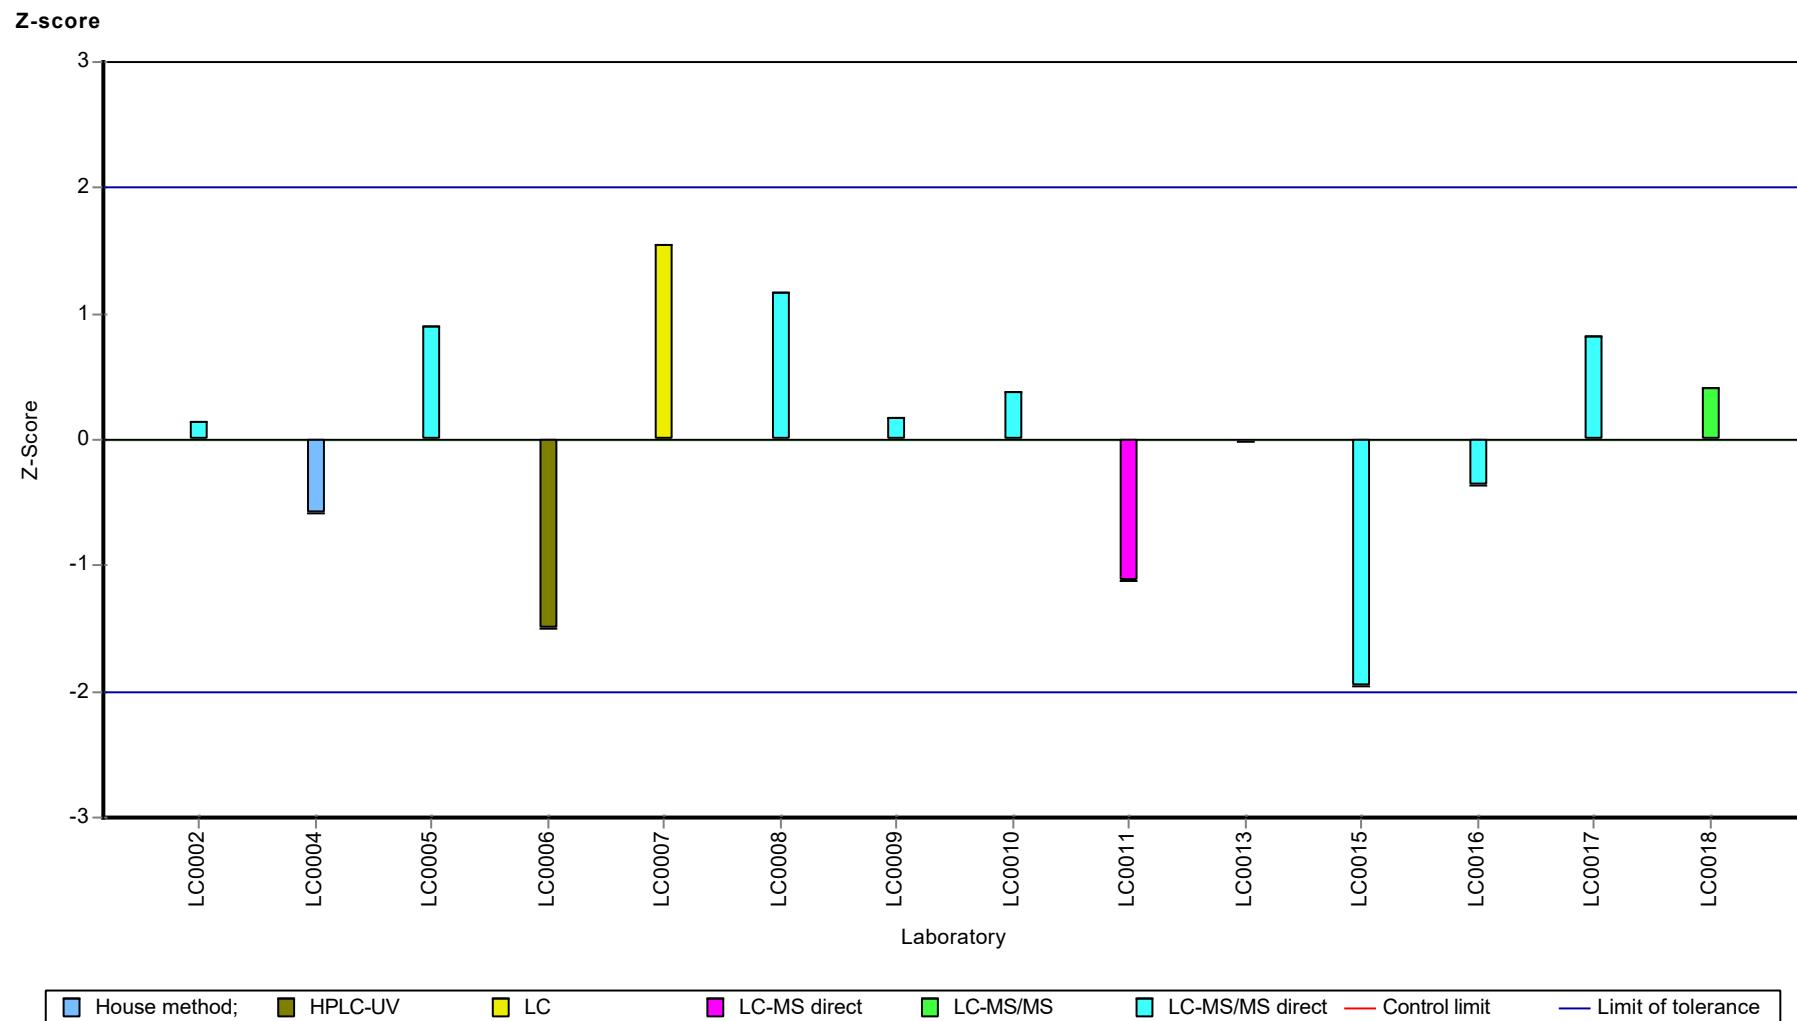

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine-desisopropyl

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Atrazine-desisopropyl

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	2.28 ± 0.151
Criterion	0.32 (14 %)
Minimum - Maximum	1.73 - 2.7
Control test value ± U (k=2)	2.380 ± 0.356

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	-
LC0002	2.3701	0.6698	104	0.27	
LC0003	-	-	-	-	-
LC0004	2.12	0.93	92.9	-0.51	
LC0005	2.506	0.451	110	0.7	
LC0006	1.99	0.028	87.2	-0.92	
LC0007	2.426	0.303	106	0.45	
LC0008	2.703	0.676	118	1.31	
LC0009	2.631	0.526	115	1.09	
LC0010	2.51	0.38	110	0.71	
LC0011	1.725	0.5	75.6	-1.75	
LC0012	-	-	-	-	-
LC0013	2.35	0.015	103	0.21	
LC0014	-	-	-	-	-
LC0015	2.039	0.306	89.3	-0.76	
LC0016	2.11	0.52	92.4	-0.54	
LC0017	2.0293	0.44644	88.9	-0.79	
LC0018	2.45	1.23	107	0.52	
LC0019	-	-	-	-	-

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	2.28 ± 0.226	2.28 ± 0.226	µg/l
Minimum	1.73	1.73	µg/l
Maximum	2.7	2.7	µg/l
Standard deviation	0.282	0.282	µg/l
rel. standard deviation	12.4	12.4	%
n	14	14	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine-desisopropyl


#### Graphical presentation of results

##### Results

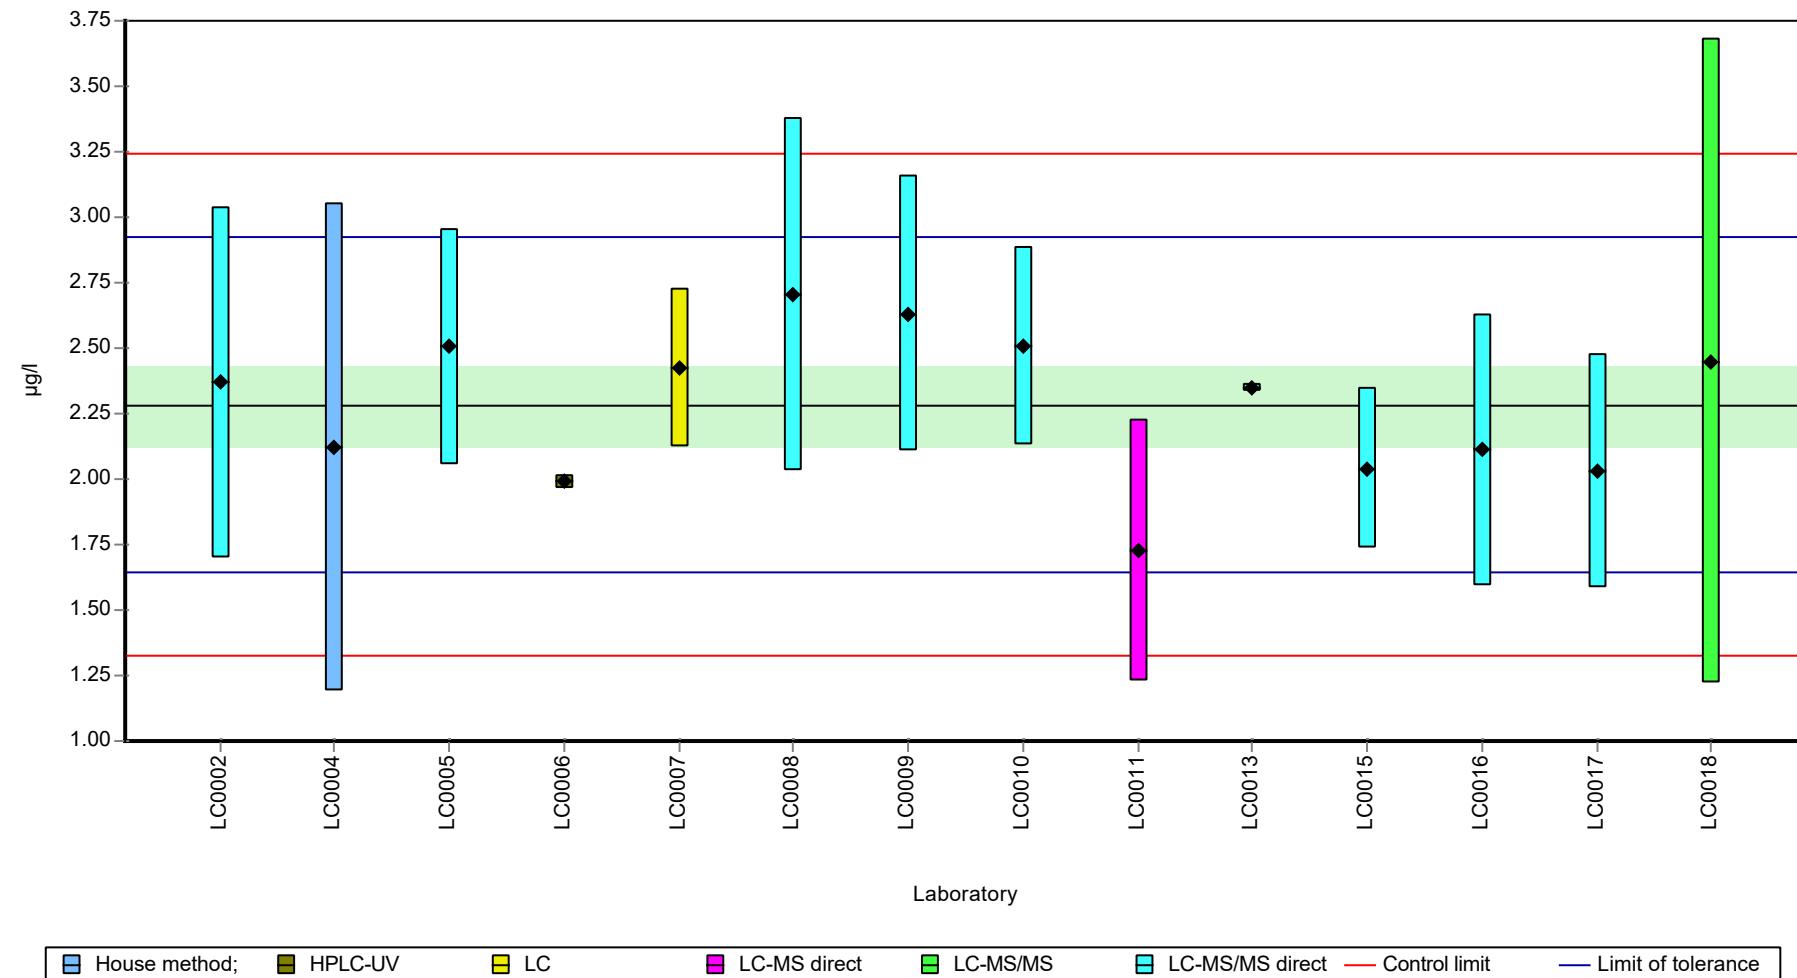


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine-desisopropyl

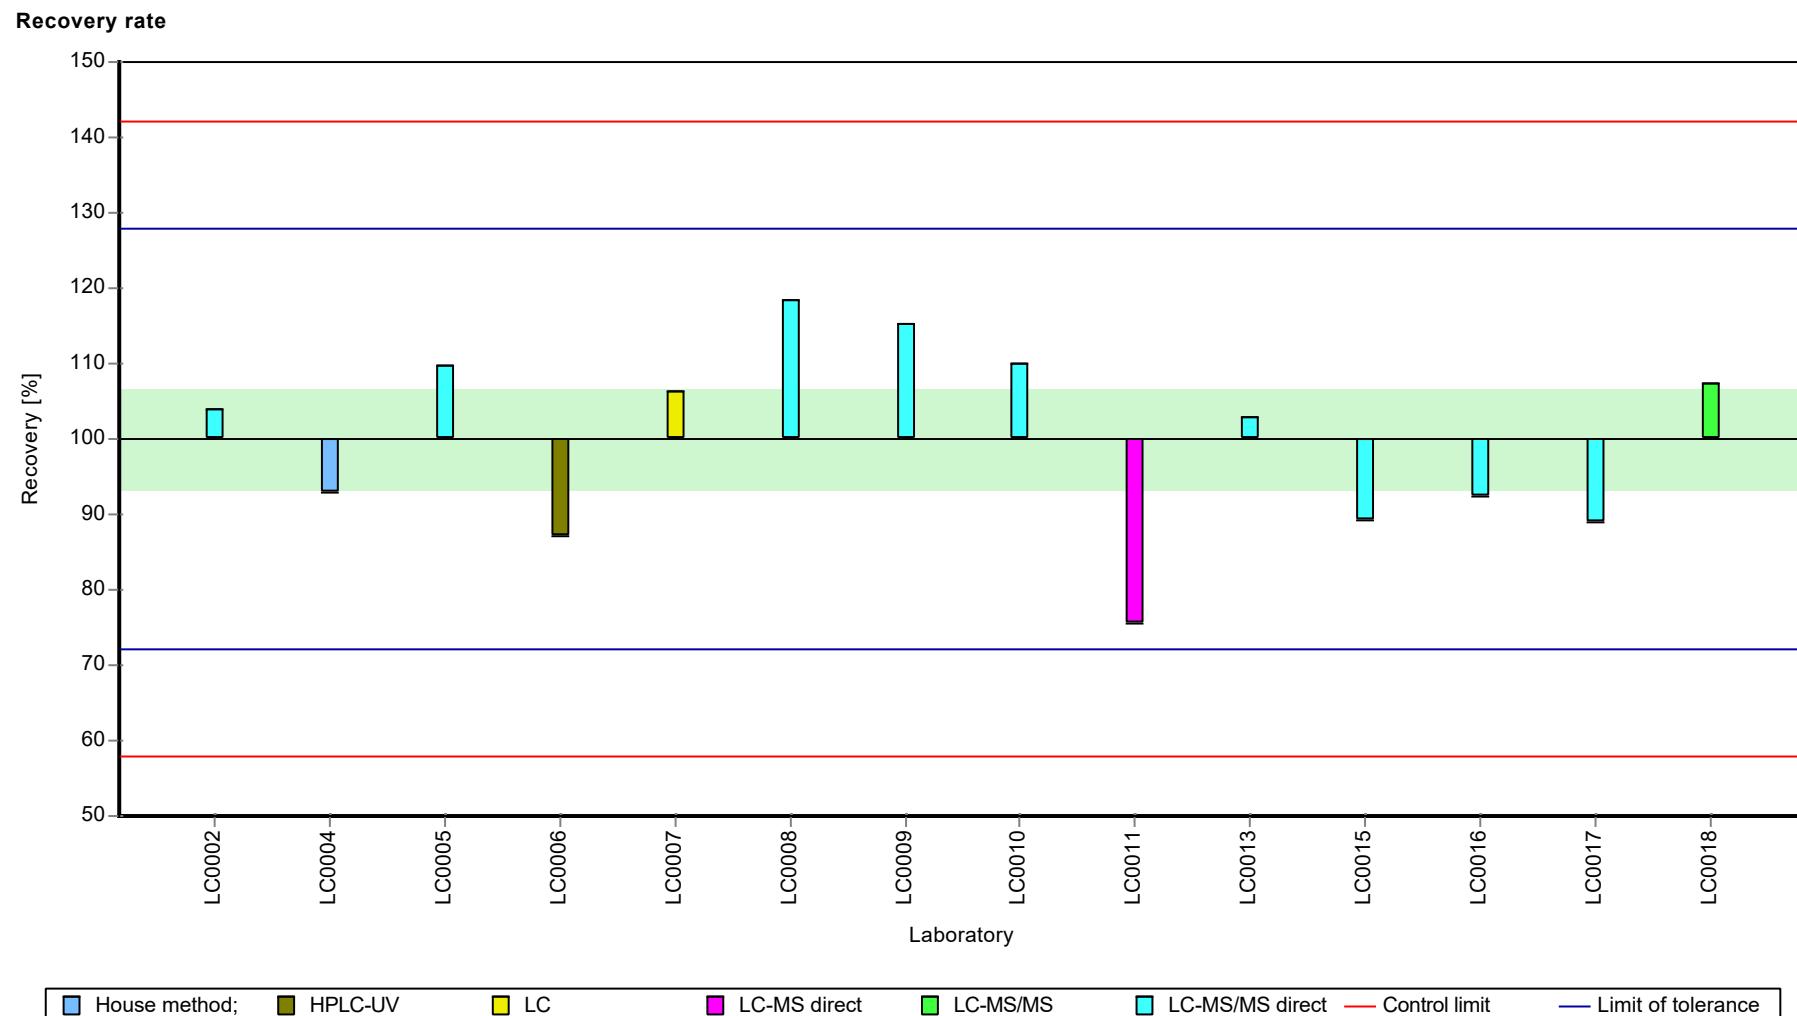

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Atrazine-desisopropyl

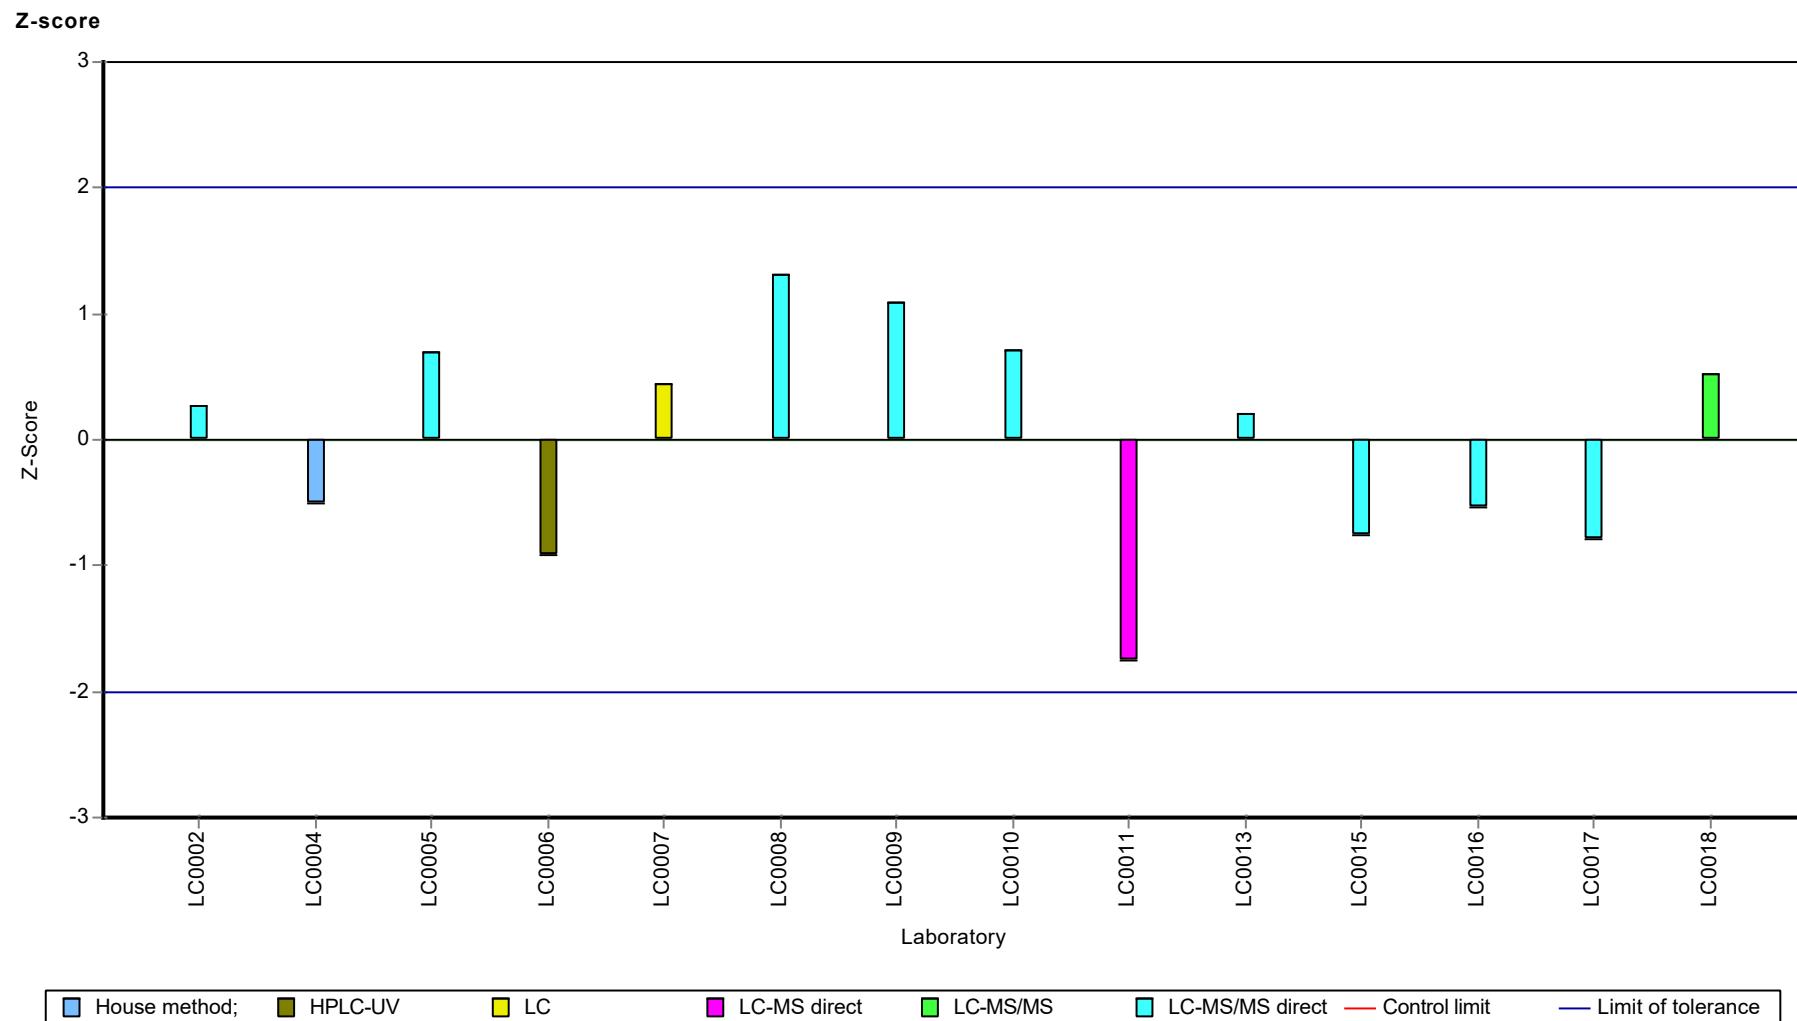

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Bromacil

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Bromacil

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.222 ± 0.0115
Criterion	0.0311 (14 %)
Minimum - Maximum	0.198 - 0.272
Control test value ± U (k=2)	0.213 ± 0.032

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	0.212	0.093	95.5	-0.32	
LC0005	0.2	0.036	90.1	-0.71	
LC0006	0.22	0.009	99.1	-0.07	
LC0007	0.244	0.03	110	0.71	
LC0008	0.198	0.05	89.2	-0.77	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	0.241	0.053	109	0.61	
LC0011	0.204	0.09	91.9	-0.58	
LC0012	0.2281	0.1141	103	0.19	
LC0013	0.272	0.002	122	1.61	
LC0014	0.215	0.056	96.8	-0.23	
LC0015	0.202	0.03	91	-0.64	
LC0016	0.229	0.036	103	0.22	
LC0017	0.20352	0.04477	91.7	-0.6	
LC0018	0.24	0.12	108	0.58	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.222 ± 0.0173	0.222 ± 0.0173	µg/l
Minimum	0.198	0.198	µg/l
Maximum	0.272	0.272	µg/l
Standard deviation	0.0215	0.0215	µg/l
rel. standard deviation	9.7	9.7	%
n	14	14	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Bromacil


#### Graphical presentation of results

##### Results

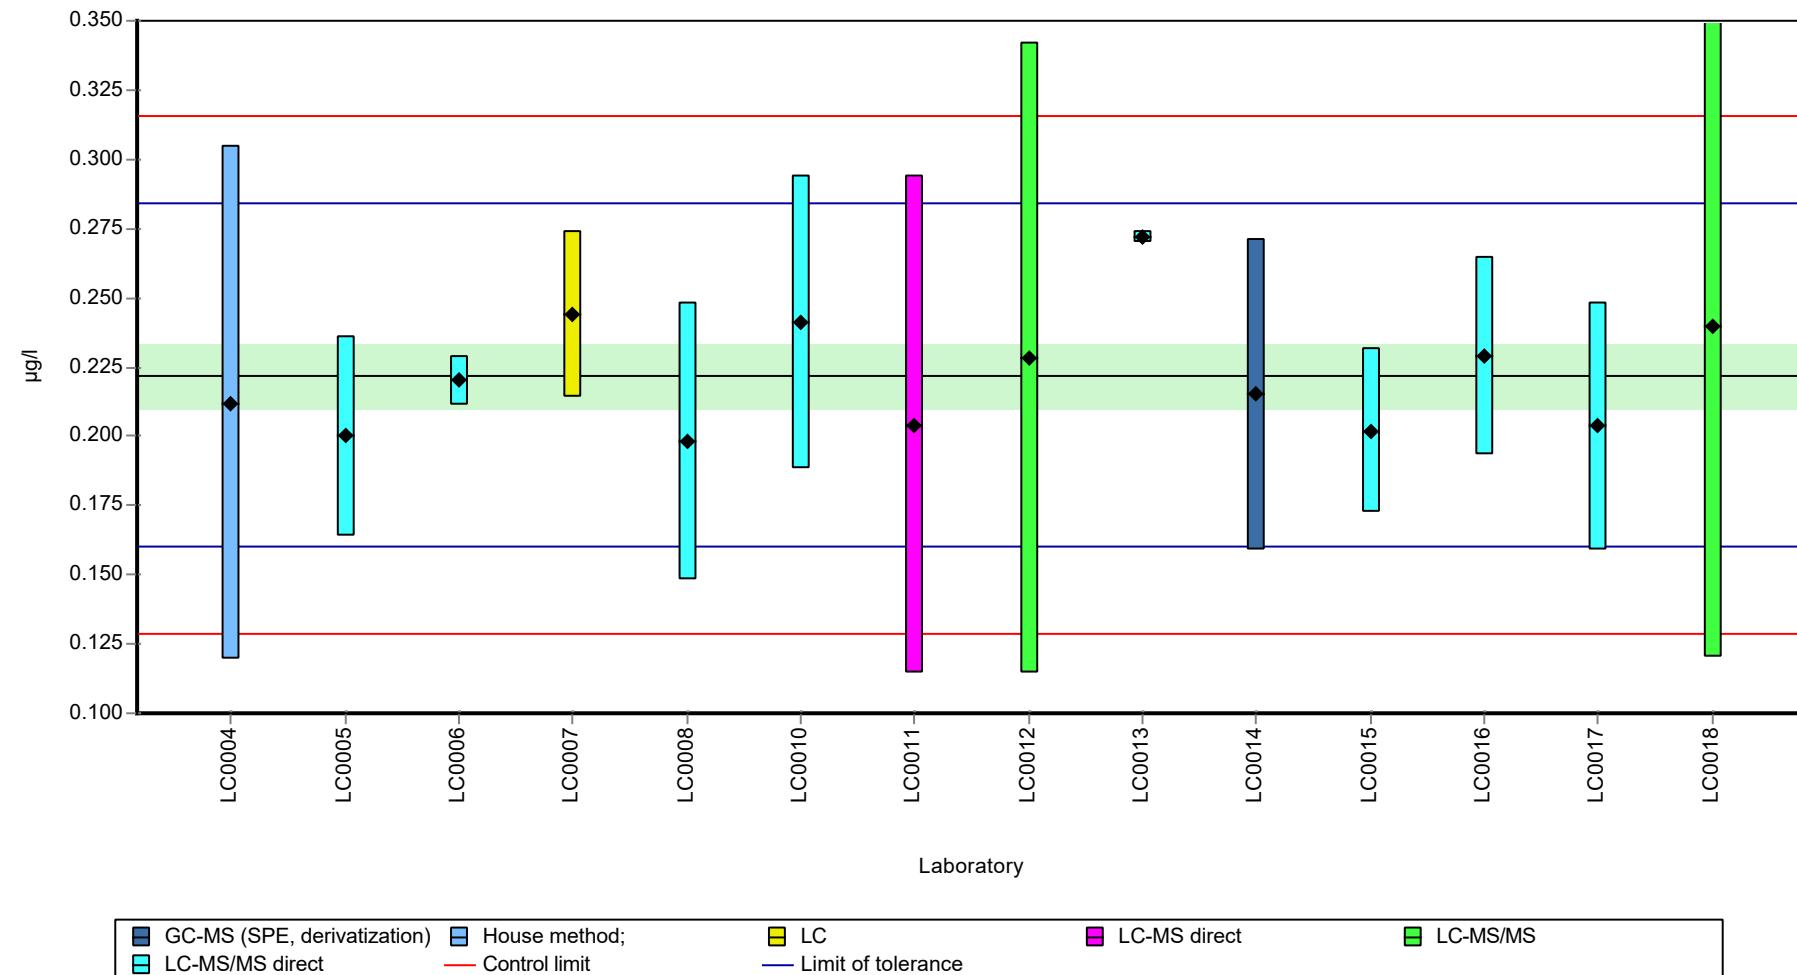


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Bromacil

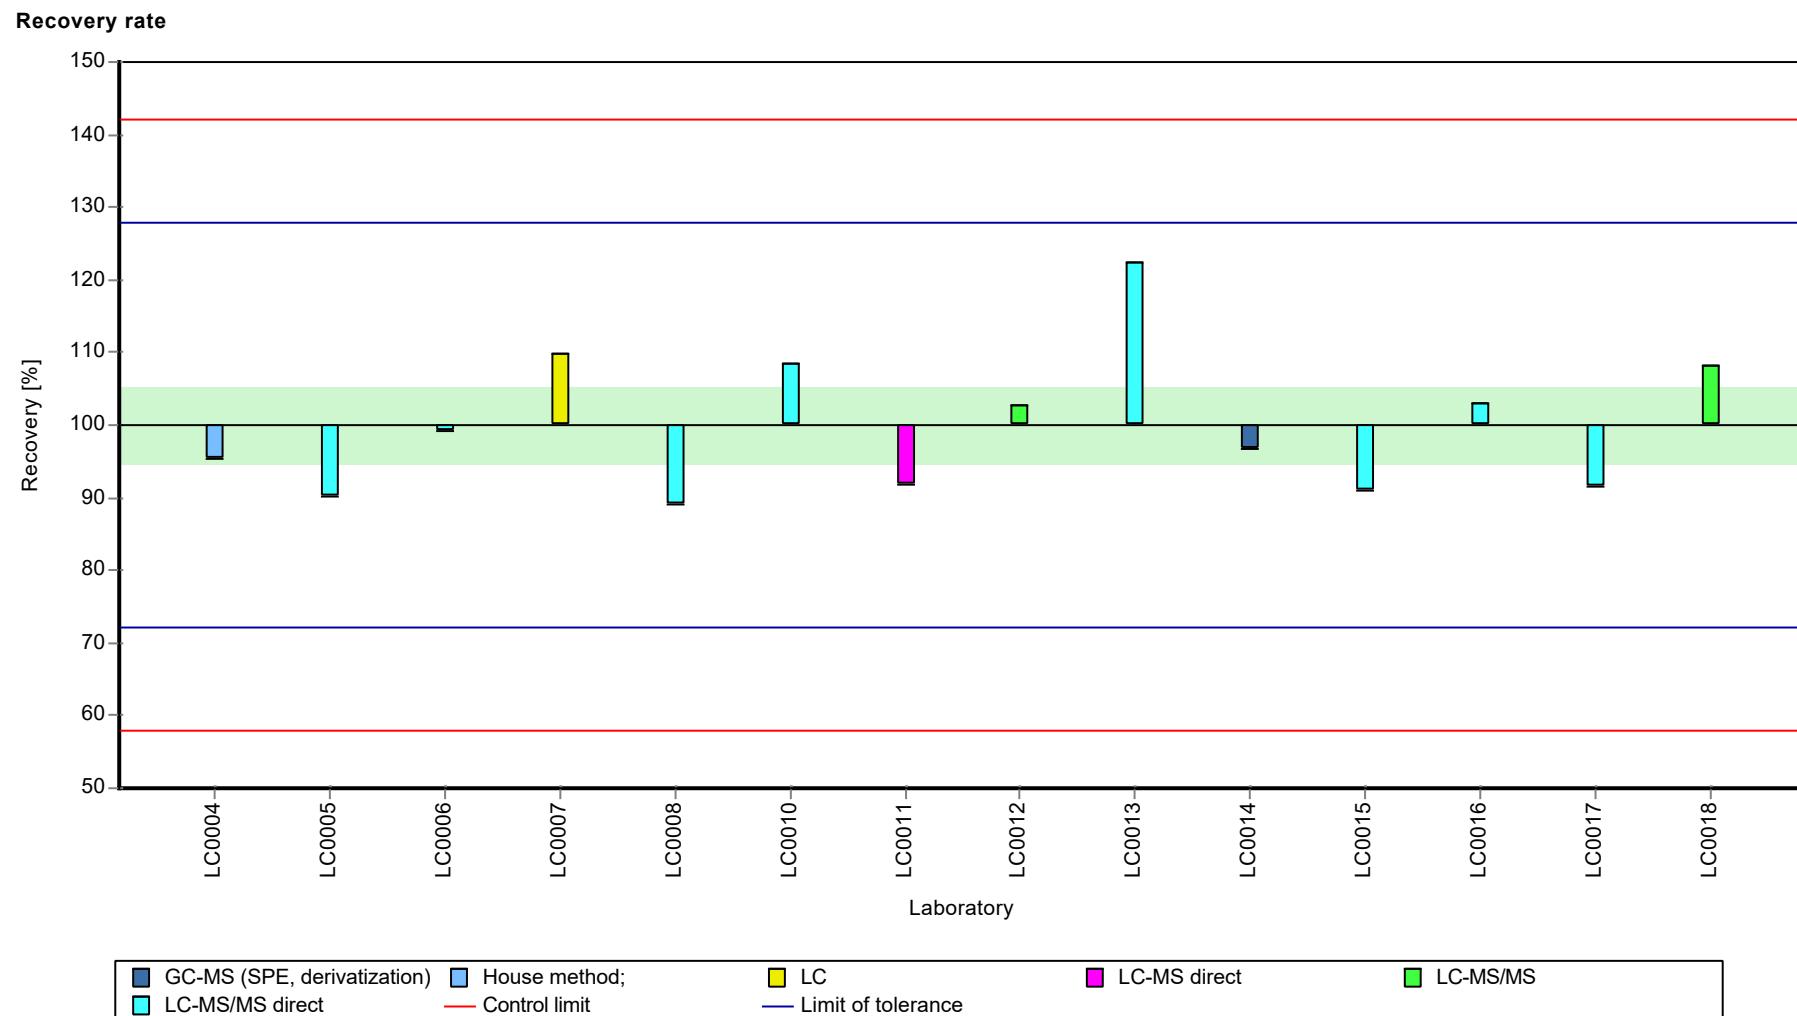

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Bromacil

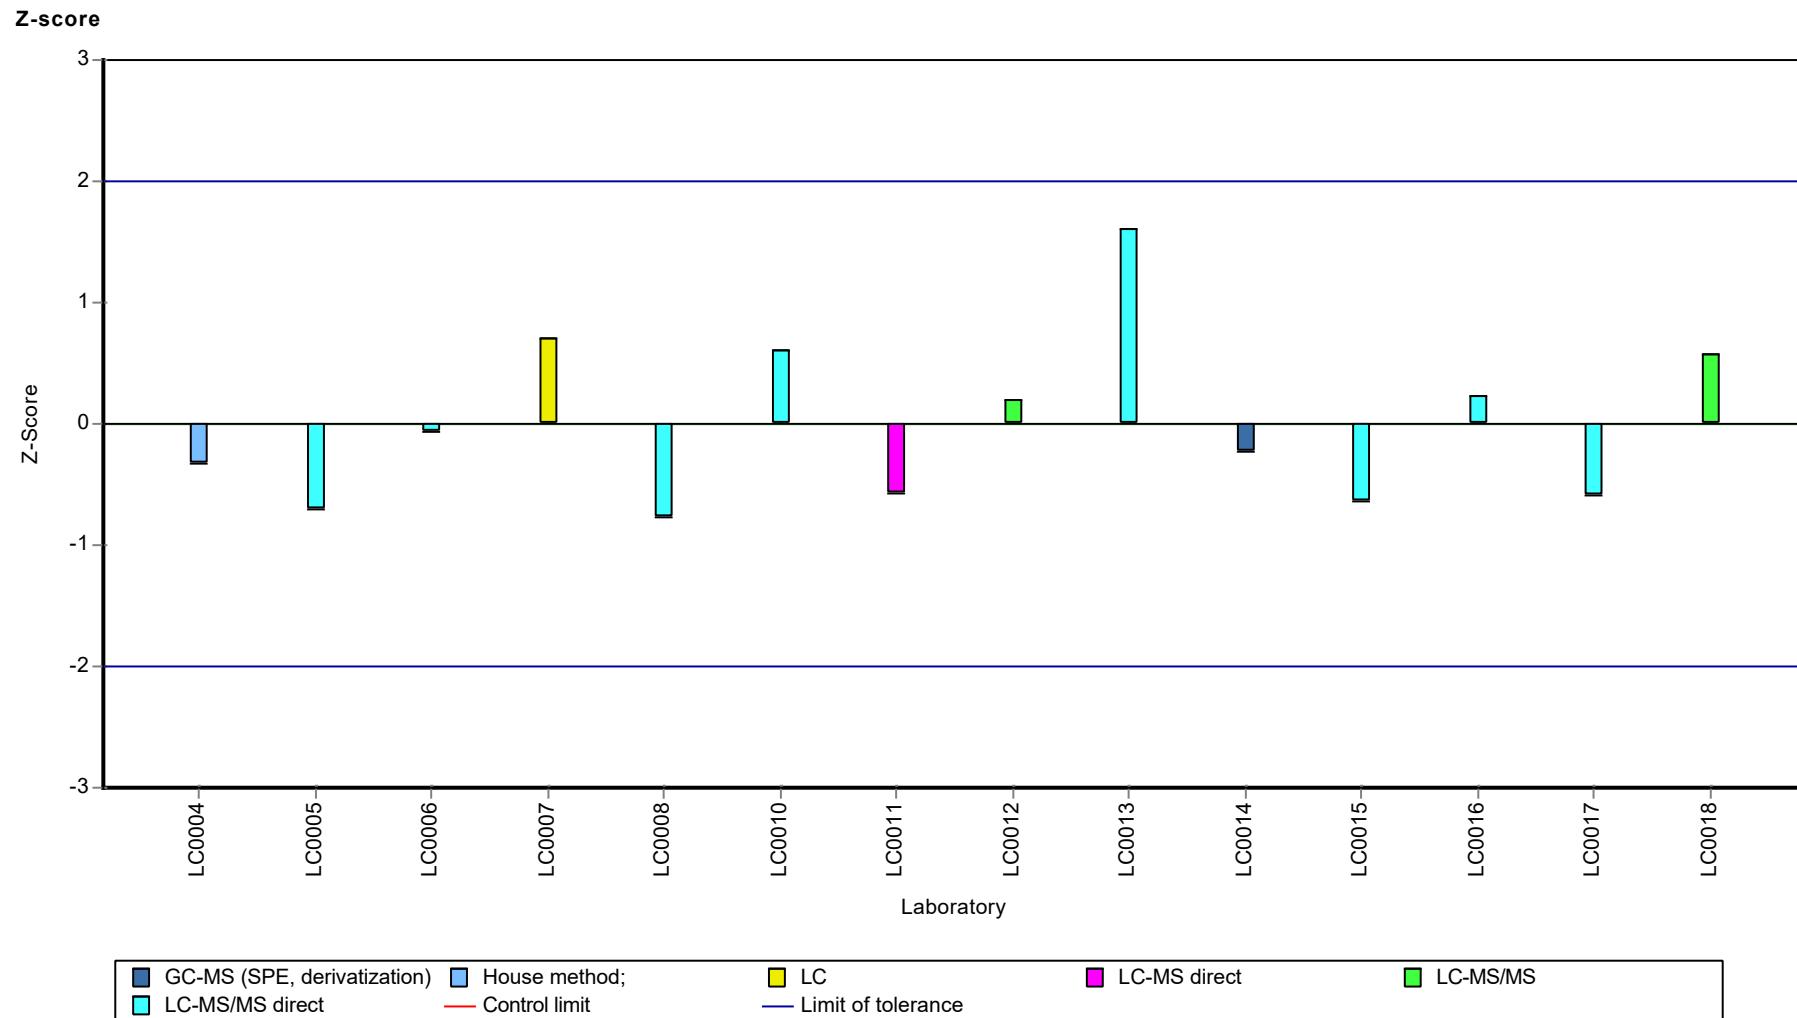

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Bromacil

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Bromacil

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	1.77 ± 0.171
Criterion	0.248 (14 %)
Minimum - Maximum	1.18 - 2.22
Control test value ± U (k=2)	1.920 ± 0.288


Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	1.77	0.78	100	0.01	
LC0005	1.65	0.297	93.3	-0.48	
LC0006	1.64	0.044	92.8	-0.52	
LC0007	2.191	0.274	124	1.71	
LC0008	1.597	0.399	90.3	-0.69	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	2.05	0.45	116	1.14	
LC0011	1.59	0.5	89.9	-0.72	
LC0012	1.1834	0.5917	66.9	-2.36	
LC0013	2.22	0.015	126	1.83	
LC0014	1.385	0.36	78.3	-1.55	
LC0015	1.776	0.266	100	0.03	
LC0016	1.88	0.3	106	0.45	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	2.05	1.03	116	1.14	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter

	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	1.77 ± 0.256	1.77 ± 0.256	µg/l
Minimum	1.18	1.18	µg/l
Maximum	2.22	2.22	µg/l
Standard deviation	0.307	0.307	µg/l
rel. standard deviation	17.4	17.4	%
n	13	13	-


**Graphical presentation of results**

**Results**

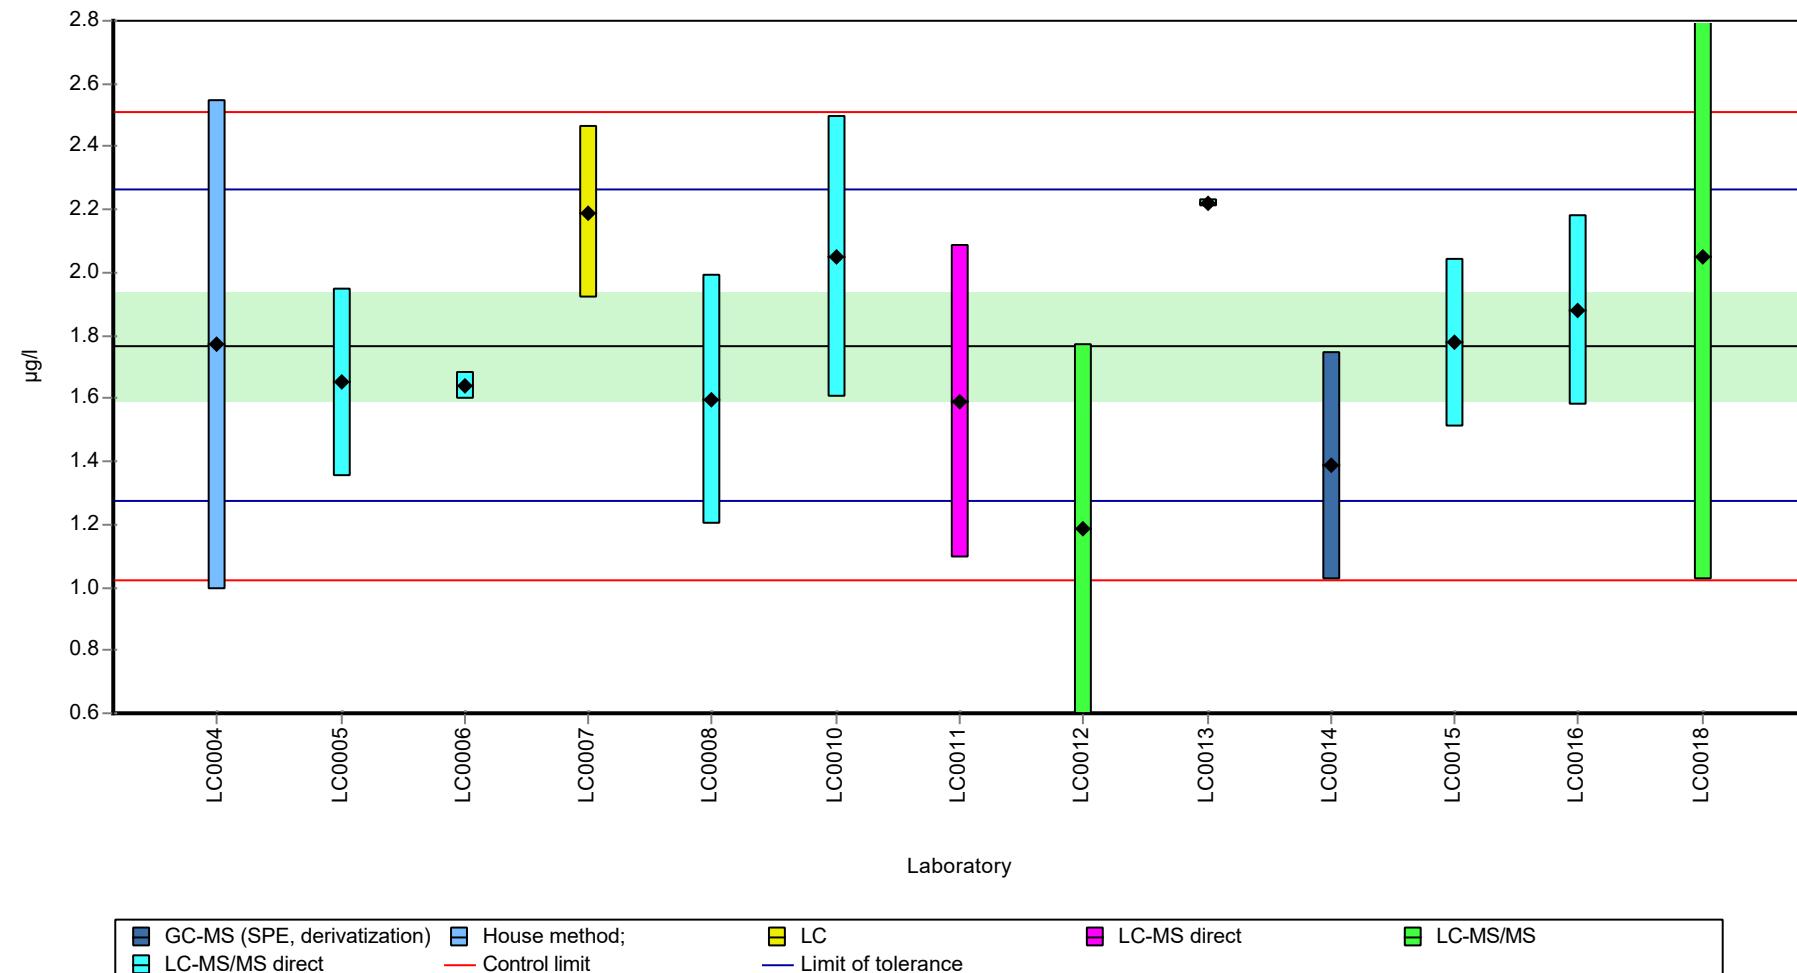


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Bromacil

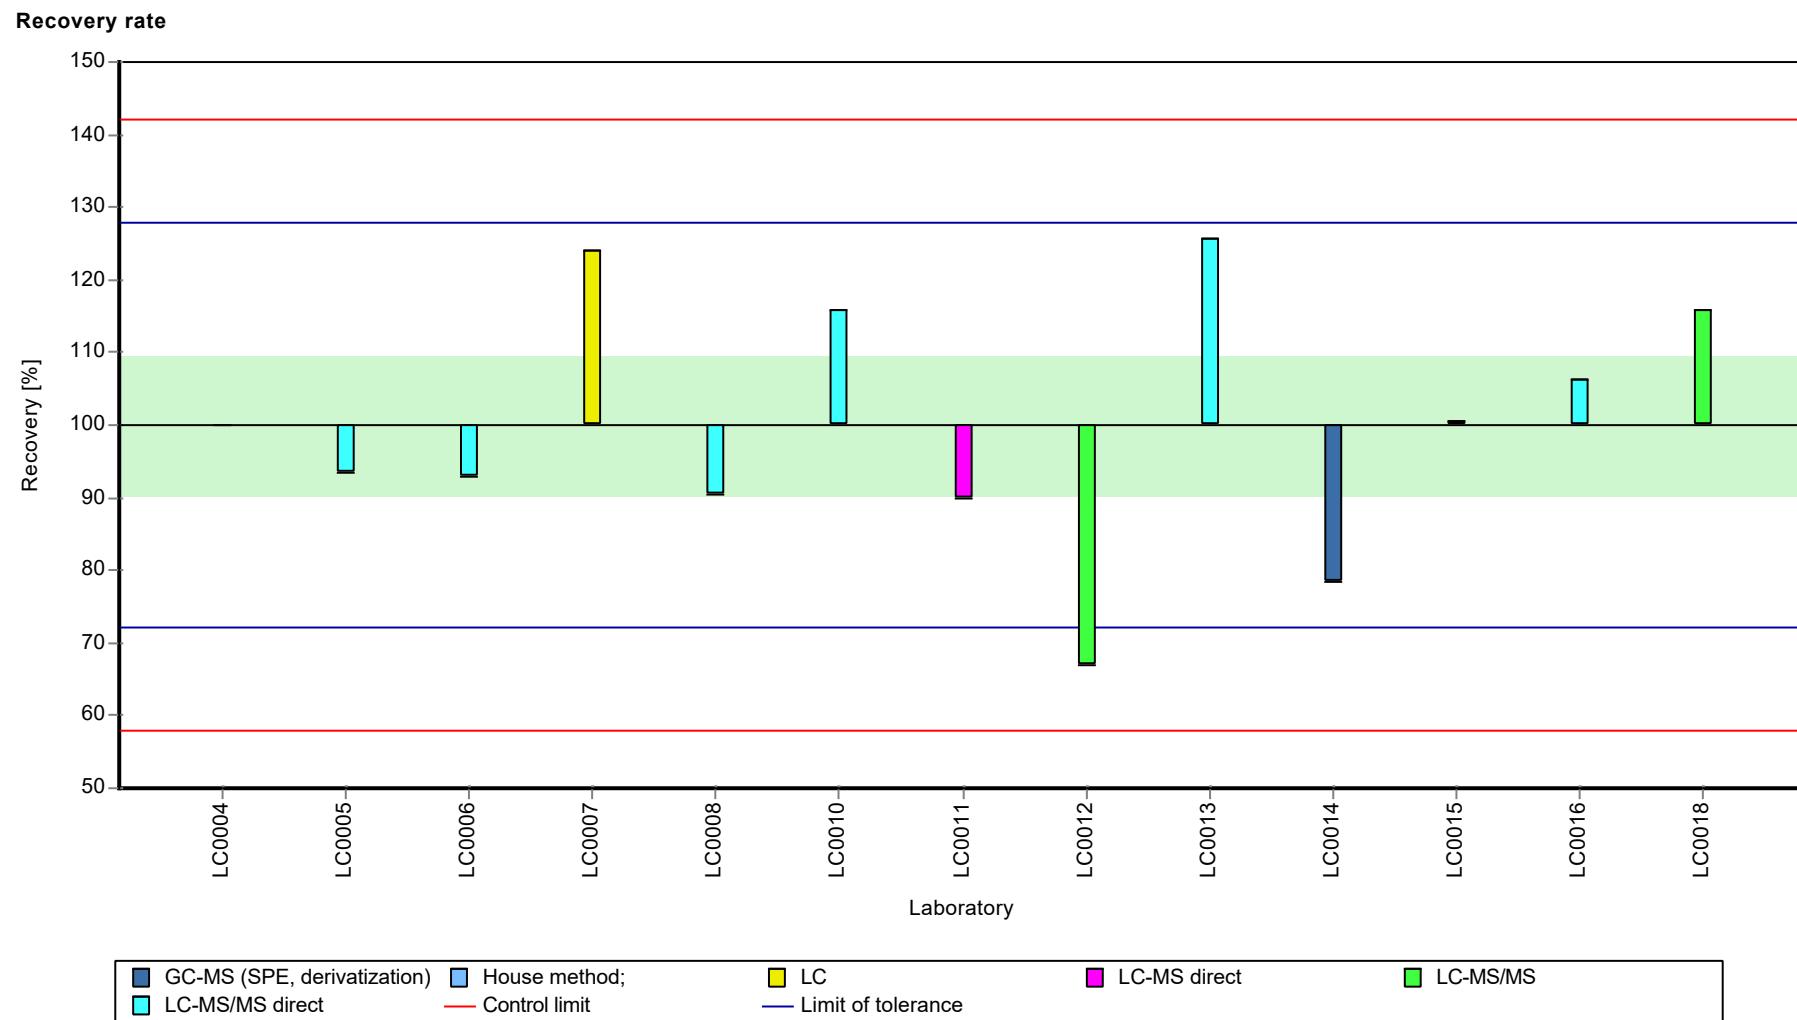

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Bromacil

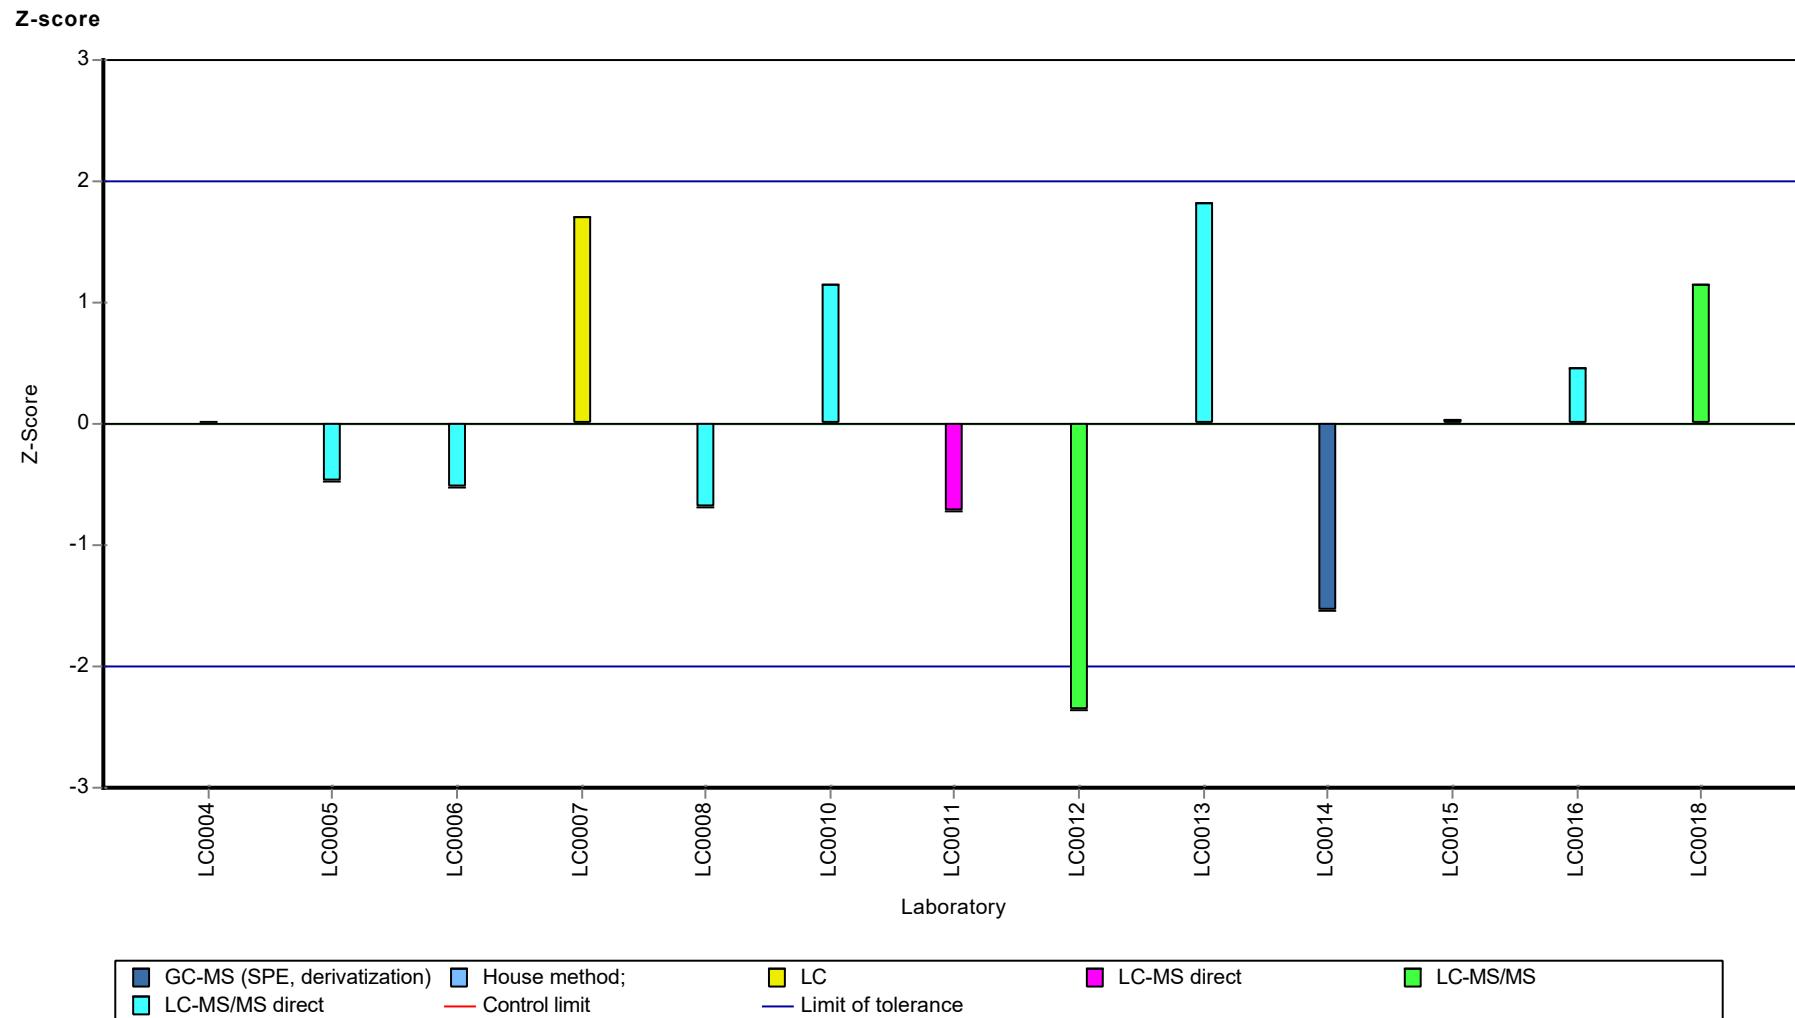

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Clothianidin

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Clothianidin

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.123 ± 0.0024
Criterion	0.0135 (11 %)
Minimum - Maximum	0.119 - 0.127
Control test value ± U (k=2)	0.1150 ± 0.0173

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	0.1228	0.0307	99.8	-0.02	
LC0002	0.1273	0.0304	103	0.32	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	0.121	0.053	98.4	-0.15	
LC0005	0.144	0.026	117	1.55	H
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	0.119	0.03	96.7	-0.3	
LC0009	0.12	0.024	97.5	-0.22	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	0.126	0.06	102	0.22	
LC0012	0.0197	0.0099	16	-7.64	H
LC0013	< 0.025 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.098	0.015	79.7	-1.85	H
LC0016	0.125	0.021	102	0.15	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.145	0.073	118	1.62	H
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.115 ± 0.0308	0.123 ± 0.0036	µg/l
Minimum	0.0197	0.119	µg/l
Maximum	0.145	0.127	µg/l
Standard deviation	0.0341	0.00318	µg/l
rel. standard deviation	29.6	2.58 %	
n	11	7	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Clothianidin


**Graphical presentation of results**

**Results**

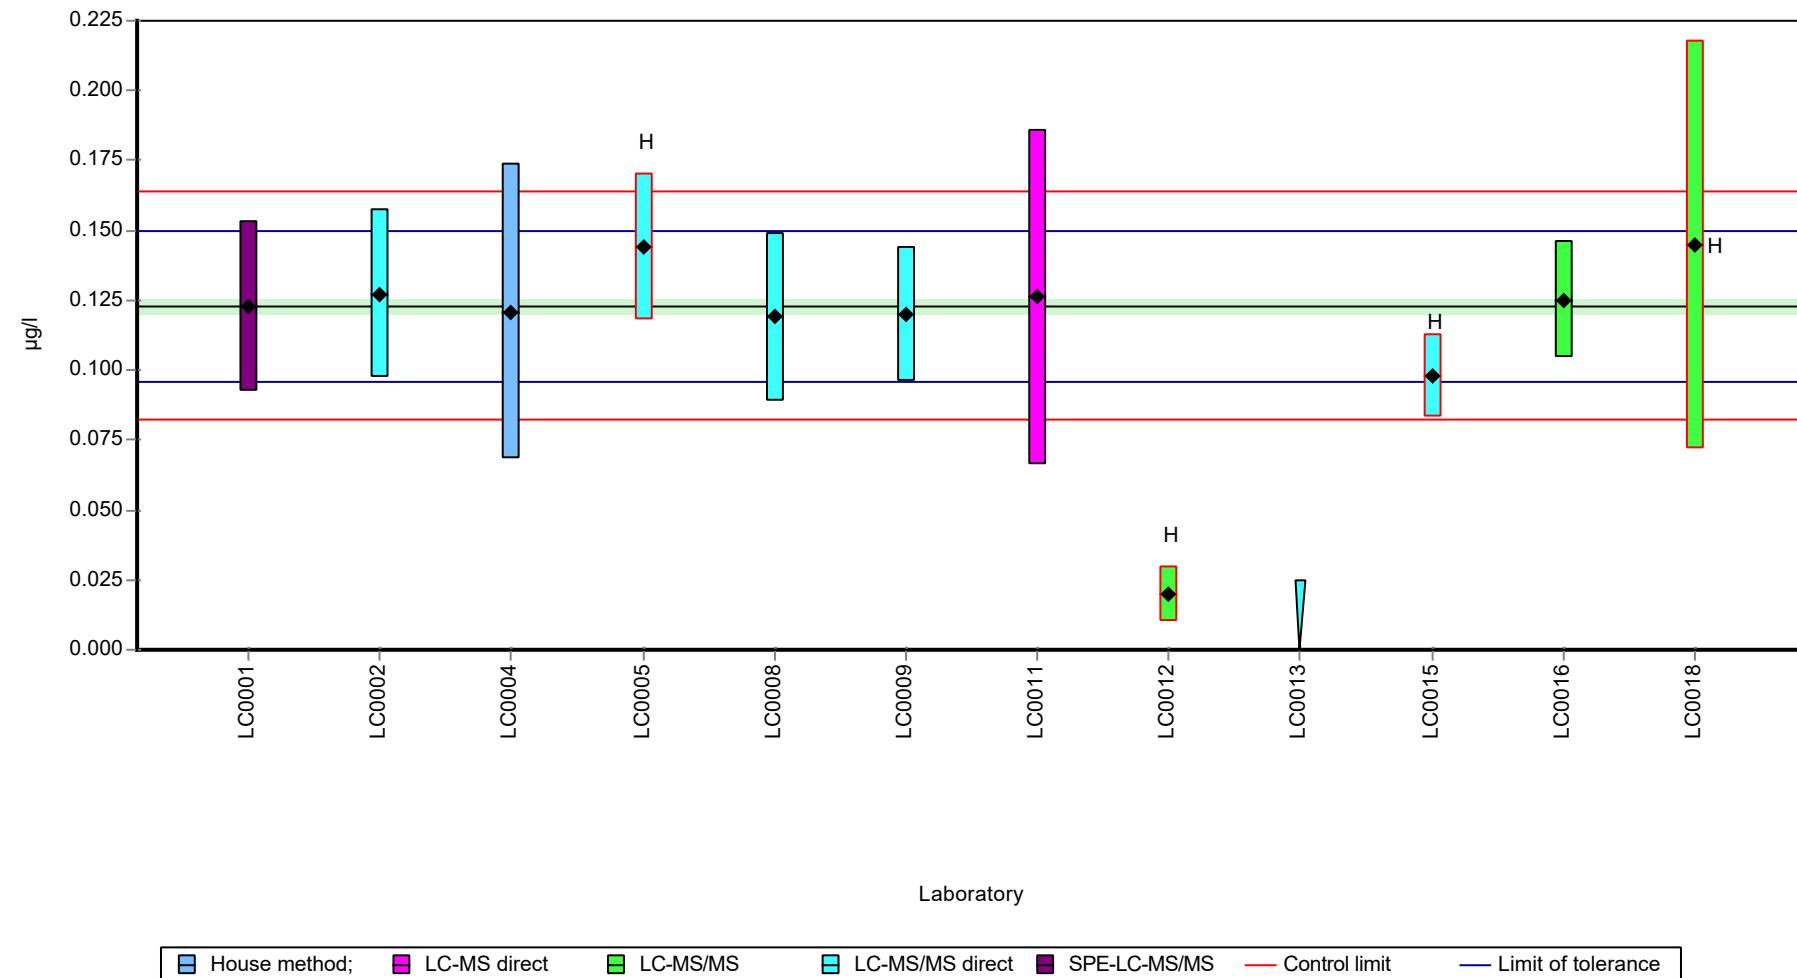


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Clothianidin

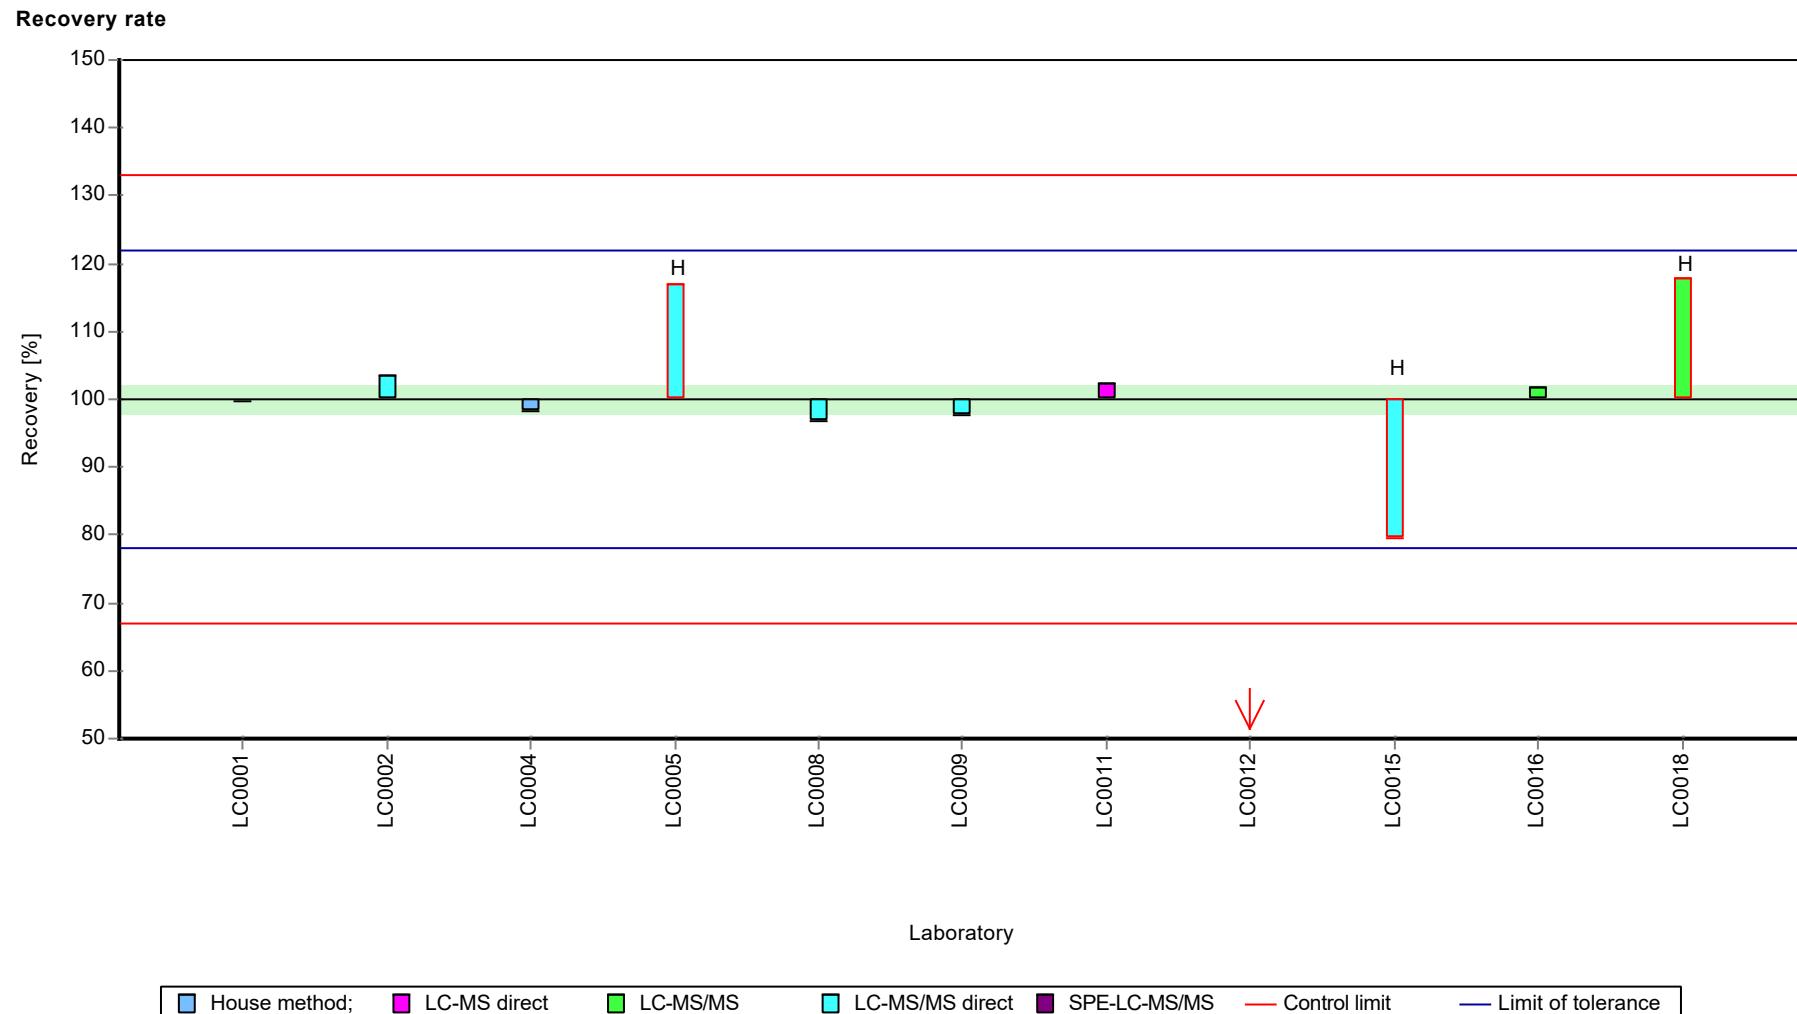

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Clothianidin

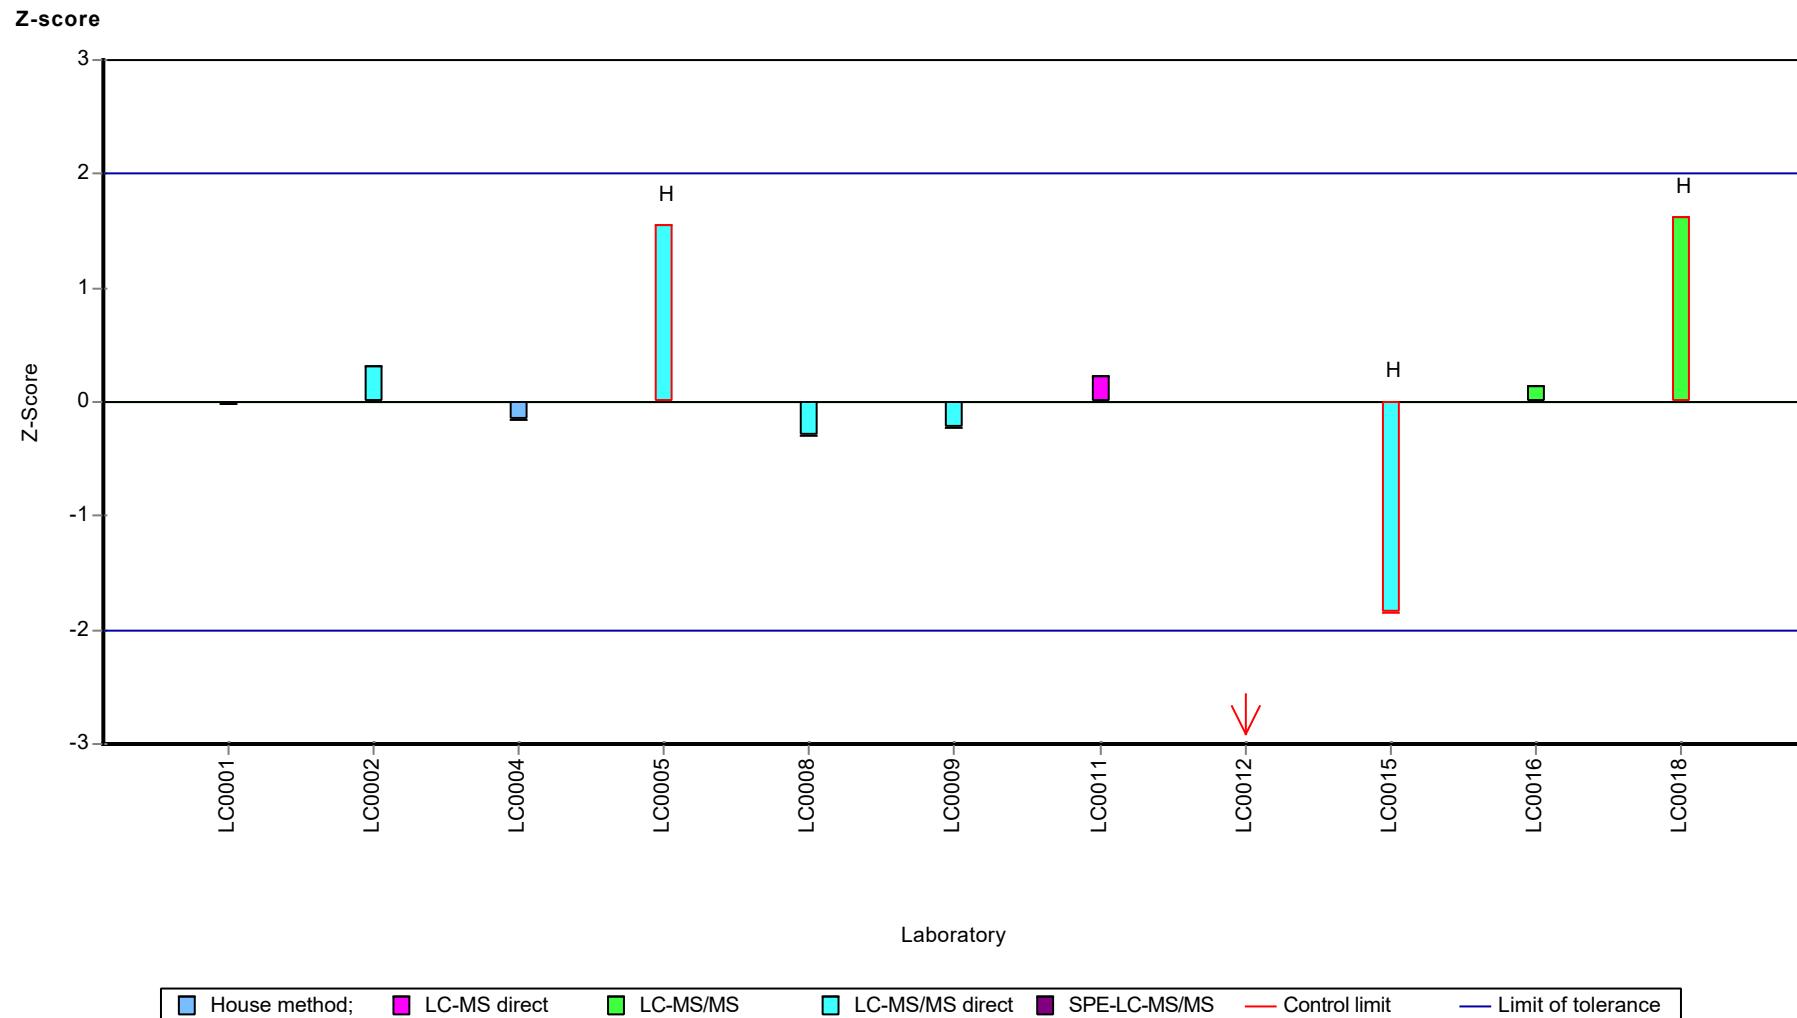

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Clothianidin

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Clothianidin

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	1.89 ± 0.180
Criterion	0.208 (11 %)
Minimum - Maximum	1.53 - 2.23
Control test value ± U (k=2)	2.150 ± 0.323

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.4	0.1	-	-	
LC0002	1.8518	0.443	98.1	-0.17	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	1.85	0.81	98	-0.18	
LC0005	2.224	0.4	118	1.62	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	1.571	0.393	83.2	-1.52	
LC0009	1.916	0.383	102	0.14	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	1.53	0.5	81.1	-1.72	
LC0012	0.3351	0.1676	17.8	-7.48	H
LC0013	< 0.025 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	1.666	0.25	88.3	-1.07	
LC0016	2.23	0.37	118	1.65	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	2.15	1.08	114	1.26	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	1.73 ± 0.524	1.89 ± 0.269	µg/l
Minimum	0.335	1.53	µg/l
Maximum	2.23	2.23	µg/l
Standard deviation	0.553	0.269	µg/l
rel. standard deviation	31.9	14.3 %	
n	10	9	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Clothianidin


**Graphical presentation of results**

**Results**

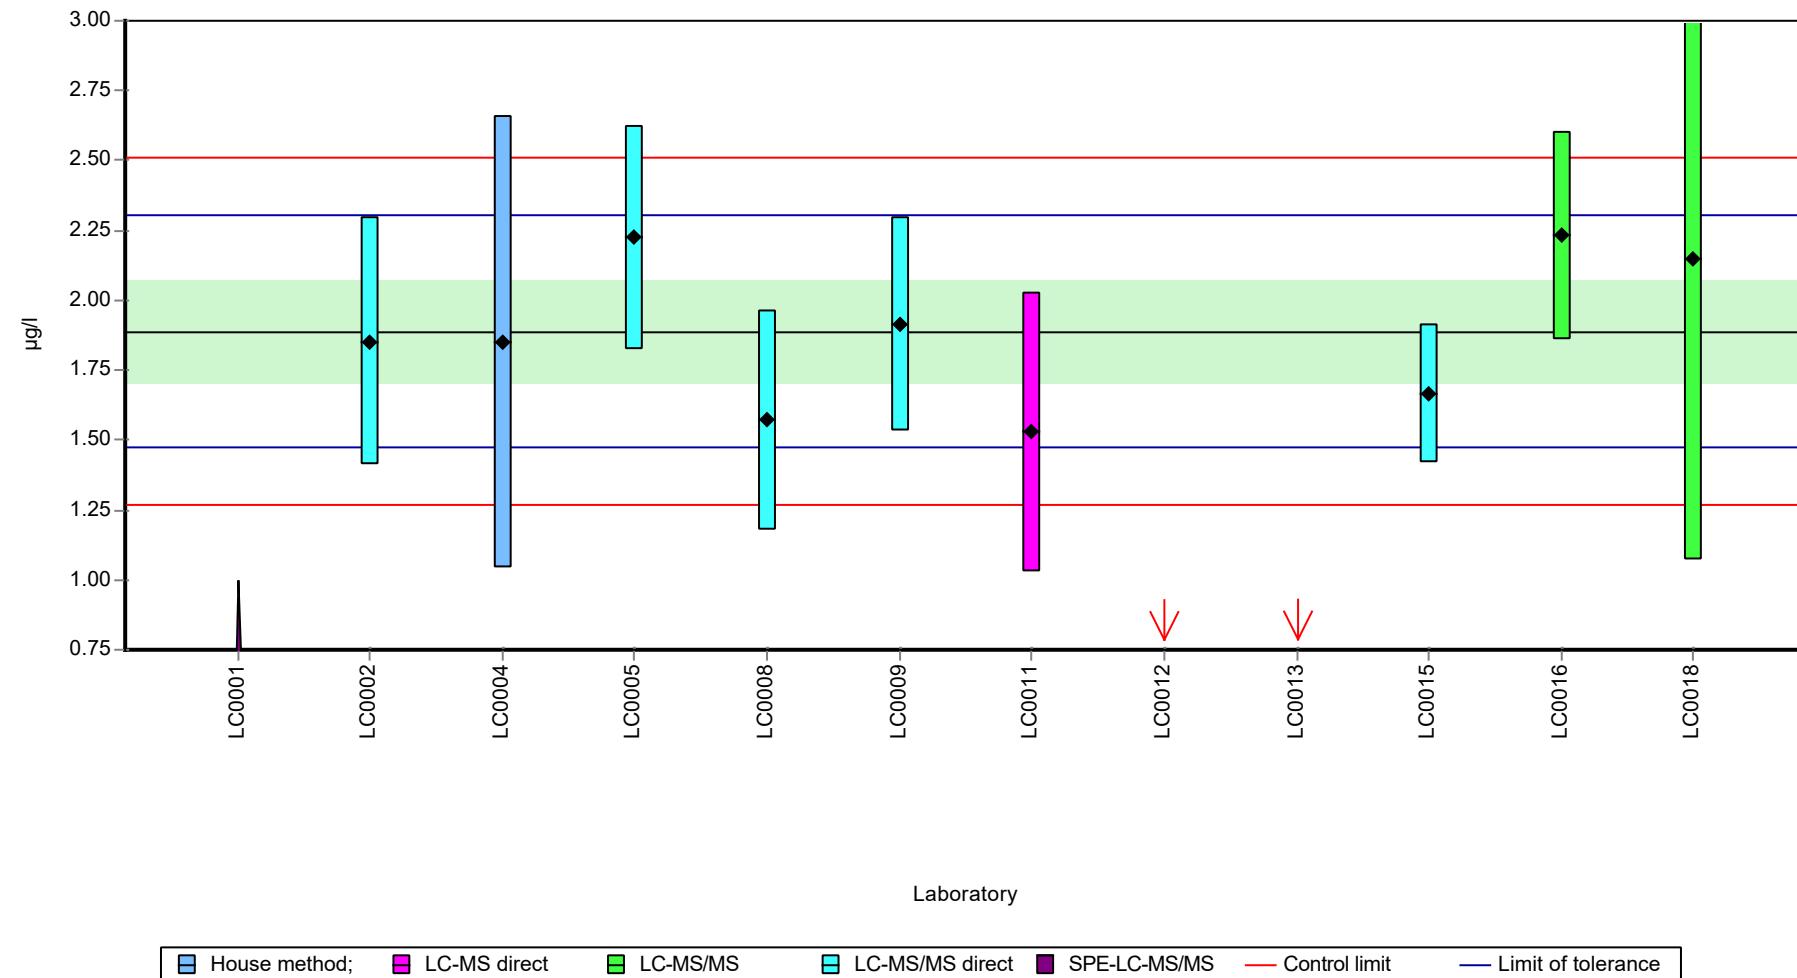


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Clothianidin

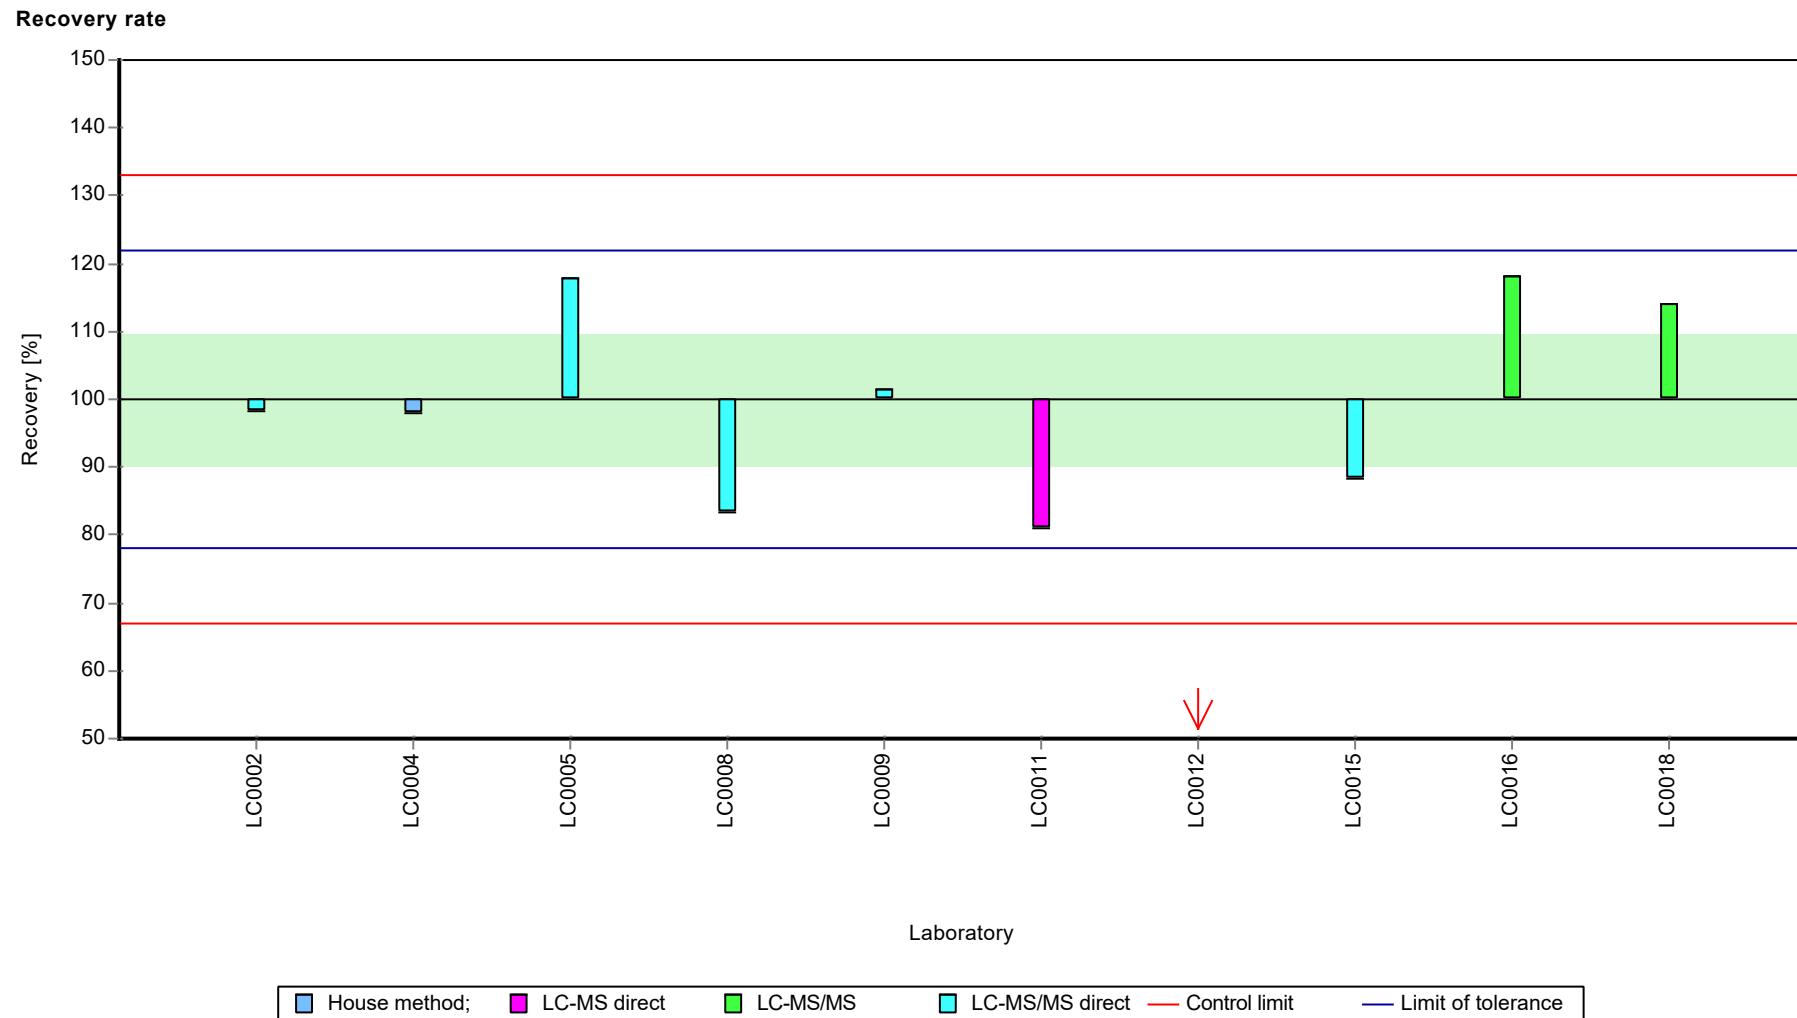

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Clothianidin

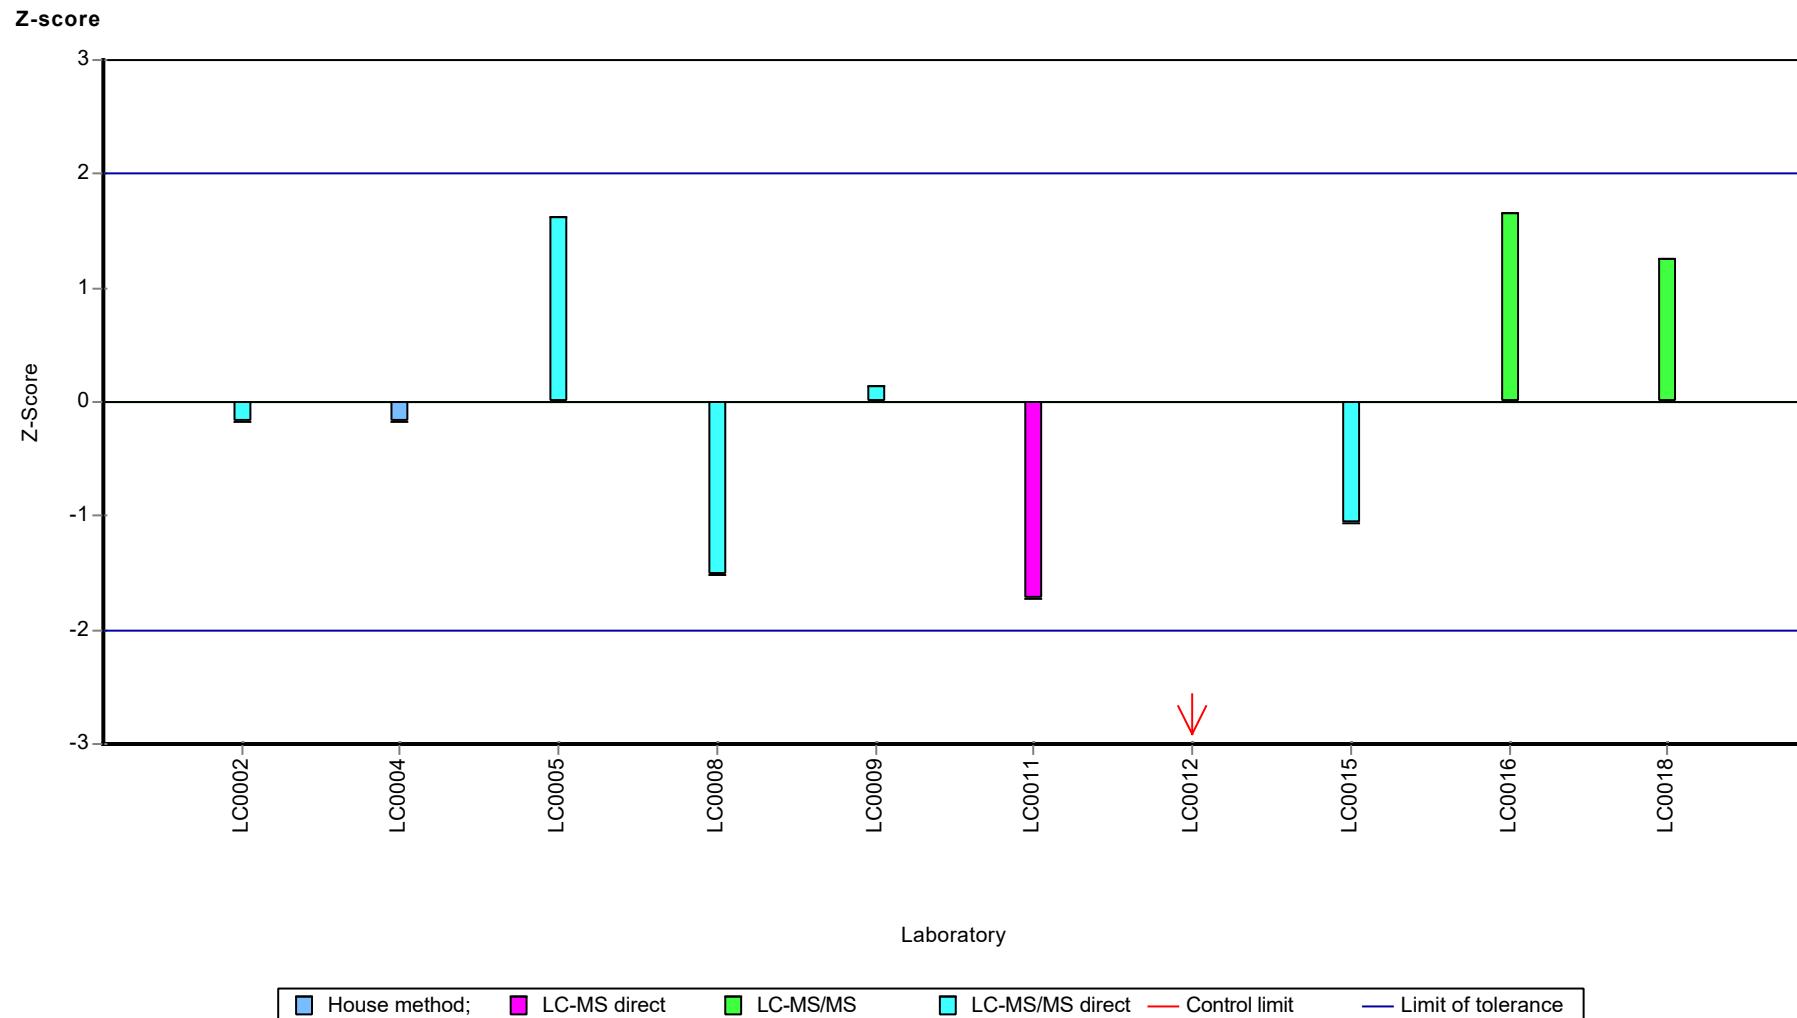

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Cyanazine

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Cyanazine

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.195 ± 0.0139
Criterion	0.0274 (14 %)
Minimum - Maximum	0.169 - 0.23
Control test value ± U (k=2)	0.1560 ± 0.0234

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	0.1756	0.0656	89.9	-0.72	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.187	0.034	95.7	-0.31	
LC0006	0.169	0.005	86.5	-0.96	
LC0007	0.23	0.029	118	1.27	
LC0008	0.213	0.053	109	0.64	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	0.211	0.042	108	0.57	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	-	-	-	-	
LC0013	0.216	0.002	111	0.75	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.175	0.026	89.6	-0.75	
LC0016	0.174	0.025	89.1	-0.78	
LC0017	0.17383	0.03824	89	-0.79	
LC0018	0.205	0.103	105	0.35	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.194 ± 0.0197	0.194 ± 0.0197	µg/l
Minimum	0.169	0.169	µg/l
Maximum	0.23	0.23	µg/l
Standard deviation	0.0217	0.0217	µg/l
rel. standard deviation	11.2	11.2	%
n	11	11	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Cyanazine


**Graphical presentation of results**

**Results**

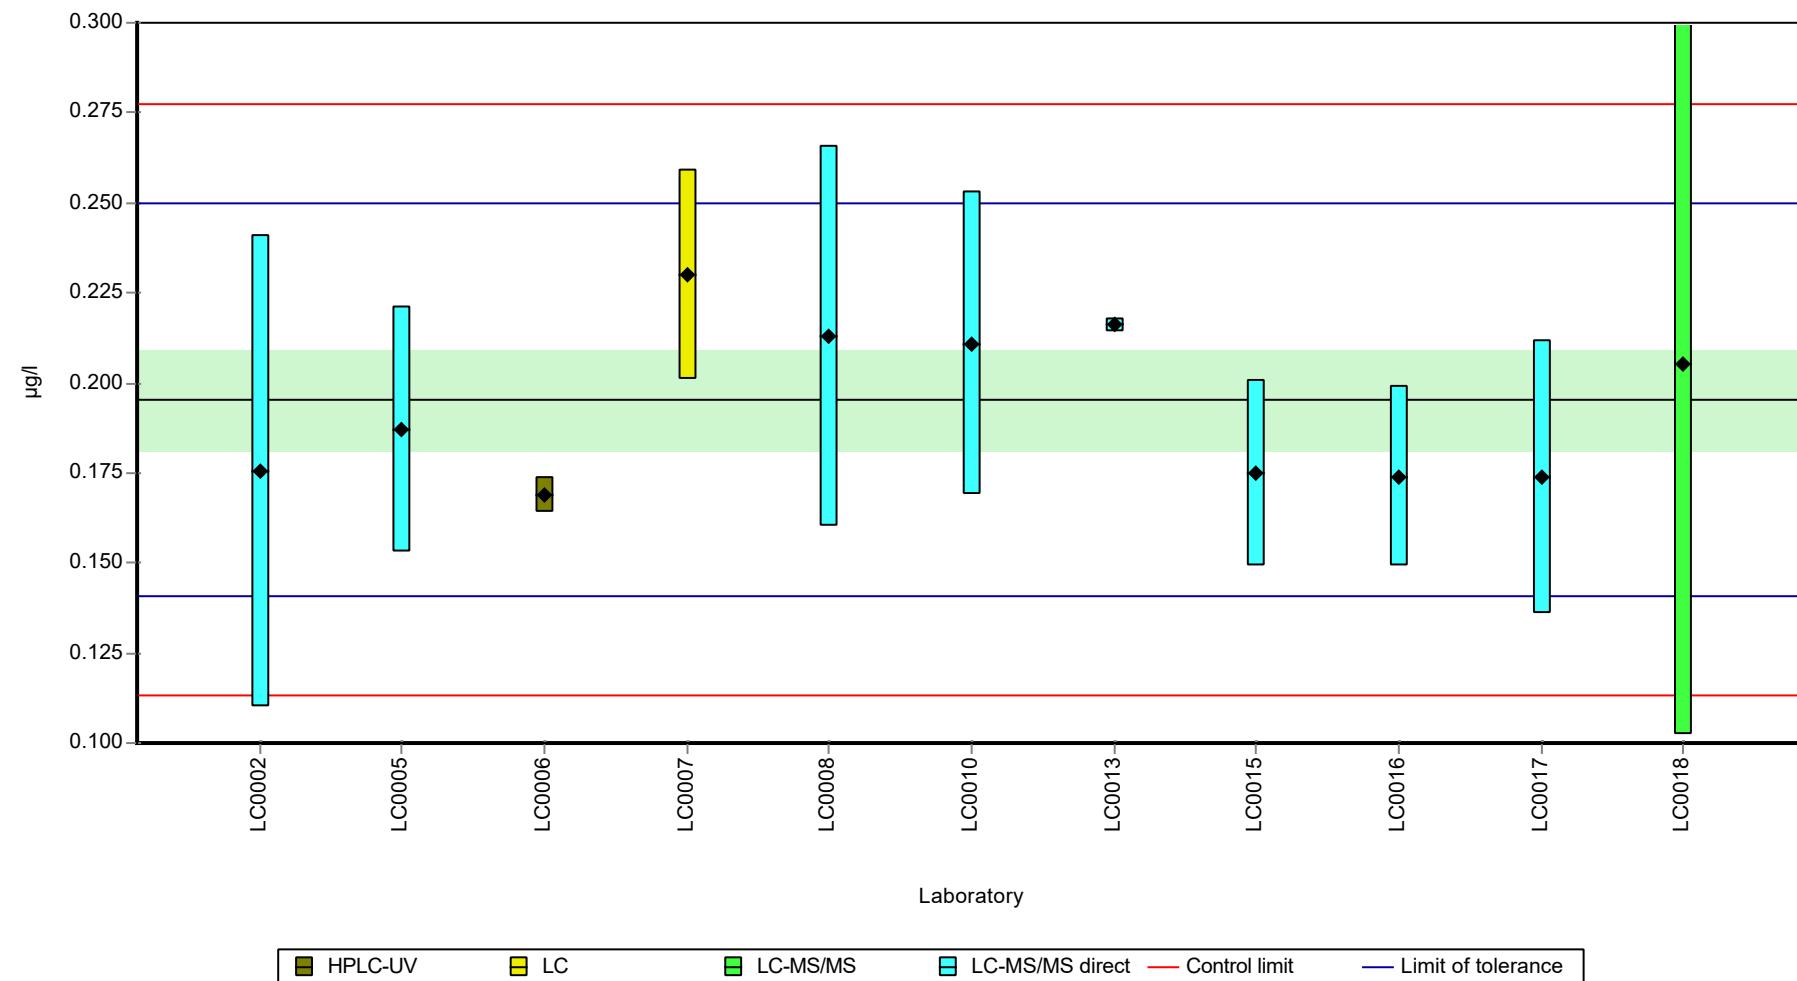


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Cyanazine

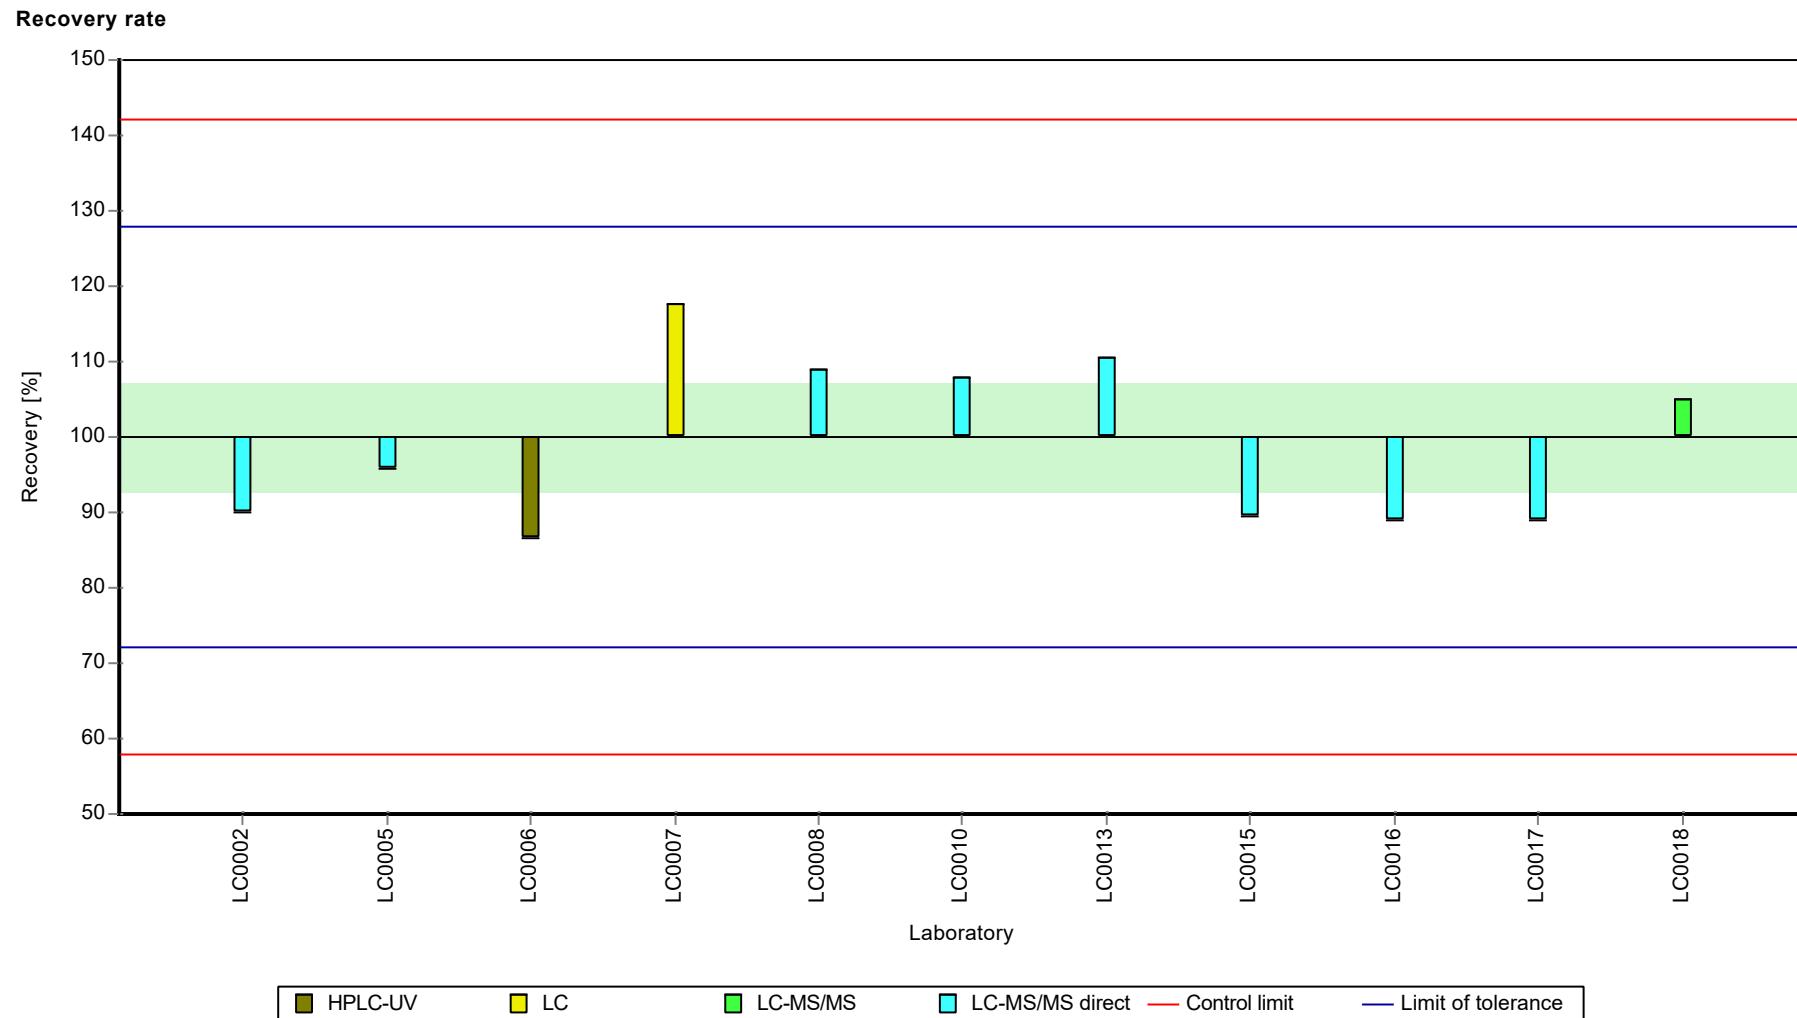

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Cyanazine

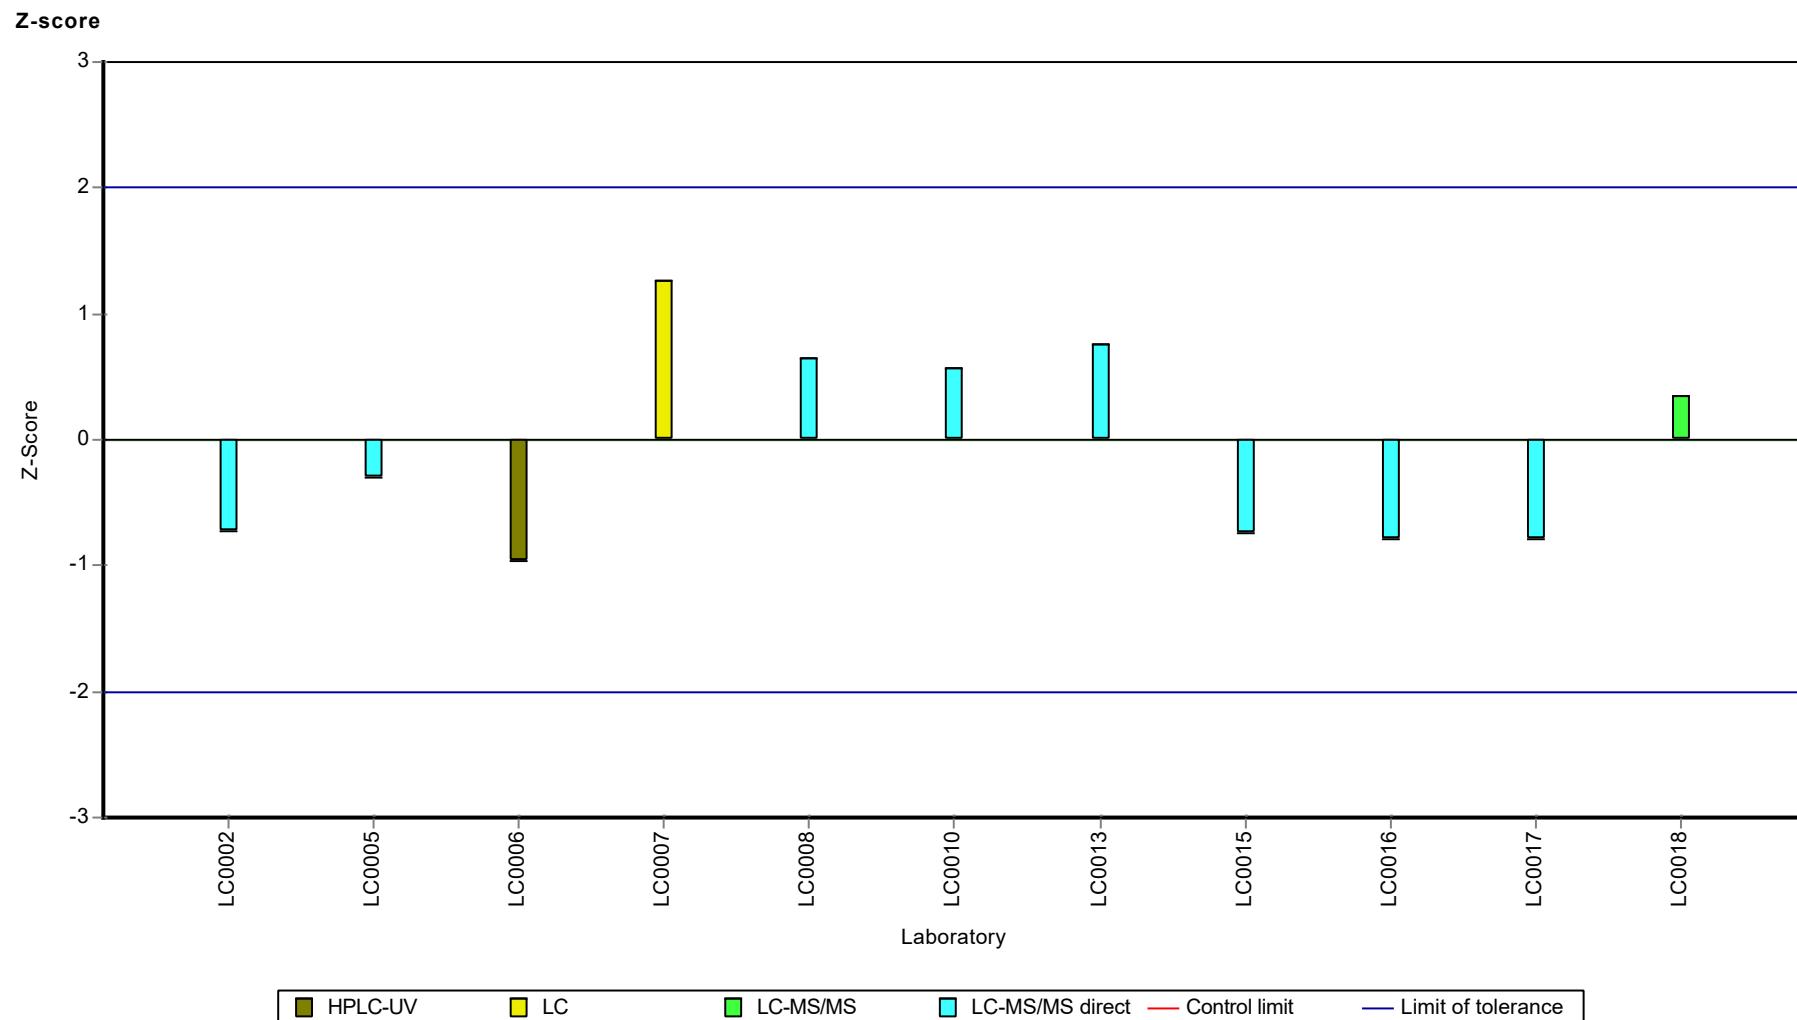

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Cyanazine

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Cyanazine

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	2.81 ± 0.19
Criterion	0.393 (14 %)
Minimum - Maximum	2.45 - 3.35
Control test value ± U (k=2)	2.600 ± 0.389

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	2.5024	0.9351	89.2	-0.77	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	2.774	0.499	98.9	-0.08	
LC0006	2.56	0.03	91.2	-0.63	
LC0007	3.157	0.395	113	0.89	
LC0008	3.066	0.767	109	0.66	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	3.35	0.67	119	1.39	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	-	-	-	-	
LC0013	2.9	0.055	103	0.24	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	2.451	0.368	87.4	-0.9	
LC0016	2.51	0.36	89.5	-0.75	
LC0017	2.54175	0.55918	90.6	-0.67	
LC0018	3.05	1.53	109	0.62	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	2.81 ± 0.285	2.81 ± 0.285	µg/l
Minimum	2.45	2.45	µg/l
Maximum	3.35	3.35	µg/l
Standard deviation	0.315	0.315	µg/l
rel. standard deviation	11.2	11.2	%
n	11	11	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Cyanazine


**Graphical presentation of results**

**Results**

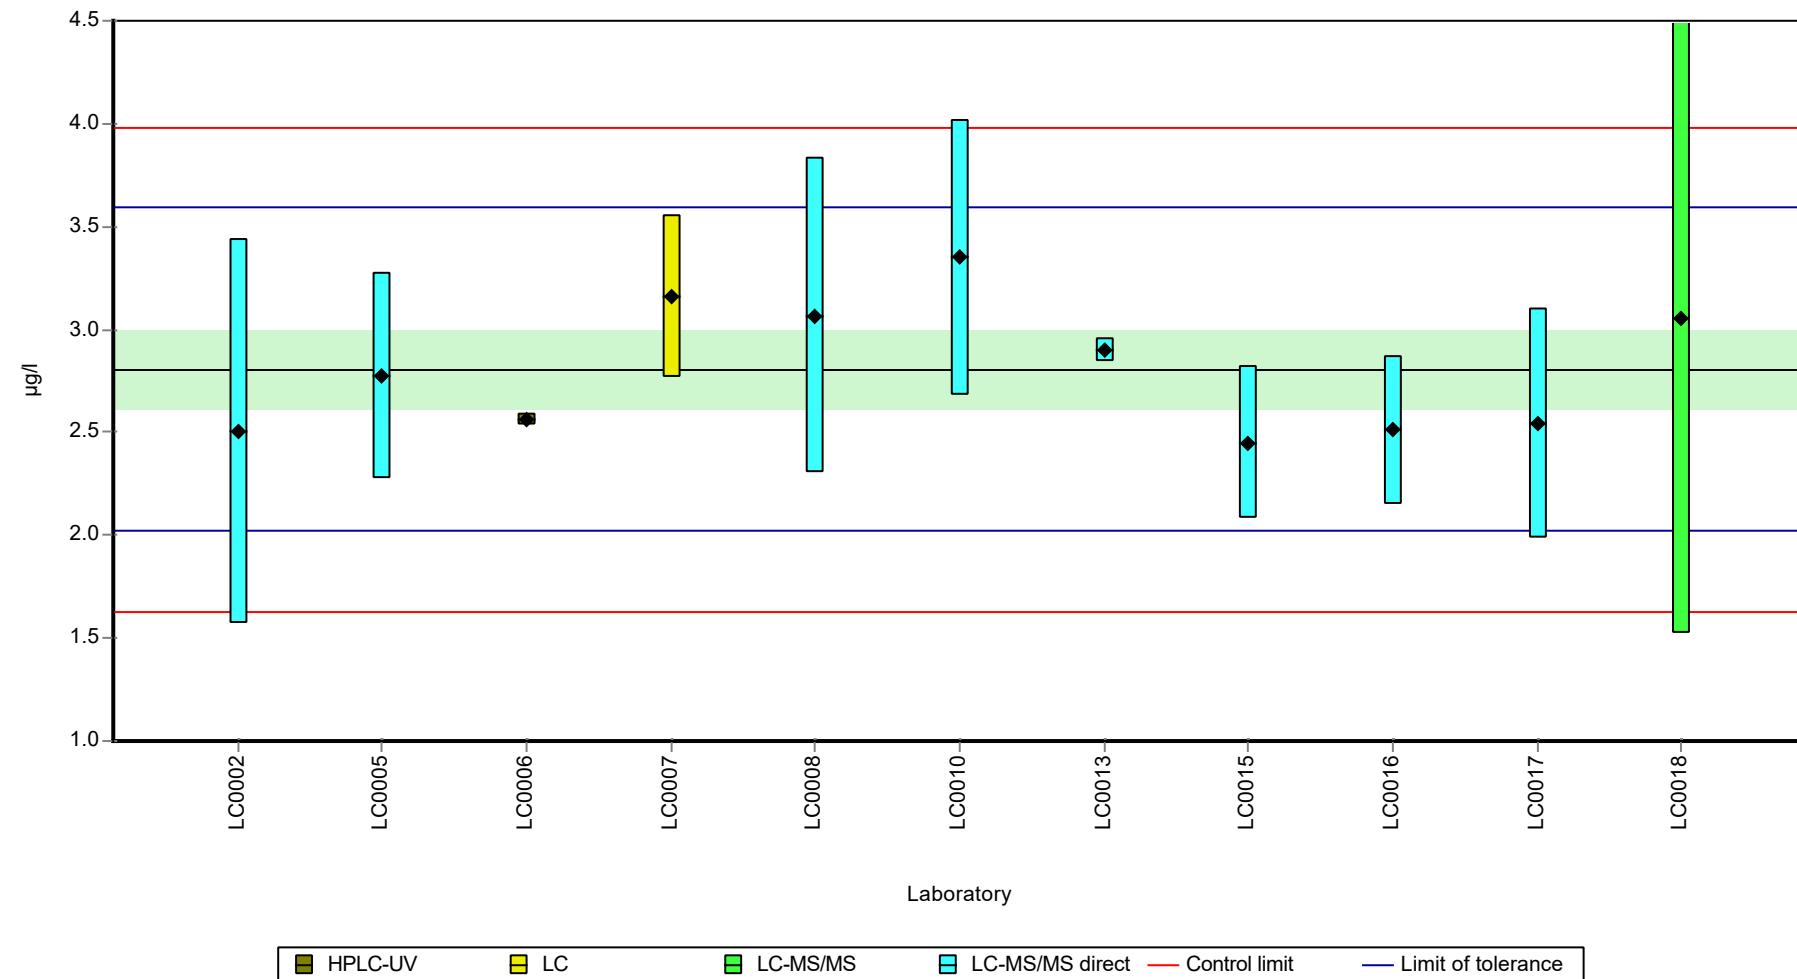


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Cyanazine

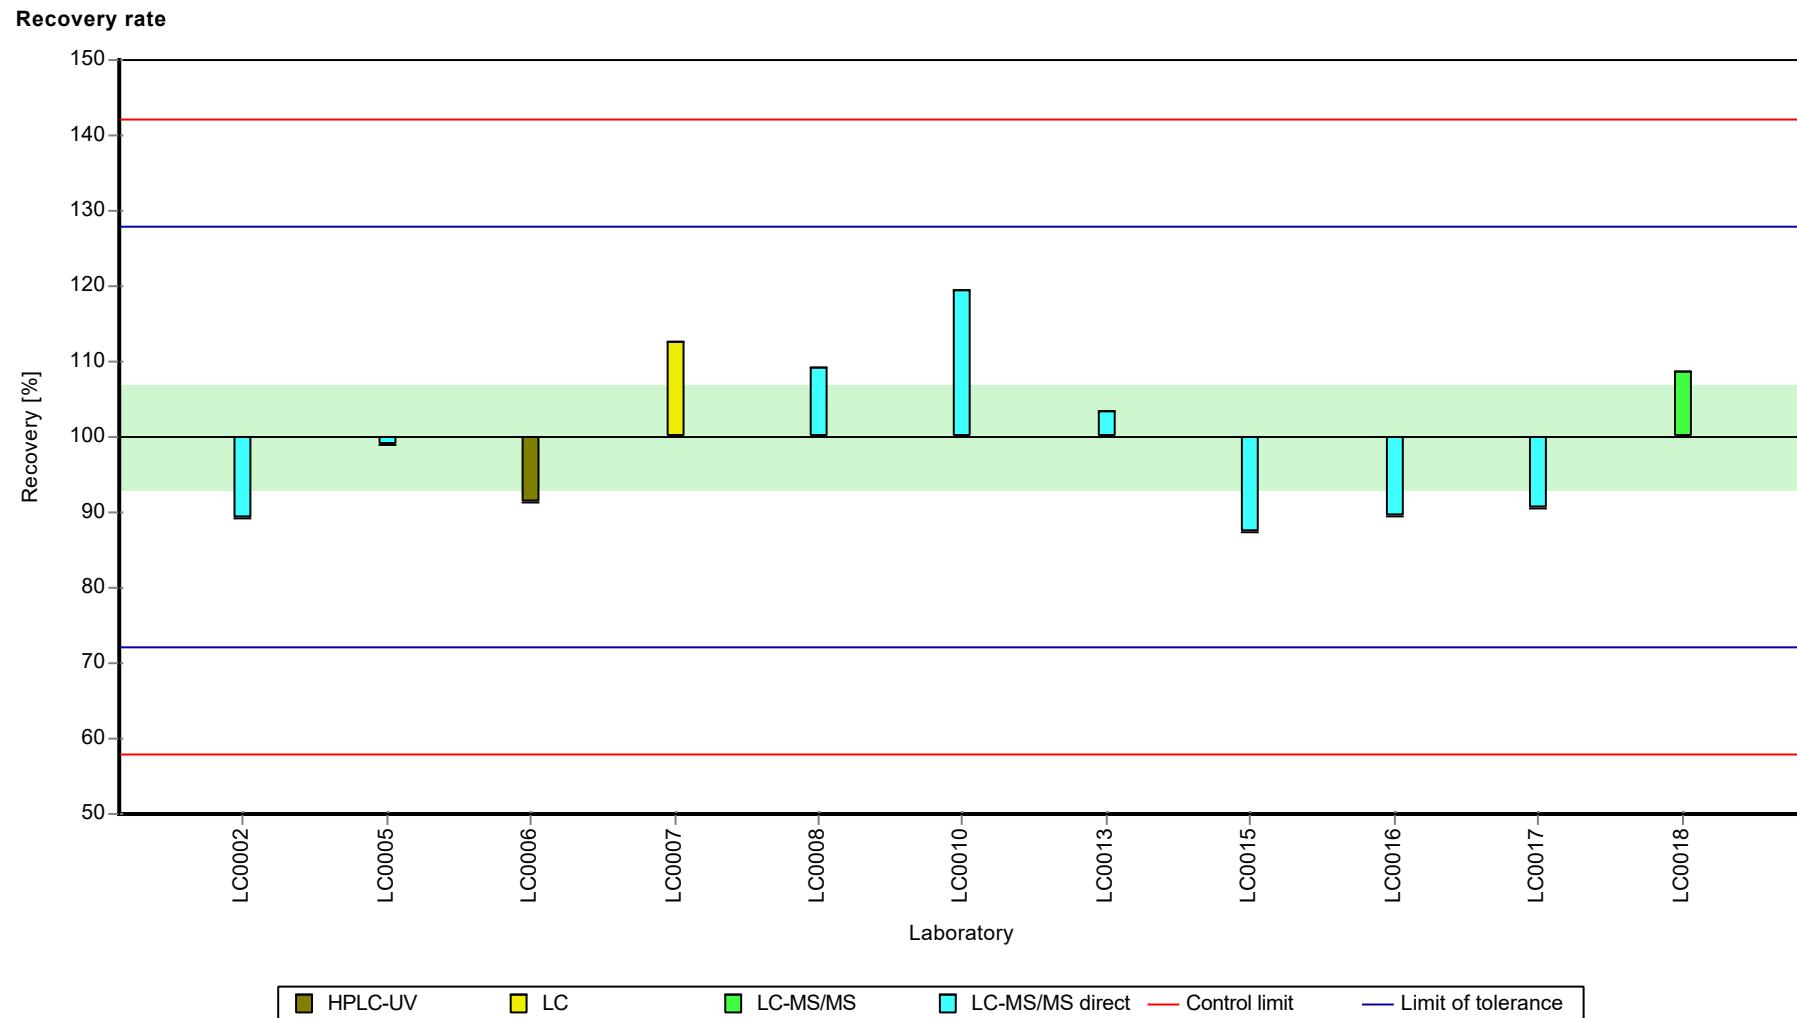

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Cyanazine

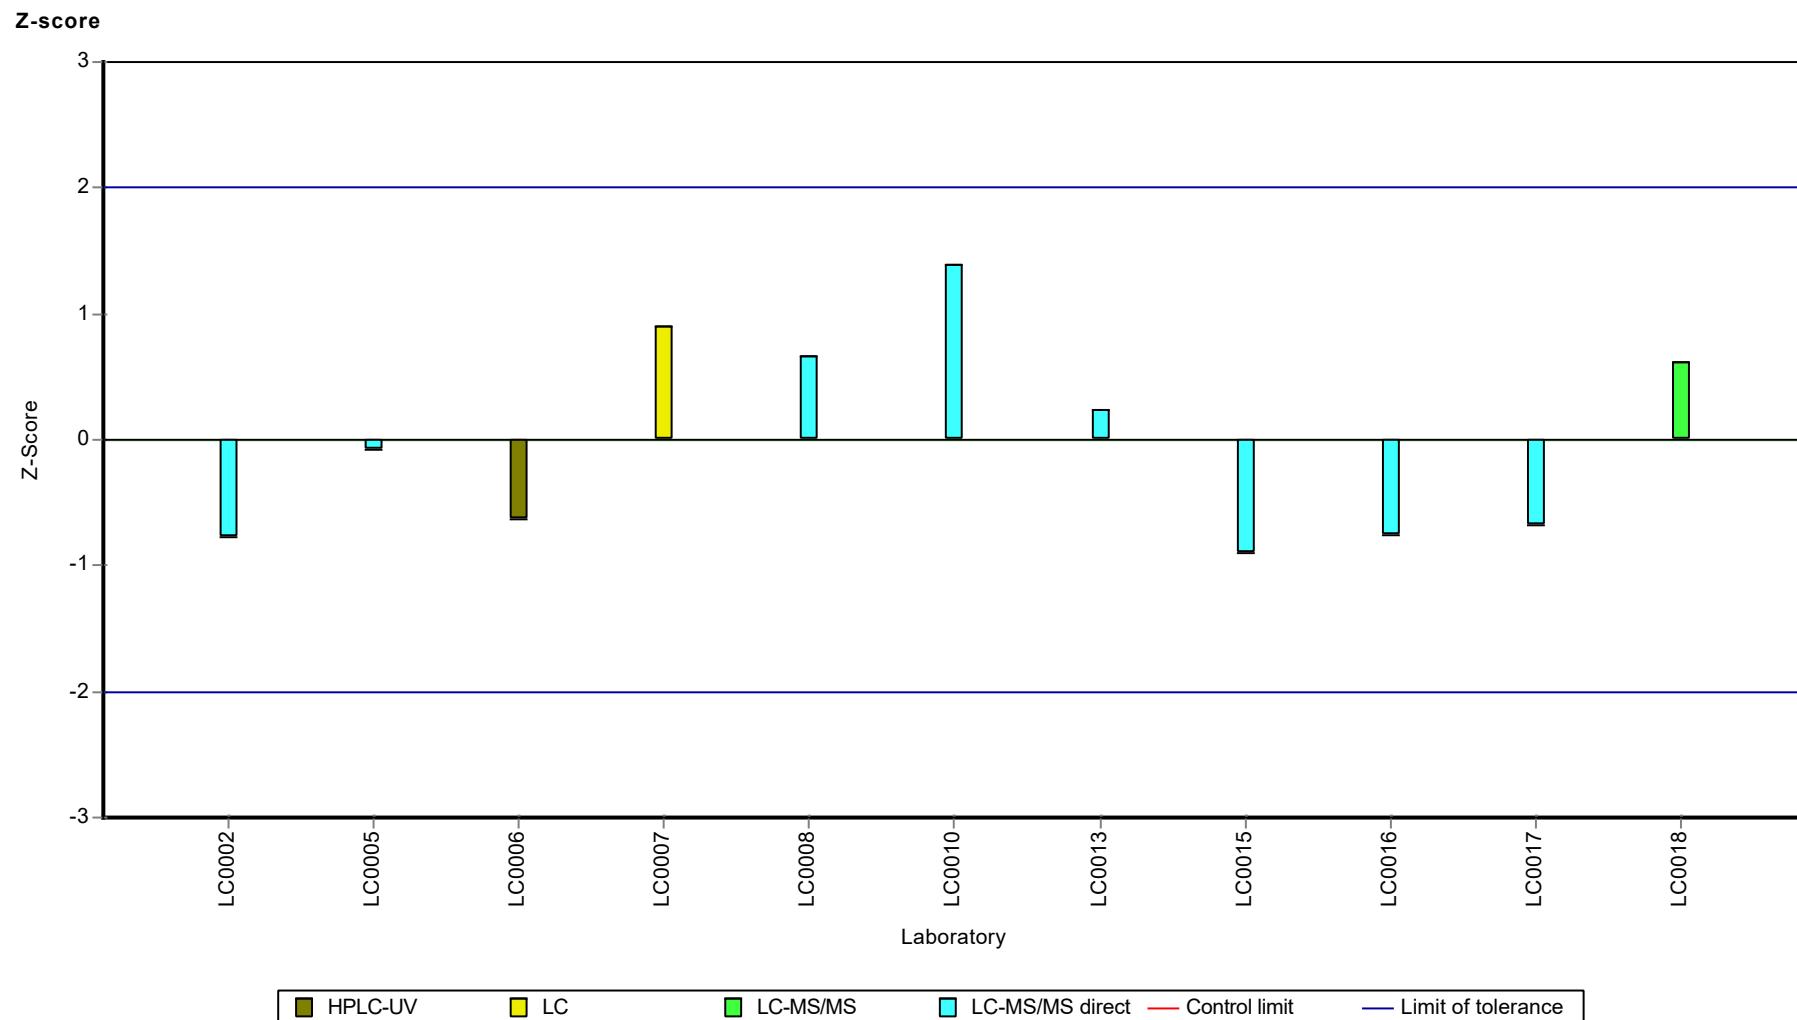

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Dieldrin

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Dieldrin

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.174 ± 0.0139
Criterion	0.04 (23 %)
Minimum - Maximum	0.135 - 0.219
Control test value ± U (k=2)	0.2020 ± 0.0403

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.17	0.0425	-	-	
LC0002	0.1645	0.0458	94.6	-0.23	
LC0003	0.169	0.00508	97.2	-0.12	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.191	0.034	110	0.43	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.166	0.033	95.5	-0.2	
LC0008	0.173	0.043	99.5	-0.02	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.059	0.03	33.9	-2.87	H
LC0013	0.135	0.015	77.7	-0.97	
LC0014	0.16	0.064	92.1	-0.35	
LC0015	0.275	0.041	158	2.53	H
LC0016	0.219	0.04	126	1.13	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.175	0.088	101	0.03	
LC0019	0.1855	0.028	107	0.29	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.173 ± 0.0435	0.174 ± 0.0208	µg/l
Minimum	0.059	0.135	µg/l
Maximum	0.275	0.219	µg/l
Standard deviation	0.0502	0.022	µg/l
rel. standard deviation	29.1	12.6	%
n	12	10	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Dieldrin


### Graphical presentation of results

#### Results

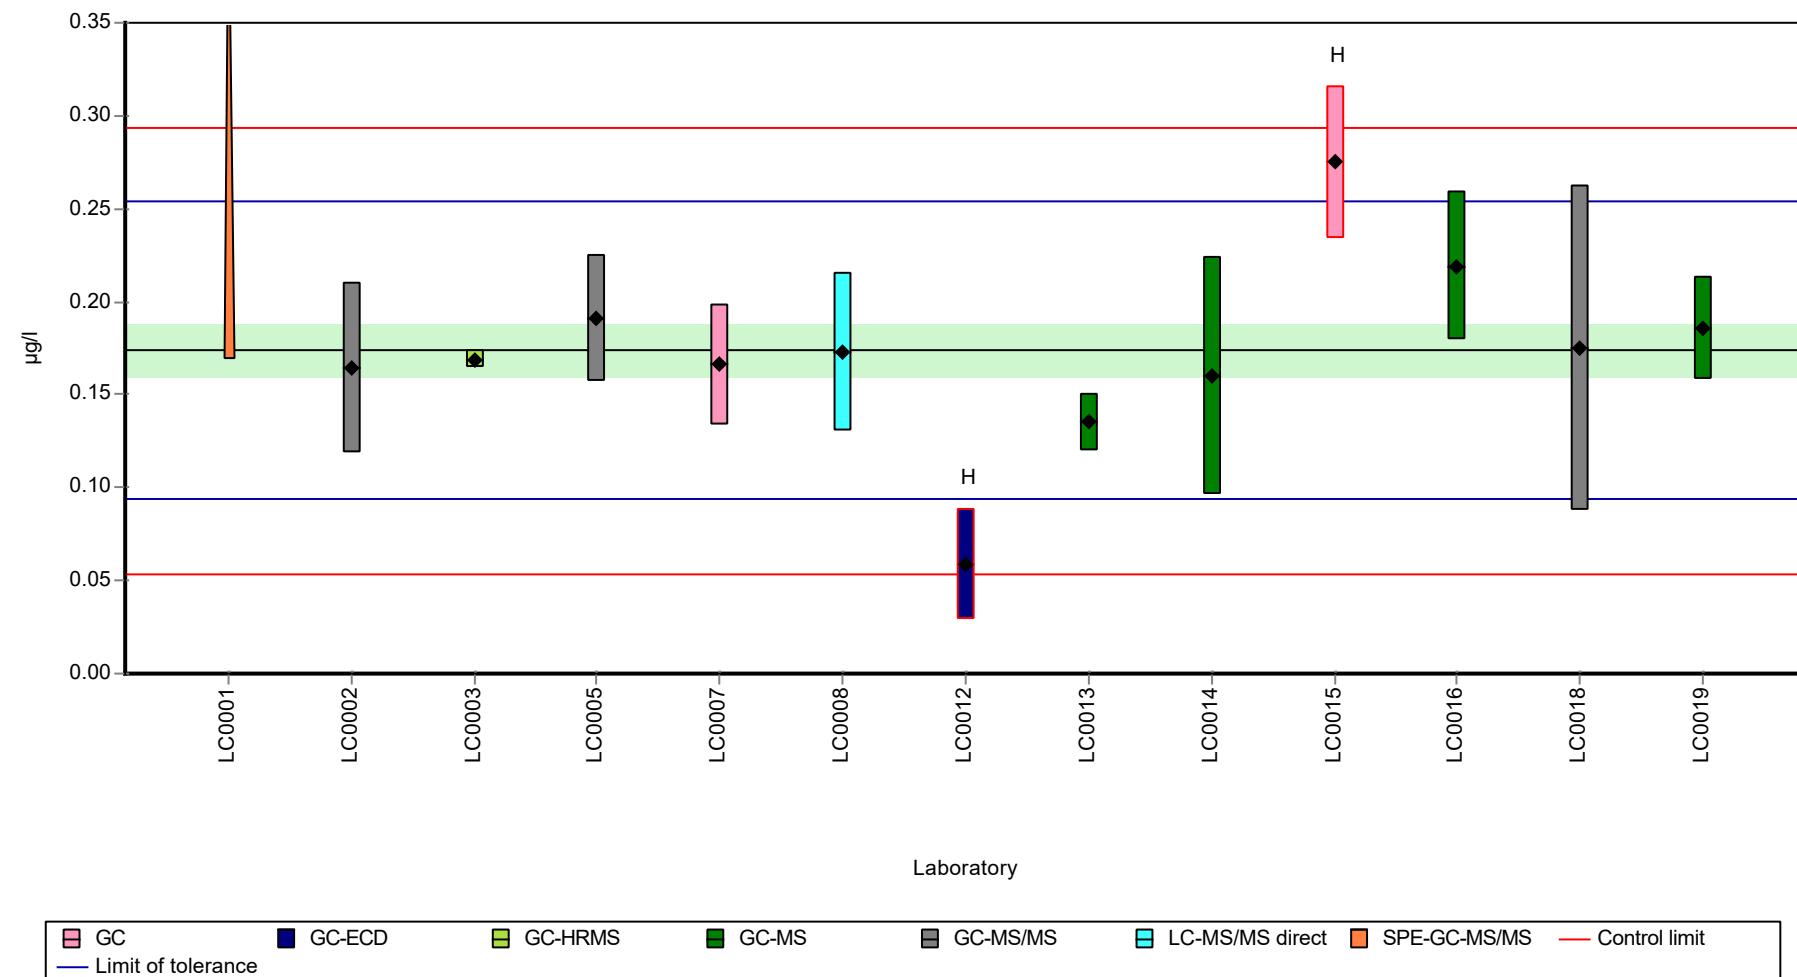


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Dieldrin

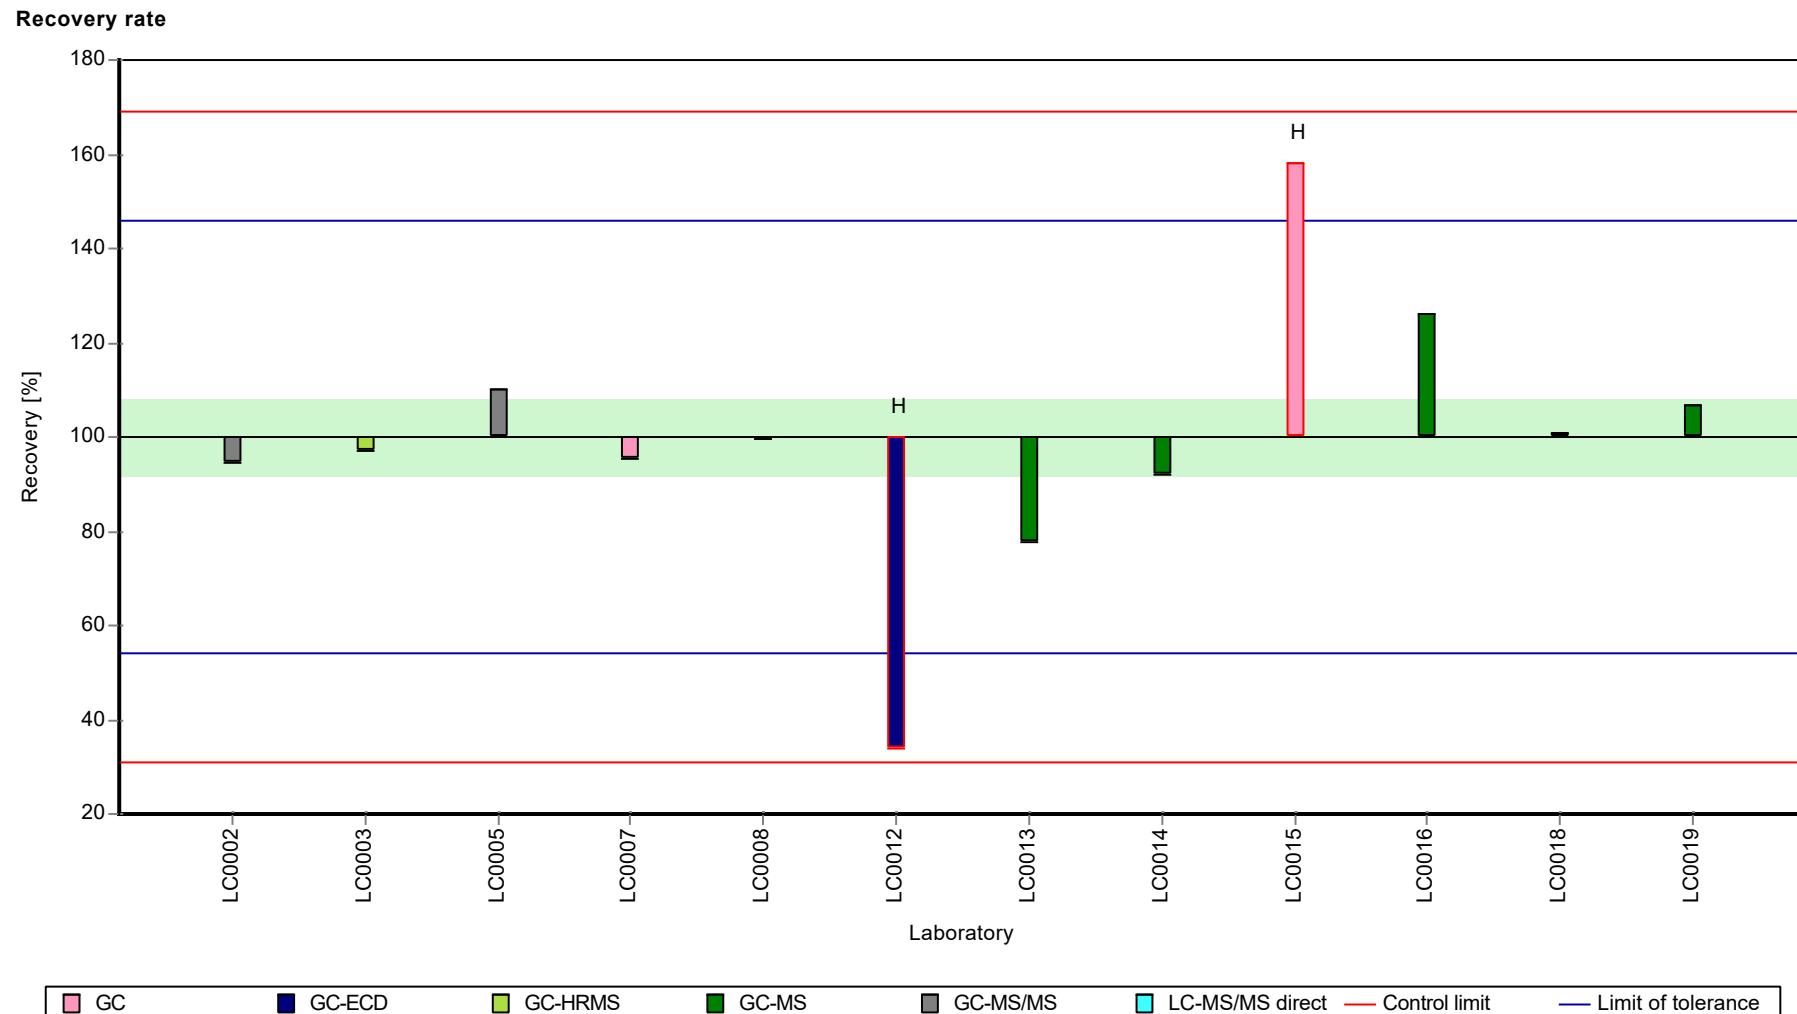

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Dieldrin

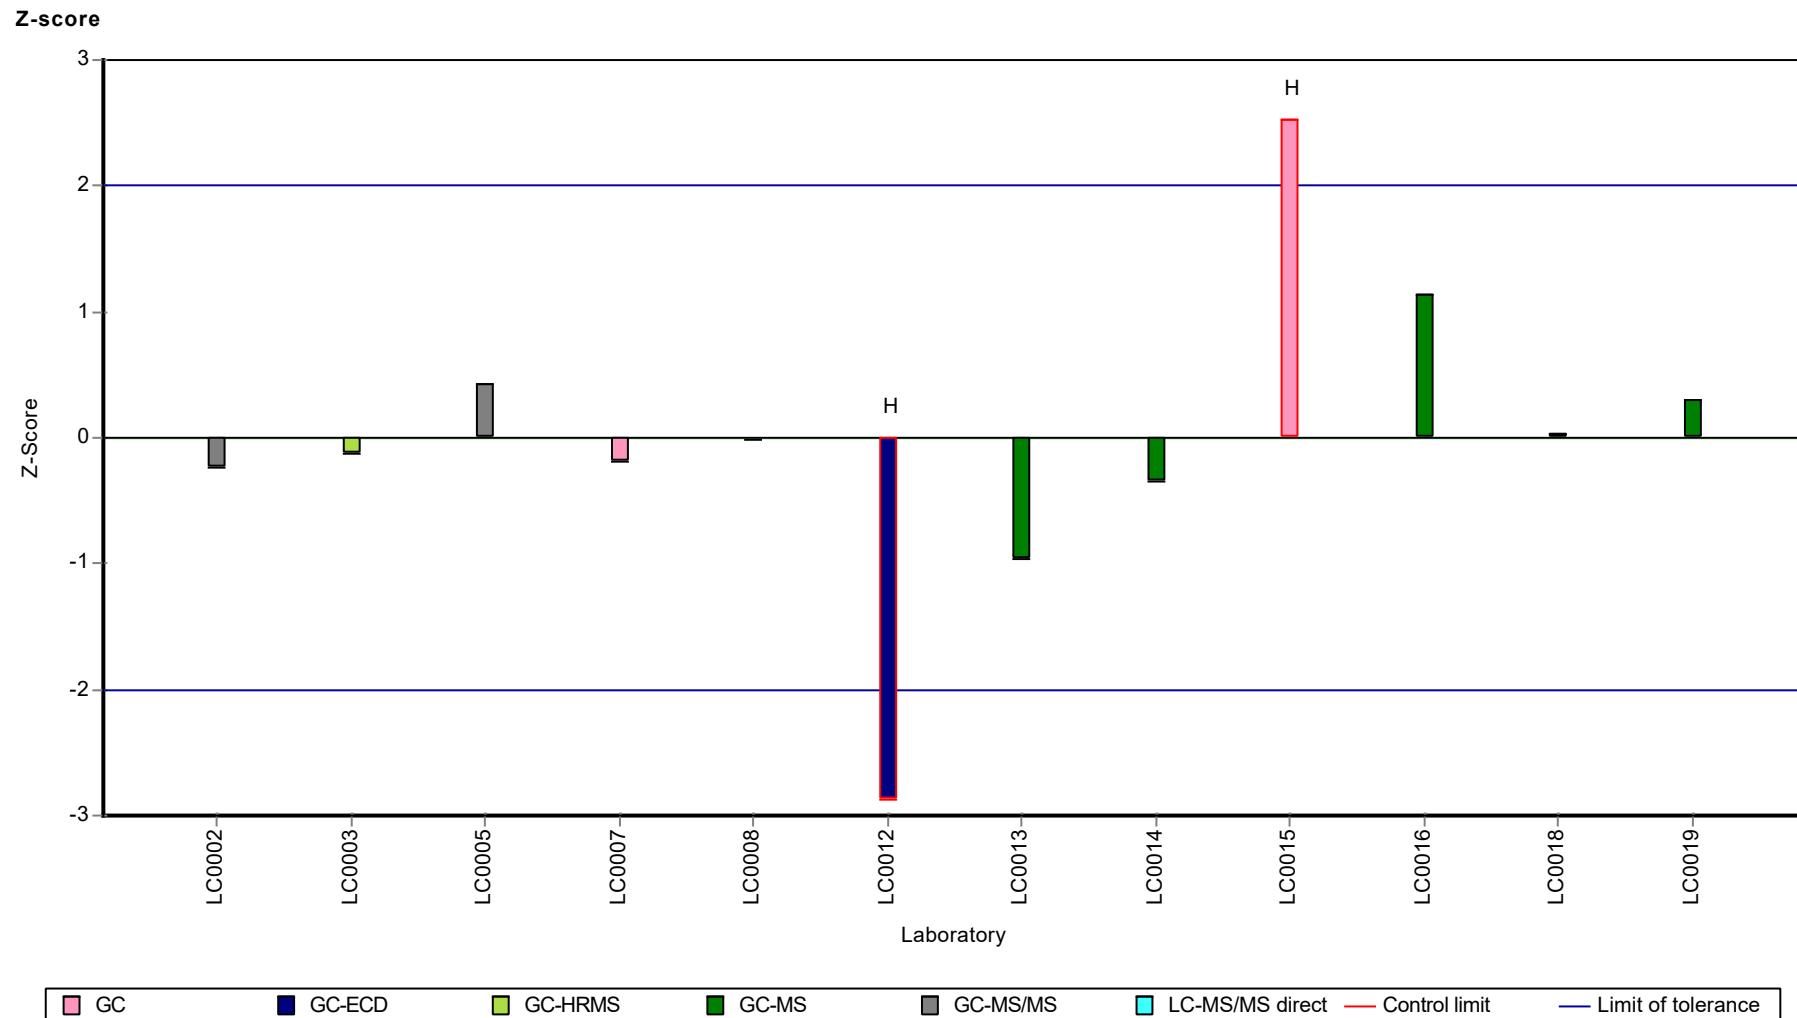

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Dieldrin

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Dieldrin

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.487 ± 0.0518
Criterion	0.112 (23 %)
Minimum - Maximum	0.317 - 0.63
Control test value ± U (k=2)	0.574 ± 0.115

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.17	0.0425	-	-	
LC0002	0.3957	0.11	81.3	-0.81	
LC0003	0.58	0.0107	119	0.83	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.542	0.098	111	0.49	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.484	0.097	99.4	-0.03	
LC0008	0.462	0.116	94.9	-0.22	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.317	0.159	65.1	-1.52	
LC0013	0.406	0.031	83.4	-0.72	
LC0014	0.5	0.2	103	0.12	
LC0015	0.63	0.095	129	1.28	
LC0016	0.526	0.097	108	0.35	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.57	0.285	117	0.74	
LC0019	0.4291	0.064	88.1	-0.52	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.487 ± 0.0777	0.487 ± 0.0777	µg/l
Minimum	0.317	0.317	µg/l
Maximum	0.63	0.63	µg/l
Standard deviation	0.0897	0.0897	µg/l
rel. standard deviation	18.4	18.4	%
n	12	12	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Dieldrin


#### Graphical presentation of results

##### Results

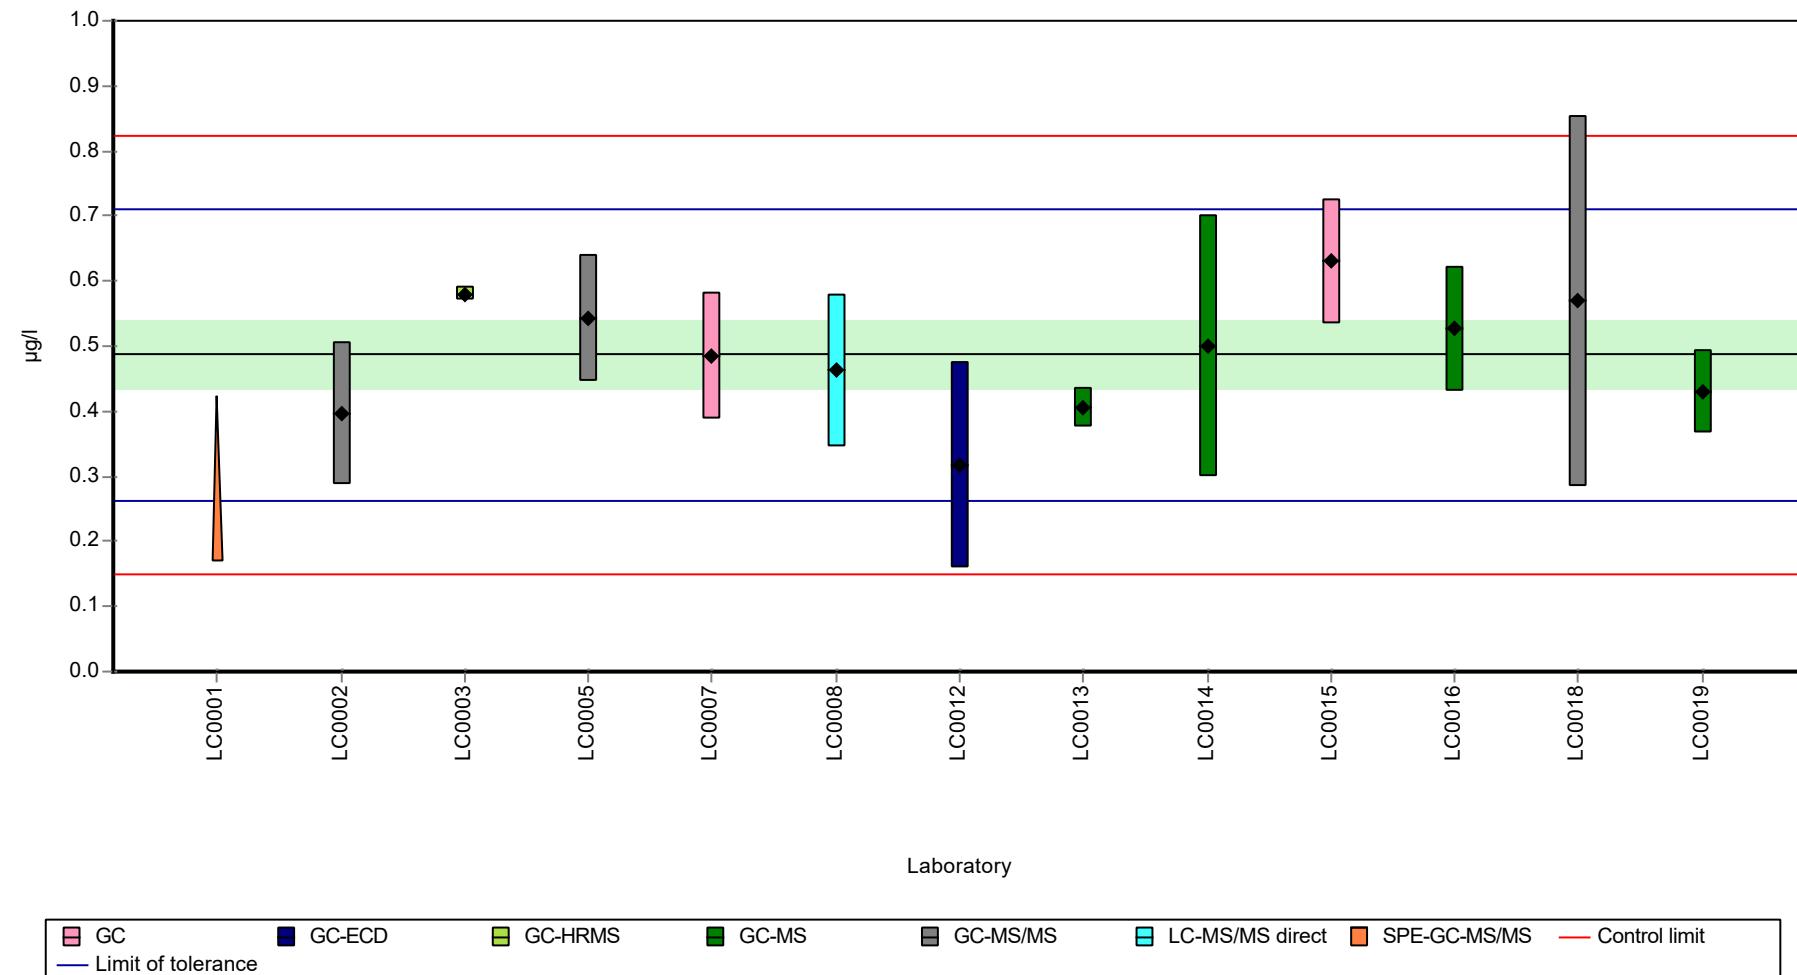


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Dieldrin

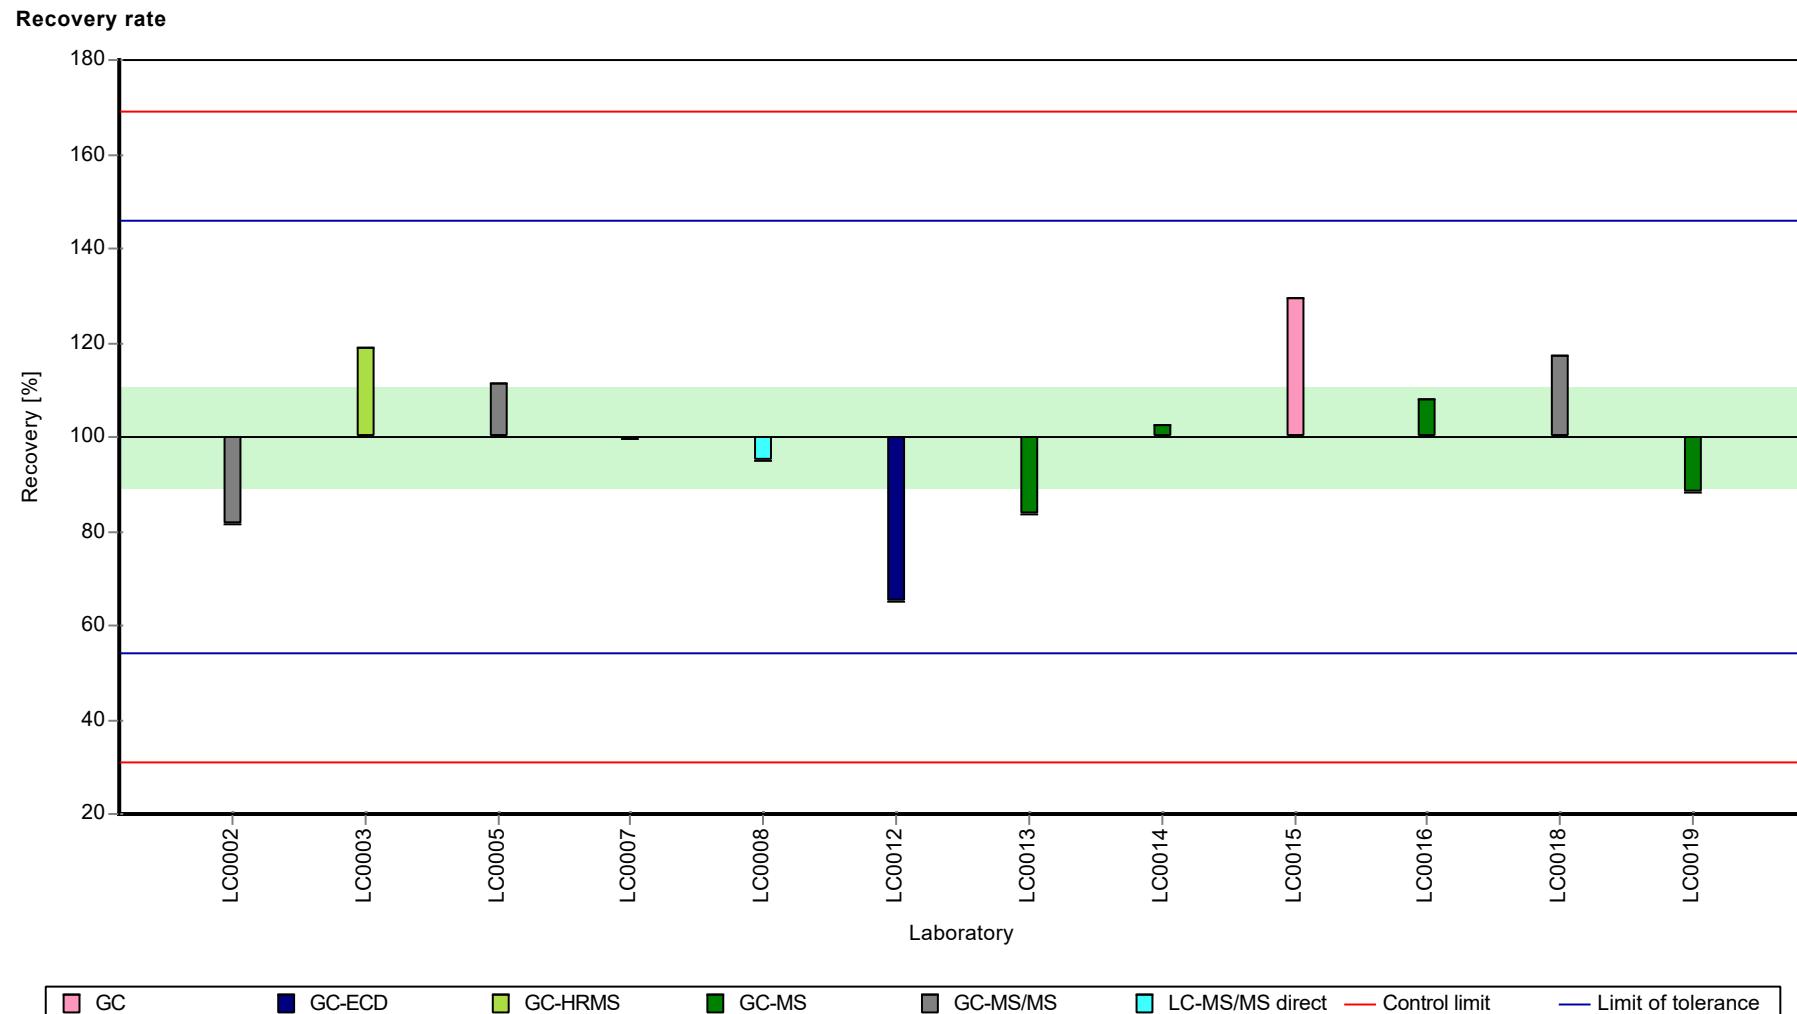

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Dieldrin

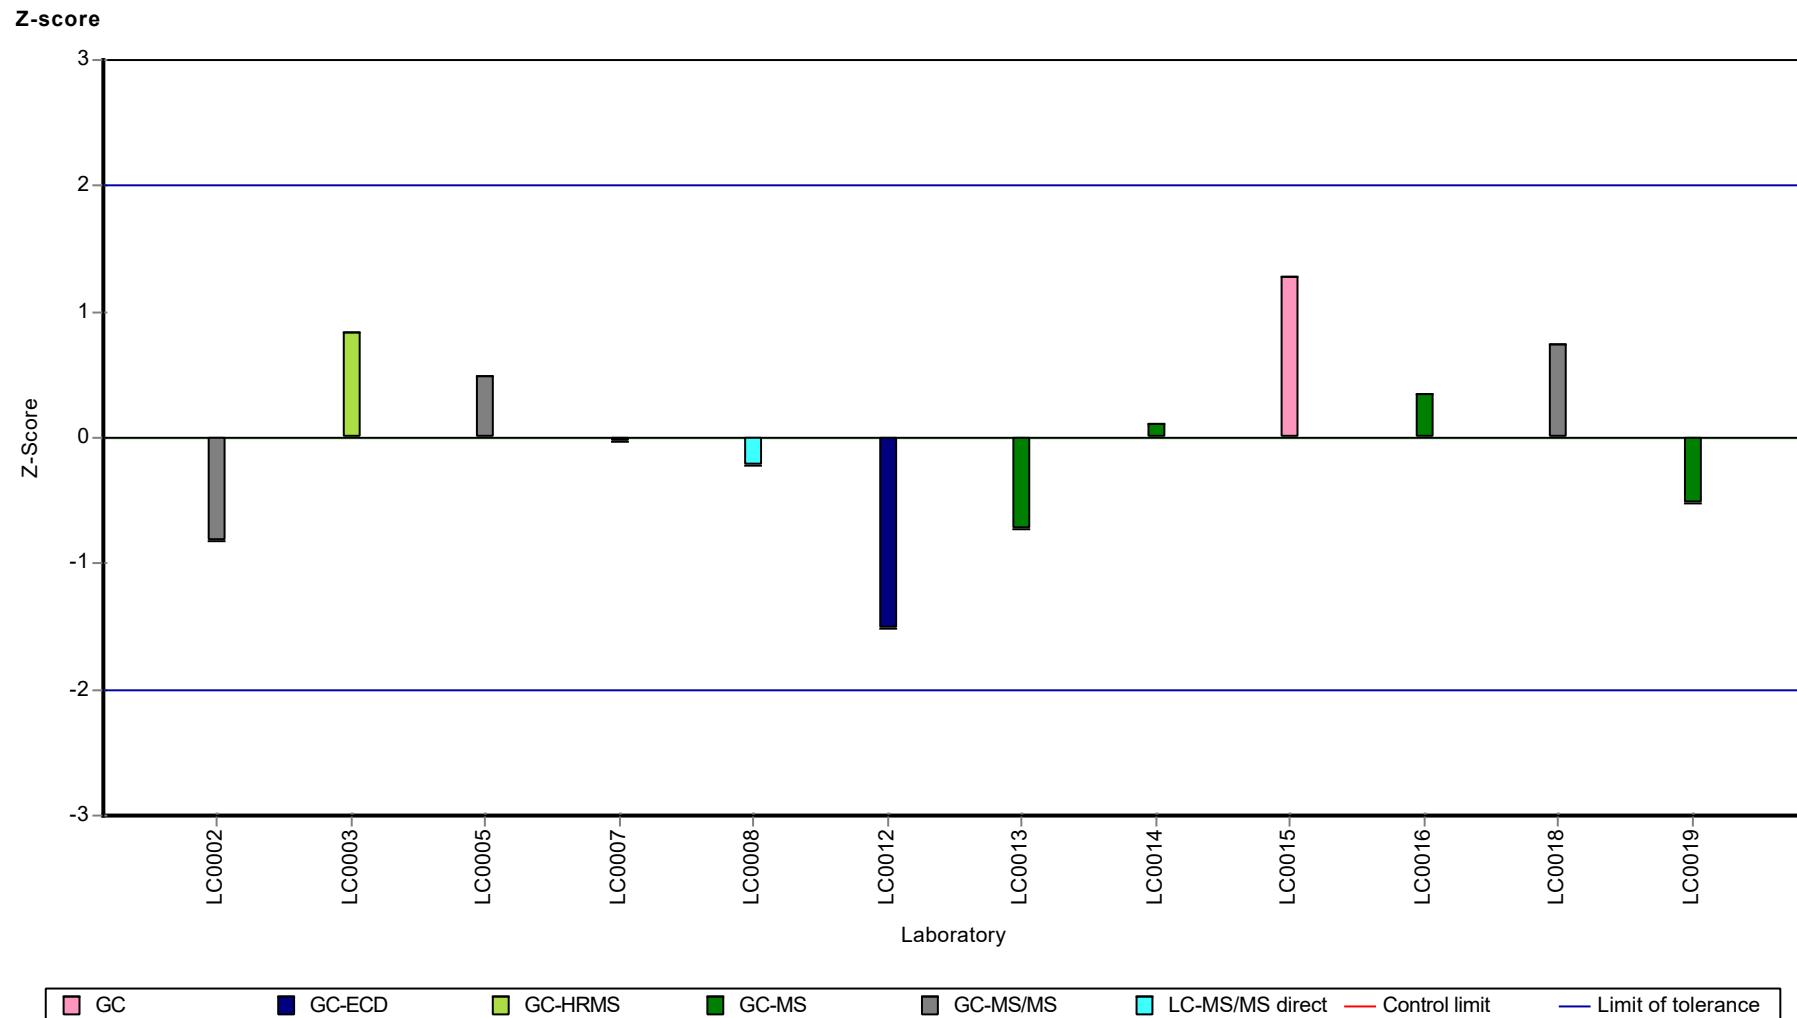

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Dinotefurane

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Dinotefurane

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	-
Criterion	-
Minimum - Maximum	0.1 - 0.163
Control test value ± U (k=2)	0.0802 ± 0.0241

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	-	-	-	-	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	0.163	0.041	-	-	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	-	-	-	-	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	-	-	-	-	
LC0016	-	-	-	-	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.1	0.05	-	-	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.132 ± 0.0945	-	µg/l
Minimum	0.1	0.1	µg/l
Maximum	0.163	0.163	µg/l
Standard deviation	0.0445	-	µg/l
rel. standard deviation	33.9	-	%
n	2	2	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Dinotefurane

**Graphical presentation of results**

**Results**

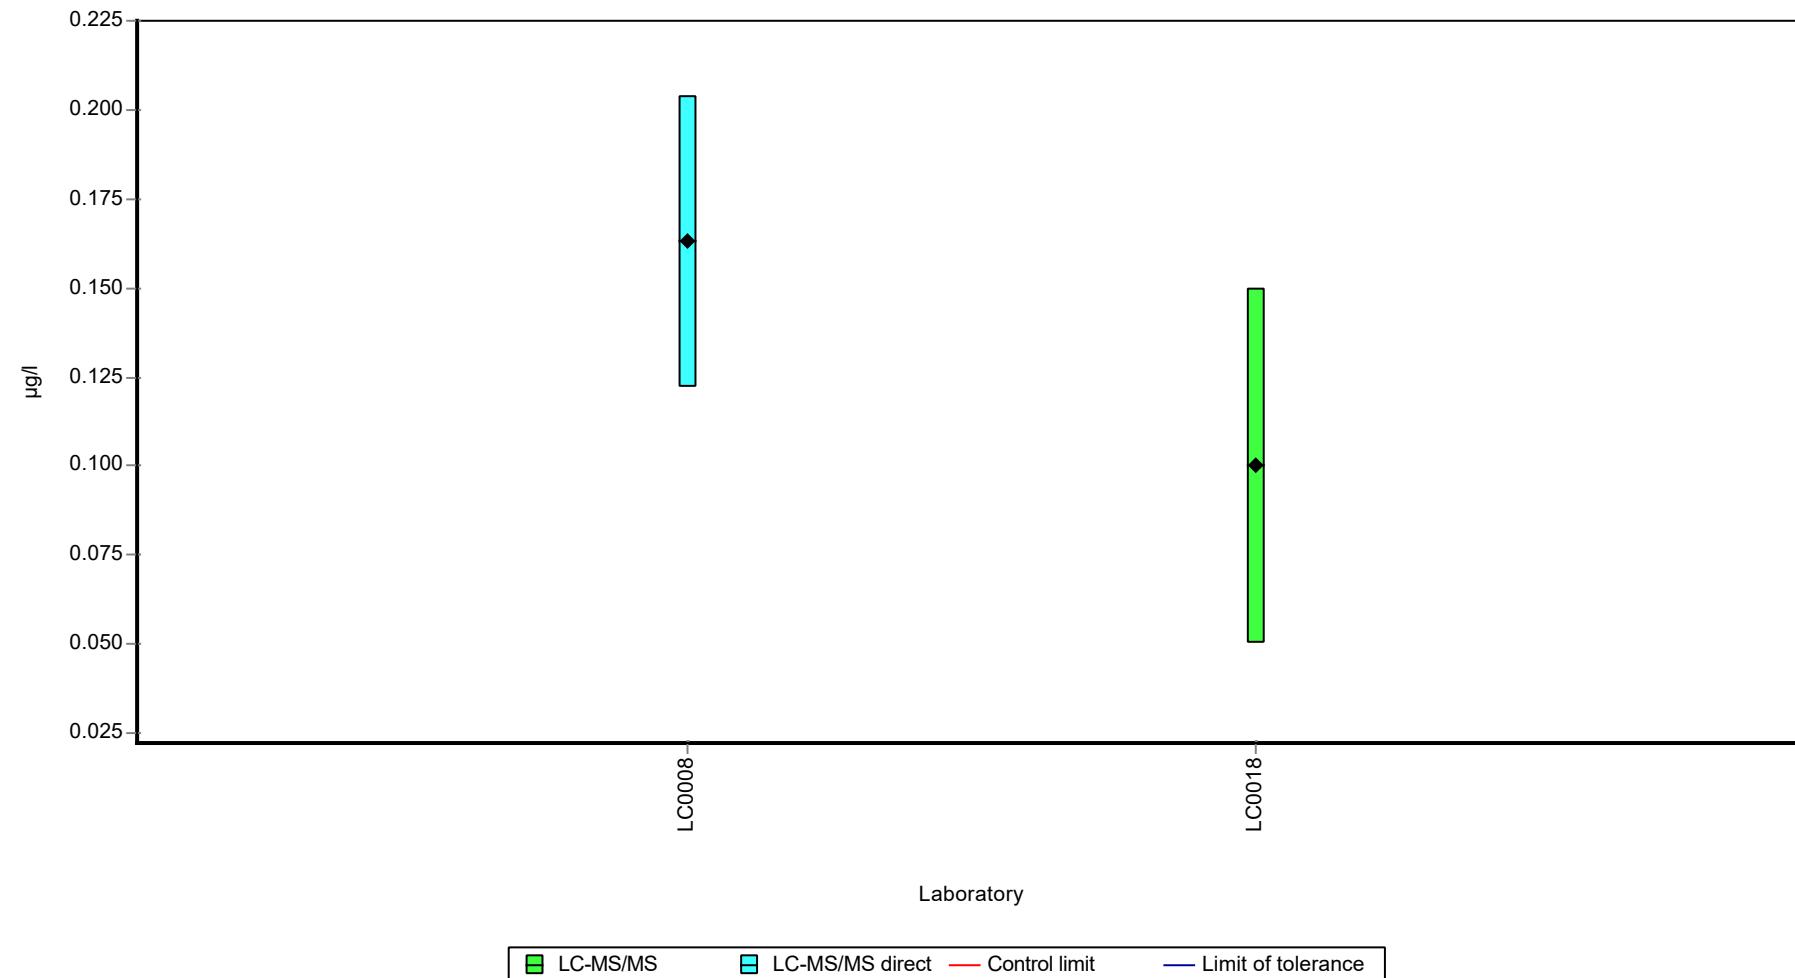

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Dinotefurane

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Dinotefurane

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	-
Criterion	-
Minimum - Maximum	1.75 - 1.95
Control test value ± U (k=2)	1.820 ± 0.273

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	-	-	-	-	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	1.746	0.437	-	-	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	-	-	-	-	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	-	-	-	-	
LC0016	-	-	-	-	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	1.95	0.975	-	-	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	1.85 ± 0.306	-	µg/l
Minimum	1.75	1.75	µg/l
Maximum	1.95	1.95	µg/l
Standard deviation	0.144	-	µg/l
rel. standard deviation	7.81	-	%
n	2	2	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Dinotefurane

**Graphical presentation of results**

**Results**

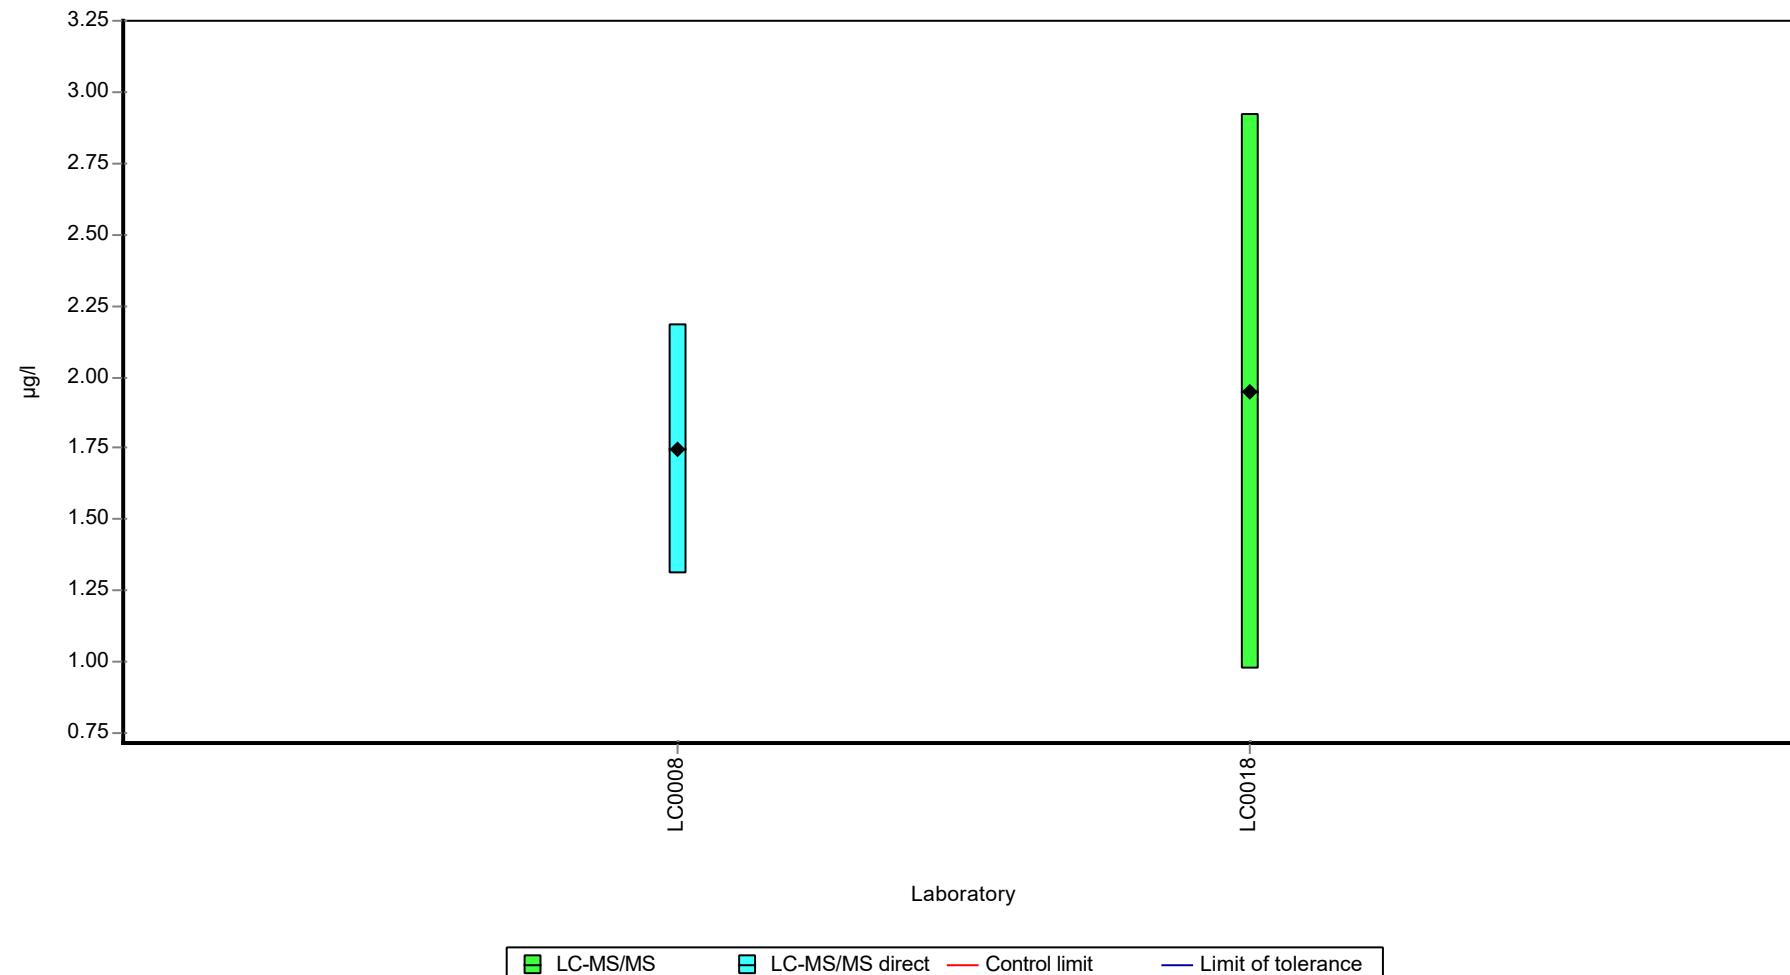

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Endrin

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Endrin

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.147 ± 0.0363
Criterion	0.0543 (37 %)
Minimum - Maximum	0.053 - 0.224
Control test value ± U (k=2)	0.1840 ± 0.0368

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.17	0.0425	-	-	
LC0002	0.1524	0.0685	104	0.1	
LC0003	0.186	0.00559	127	0.72	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.147	0.026	100	0.01	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.127	0.026	86.6	-0.36	
LC0008	0.16	0.04	109	0.24	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.053	0.027	36.1	-1.73	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.224	0.034	153	1.42	
LC0016	0.193	0.029	132	0.85	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.078	0.037	53.2	-1.27	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.147 ± 0.0545	0.147 ± 0.0545	µg/l
Minimum	0.053	0.053	µg/l
Maximum	0.224	0.224	µg/l
Standard deviation	0.0545	0.0545	µg/l
rel. standard deviation	37.1	37.1 %	
n	9	9	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Endrin


#### Graphical presentation of results

##### Results

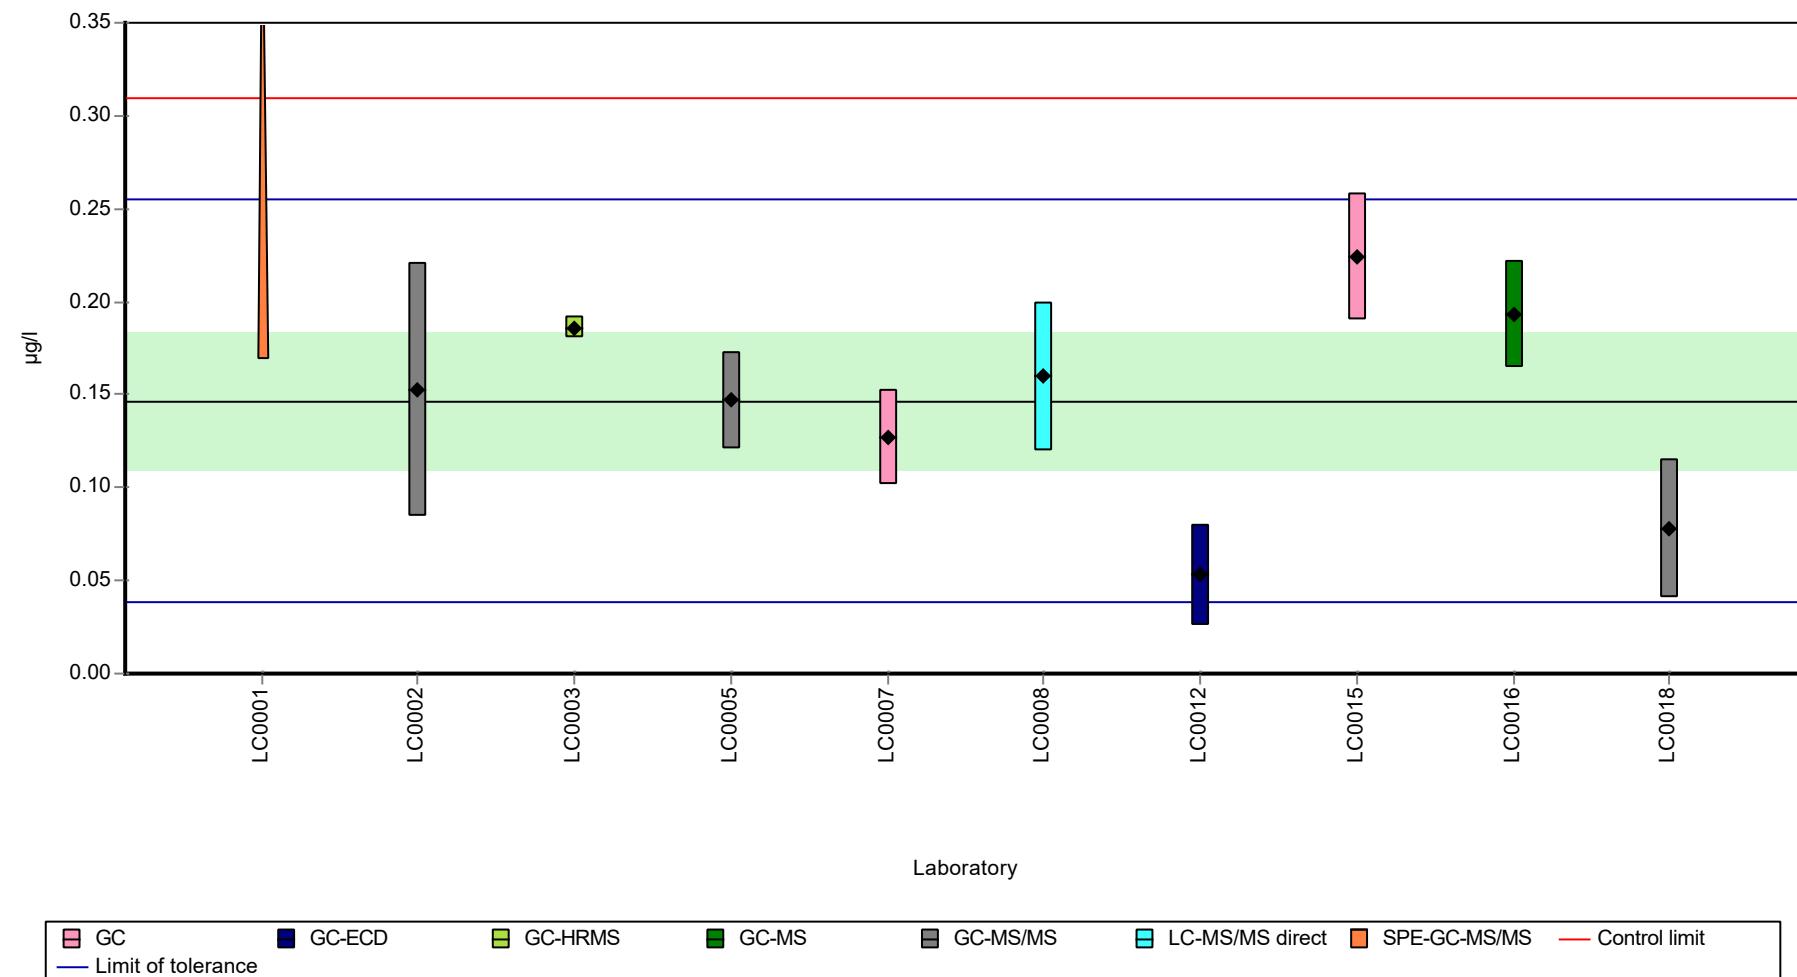


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Endrin

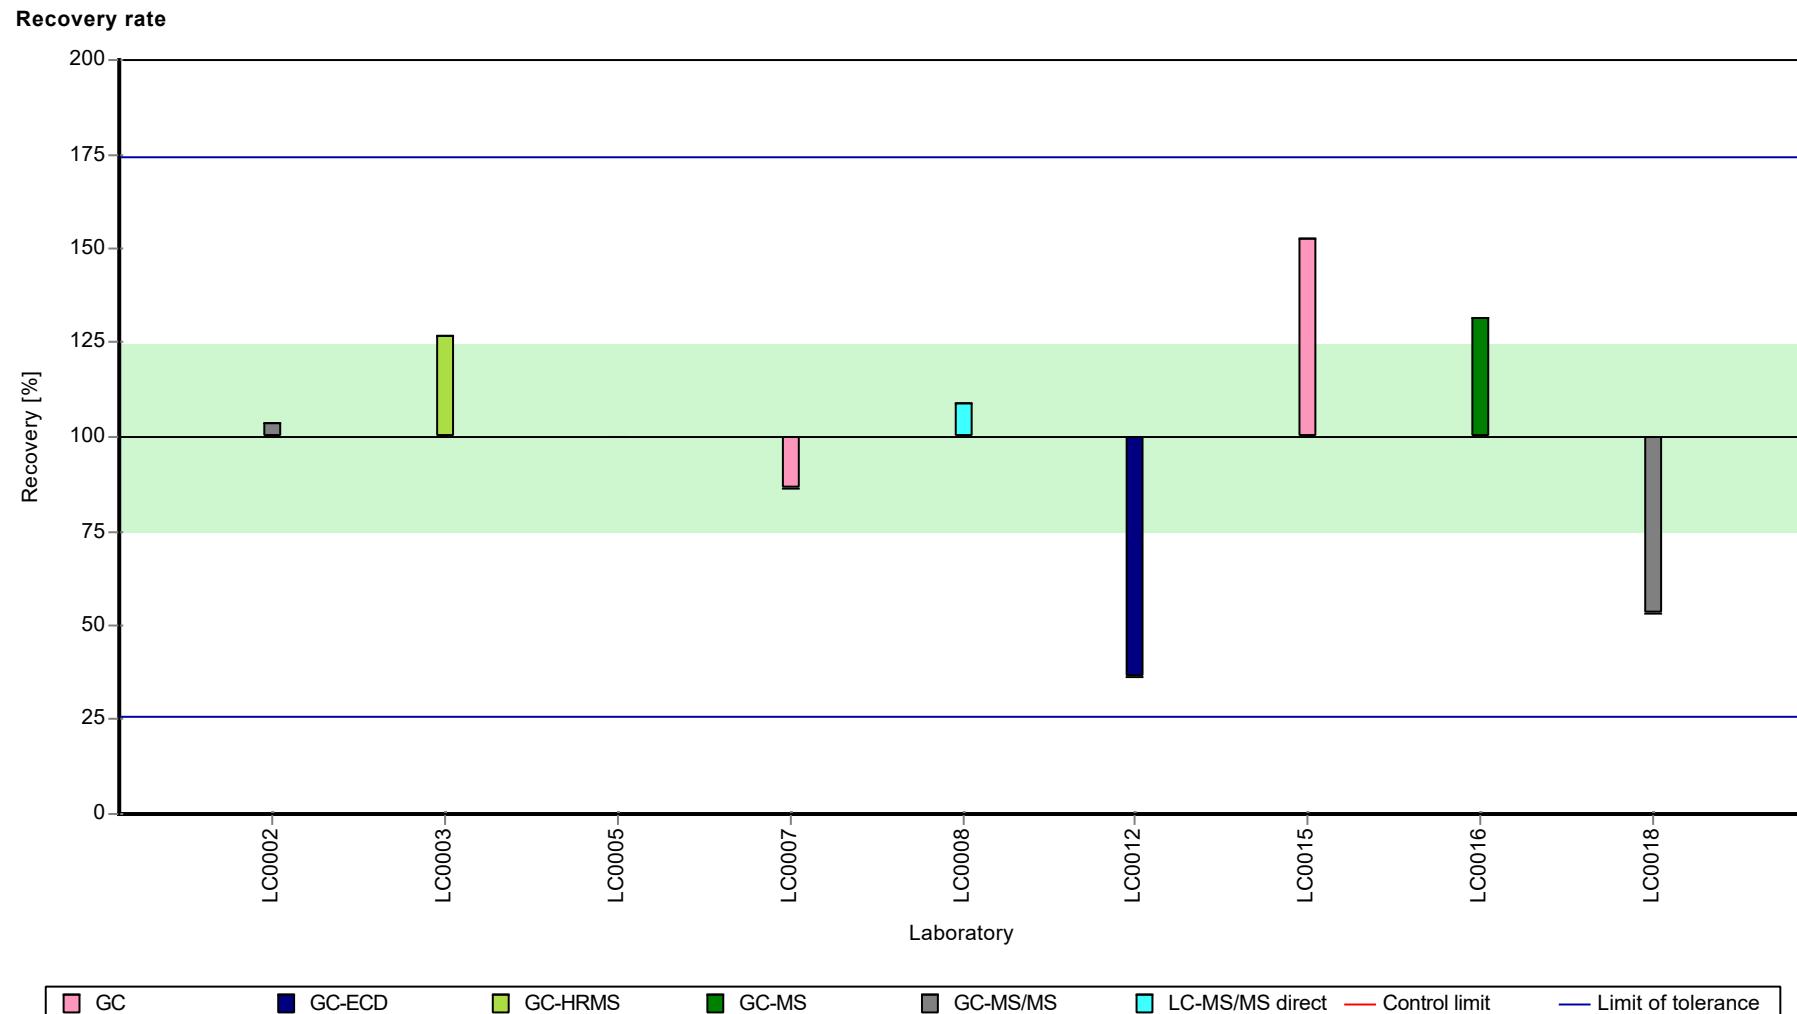

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Endrin

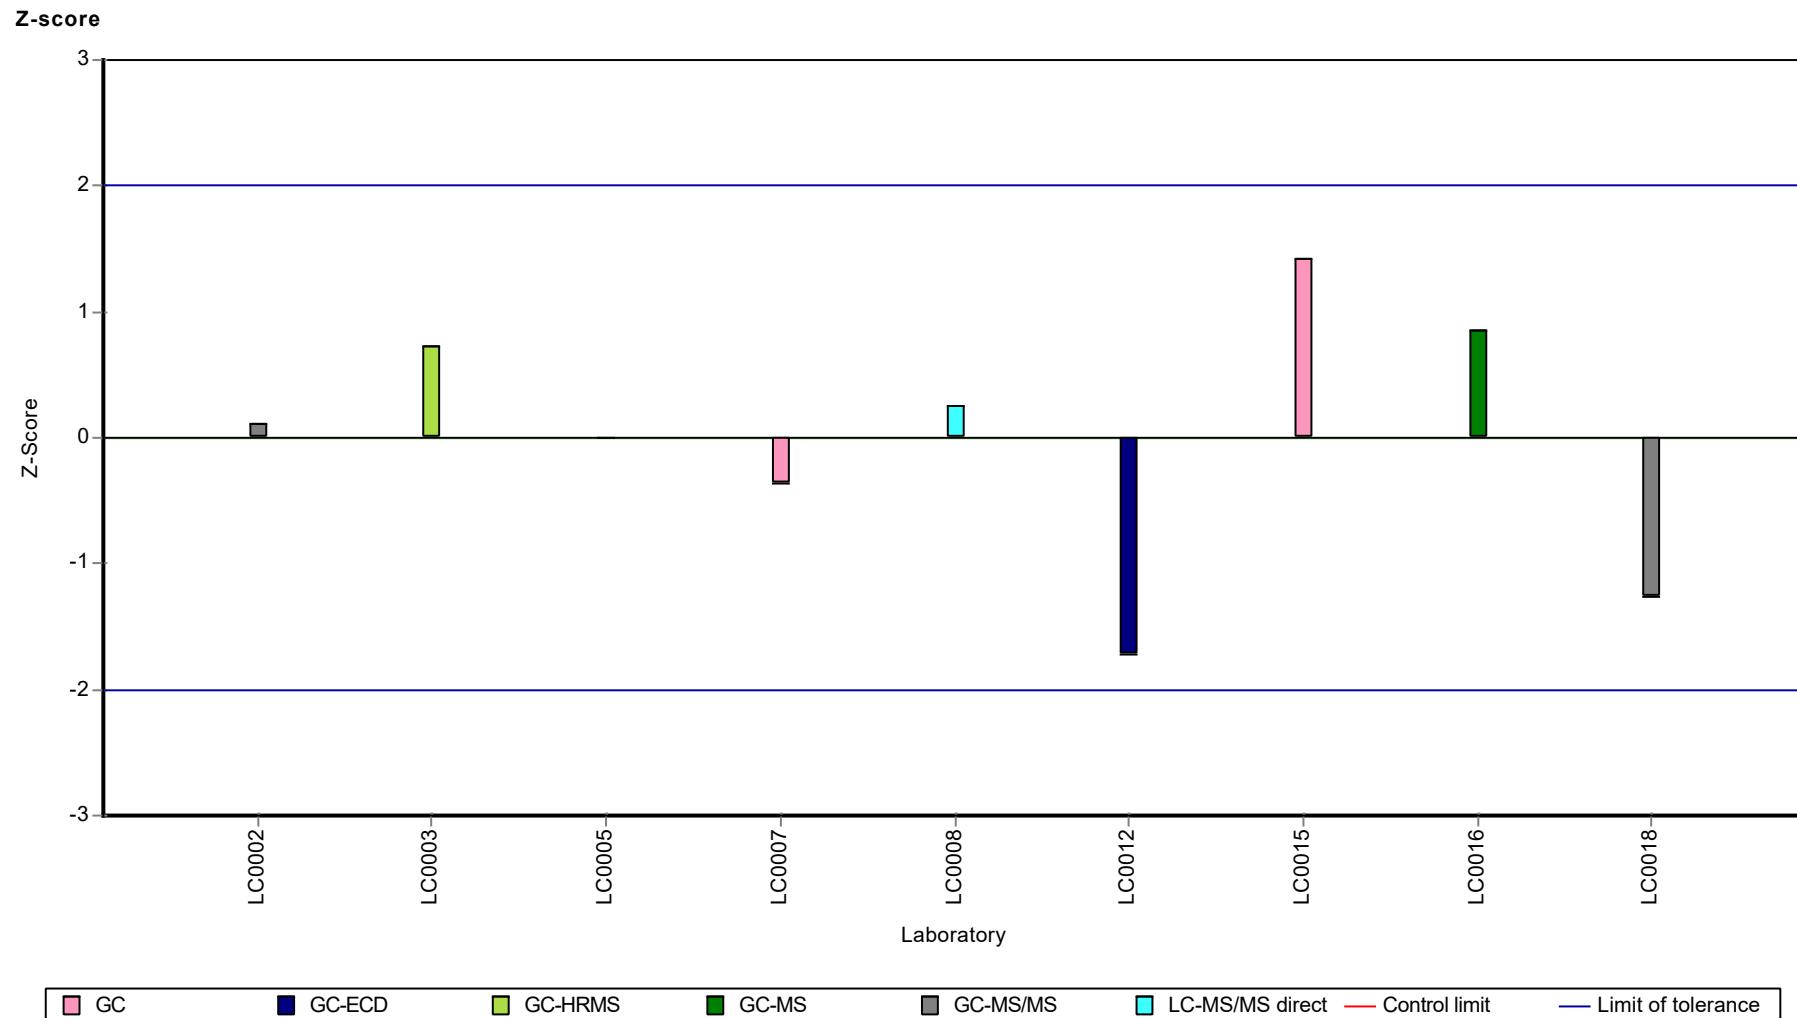

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Endrin

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Endrin

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.428 ± 0.0902
Criterion	0.111 (26 %)
Minimum - Maximum	0.245 - 0.531
Control test value ± U (k=2)	0.640 ± 0.128

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.17	0.0425	-	-	
LC0002	0.4377	0.1967	102	0.08	
LC0003	0.43	0.0129	100	0.01	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.357	0.064	83.3	-0.64	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.487	0.098	114	0.53	
LC0008	0.52	0.13	121	0.82	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.062	0.031	14.5	-3.29	H
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.524	0.079	122	0.86	
LC0016	0.531	0.08	124	0.92	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.245	0.123	57.2	-1.65	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.399 ± 0.157	0.441 ± 0.105	µg/l
Minimum	0.062	0.245	µg/l
Maximum	0.531	0.531	µg/l
Standard deviation	0.157	0.0992	µg/l
rel. standard deviation	39.3	22.5 %	
n	9	8	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Endrin


**Graphical presentation of results**

**Results**

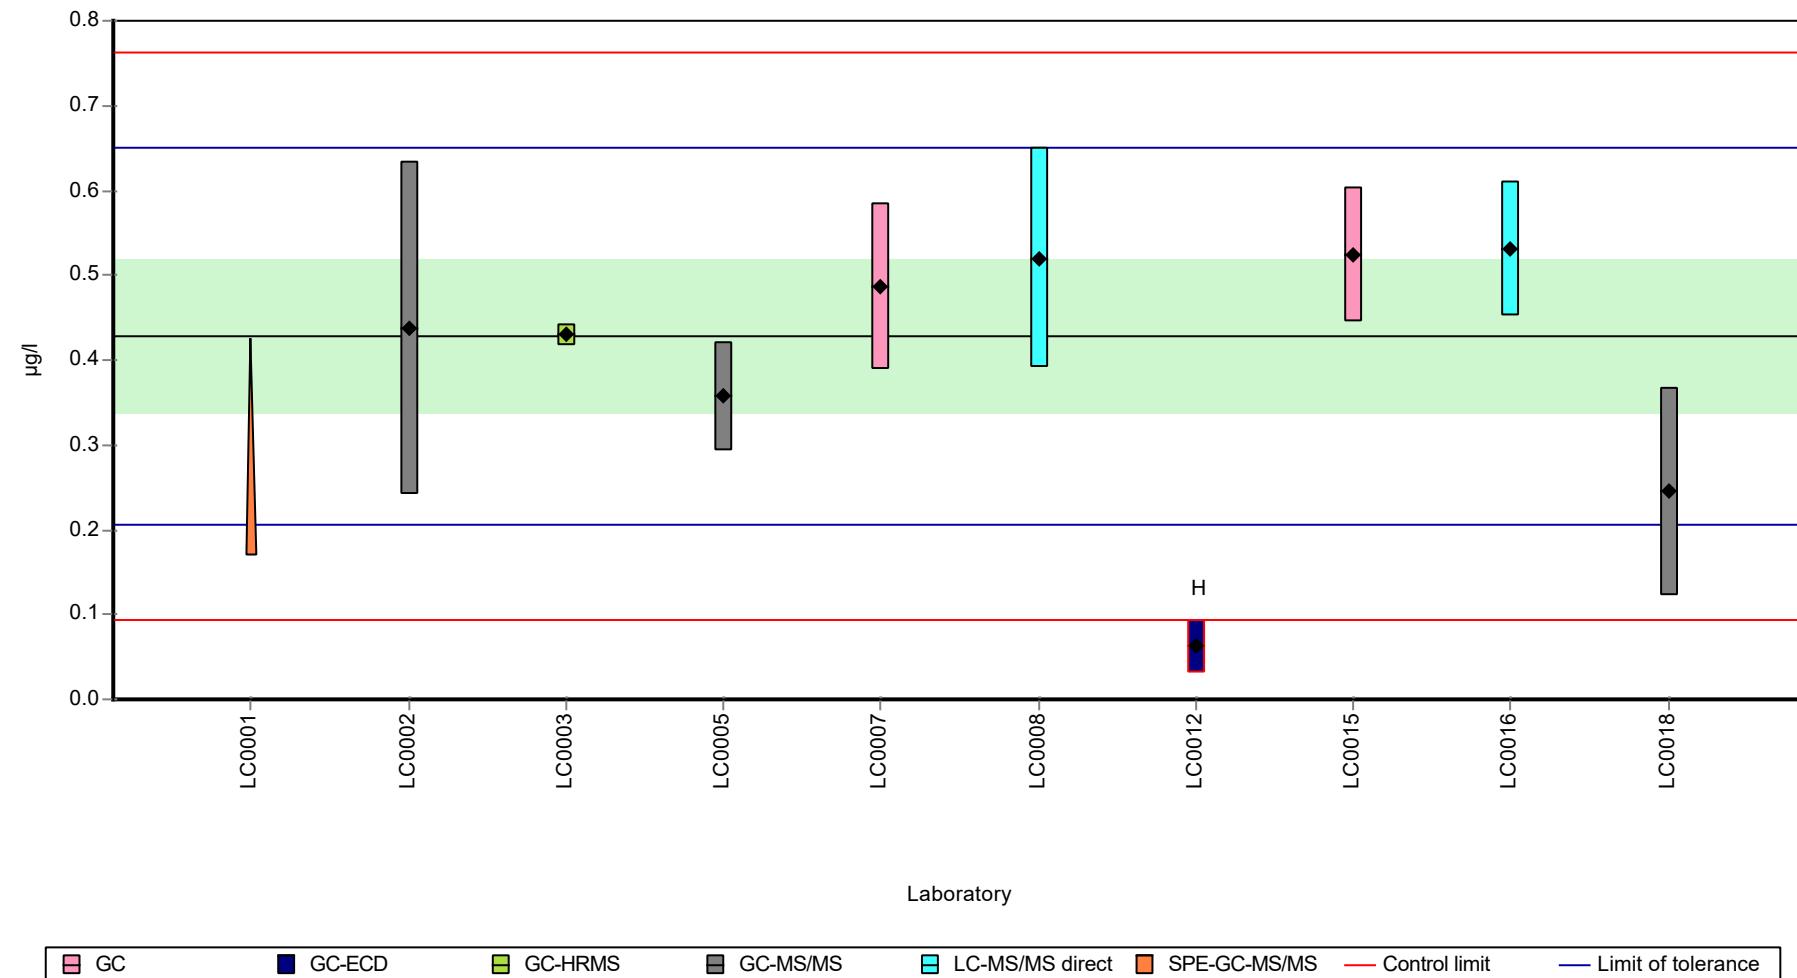


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Endrin

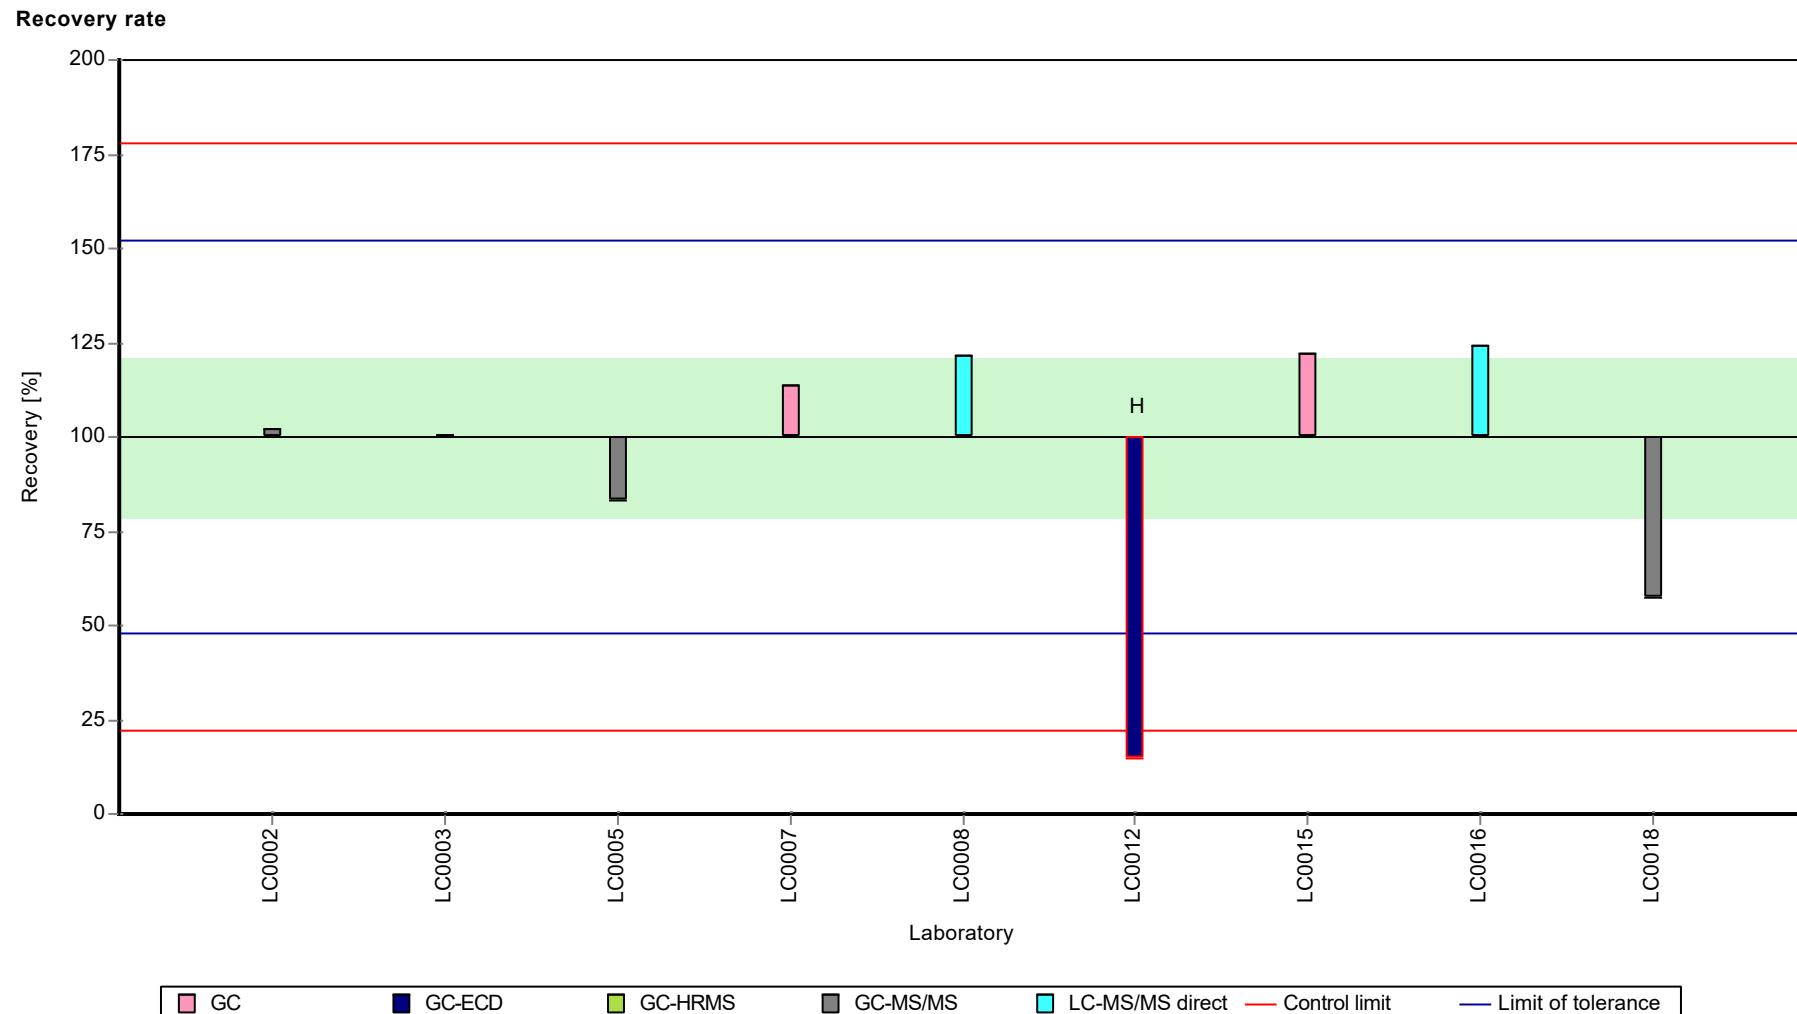

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Endrin

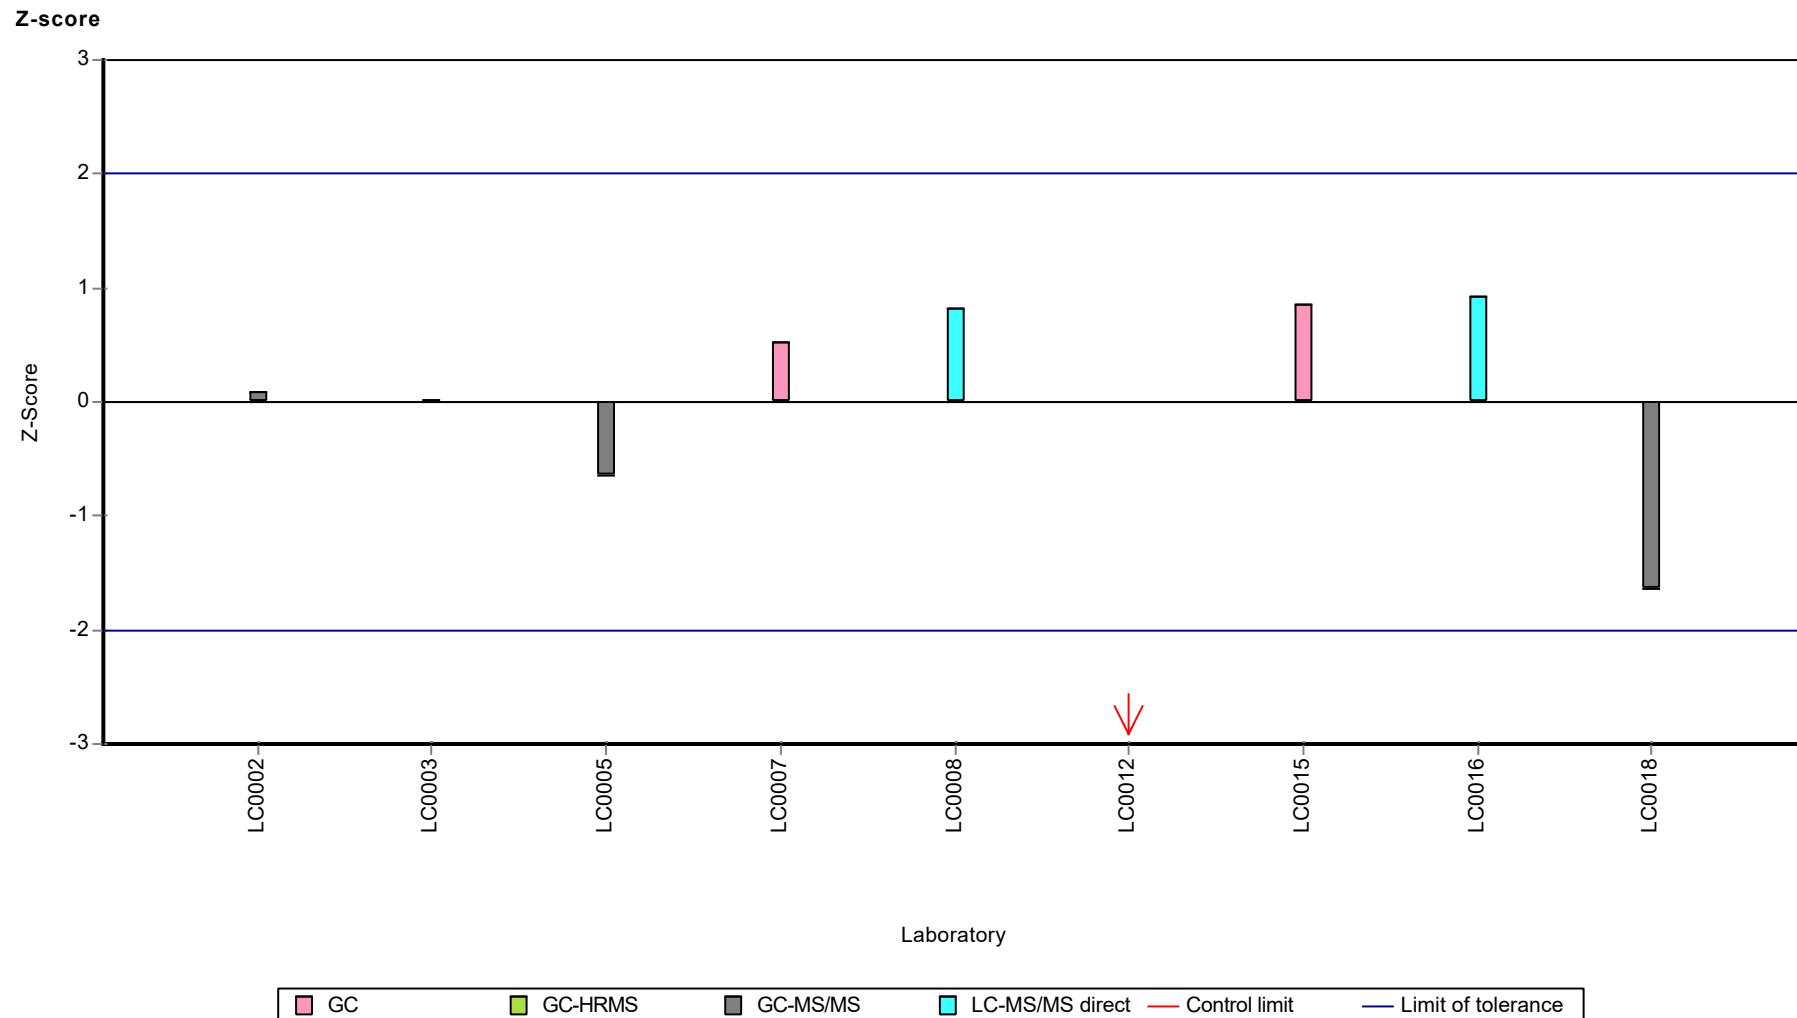

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Heptachlor

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Heptachlor

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.108 ± 0.0312
Criterion	0.0433 (40 %)
Minimum - Maximum	0.009 - 0.175
Control test value ± U (k=2)	0.1400 ± 0.0559

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	0.175	0.0438	162	1.54	
LC0002	0.1218	0.053	112	0.31	
LC0003	0.128	0.00385	118	0.45	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.117	0.021	108	0.2	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.115	0.023	106	0.15	
LC0008	0.024	0.006	22.2	-1.95	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.009	0.005	8.3	-2.29	
LC0013	0.159	0.016	147	1.17	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.307	0.046	283	4.59	H
LC0016	0.08	0.015	73.9	-0.65	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.14	0.07	129	0.73	
LC0019	0.1226	0.018	113	0.33	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.125 ± 0.0655	0.108 ± 0.0467	µg/l
Minimum	0.009	0.009	µg/l
Maximum	0.307	0.175	µg/l
Standard deviation	0.0756	0.0517	µg/l
rel. standard deviation	60.5	47.7 %	
n	12	11	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Heptachlor


#### Graphical presentation of results

##### Results

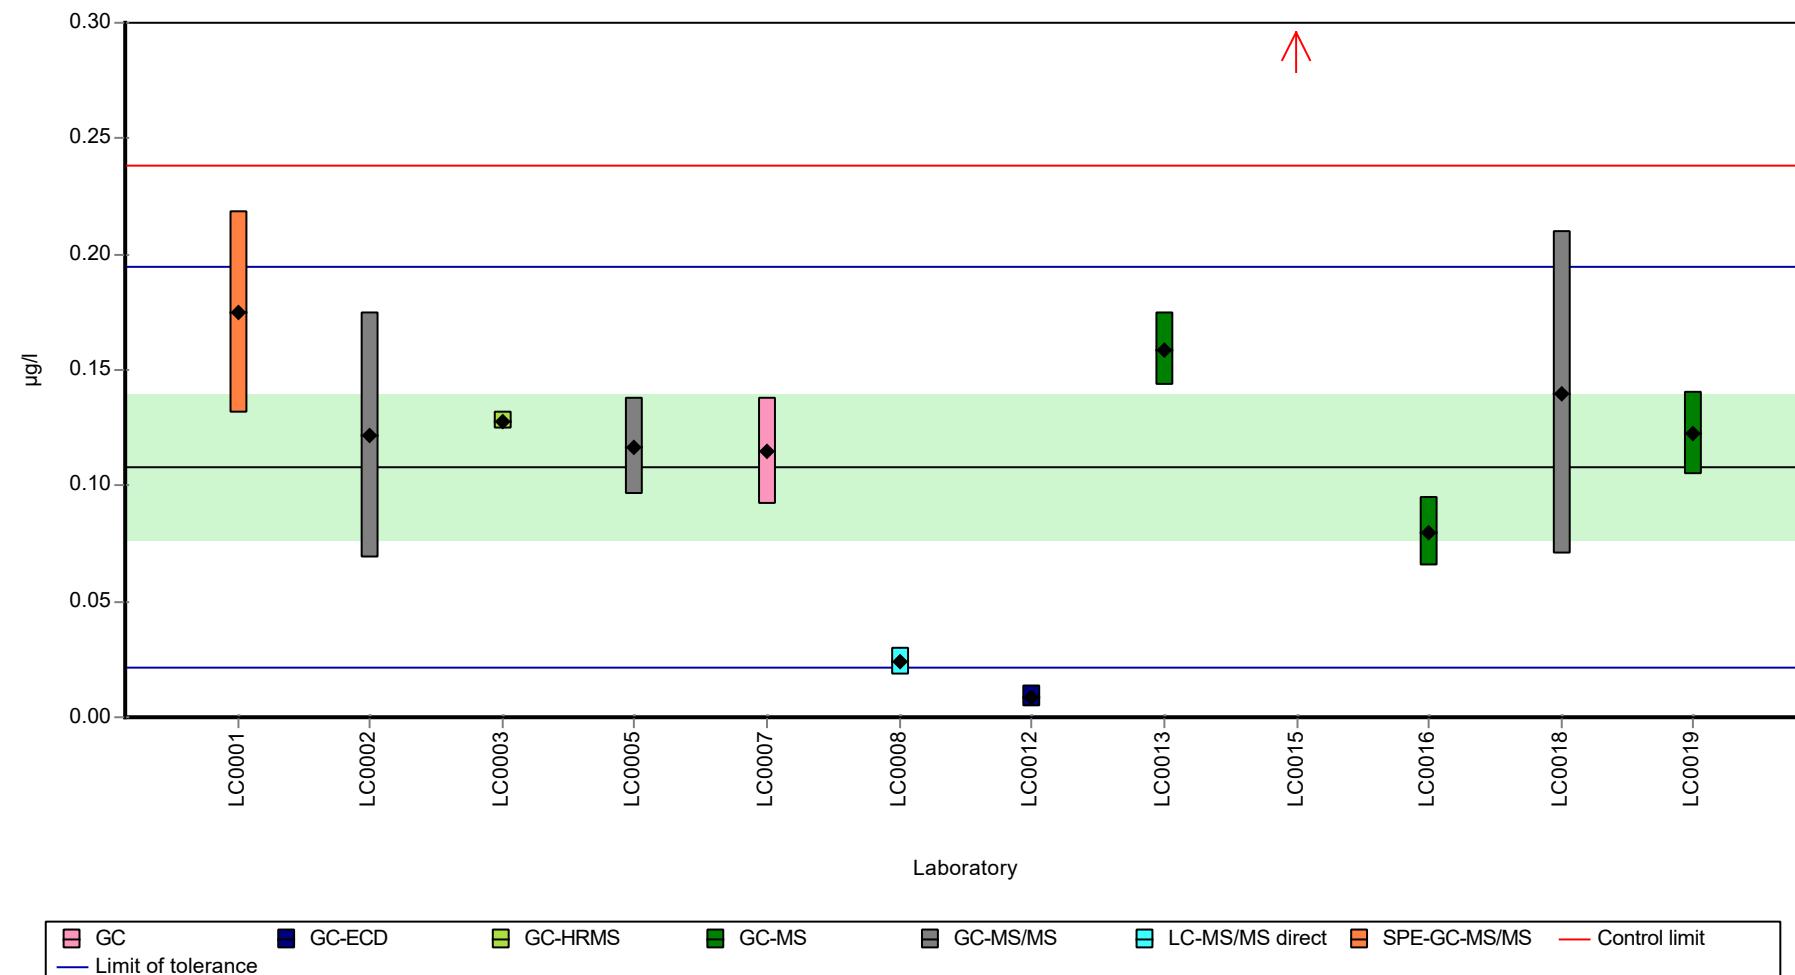


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Heptachlor

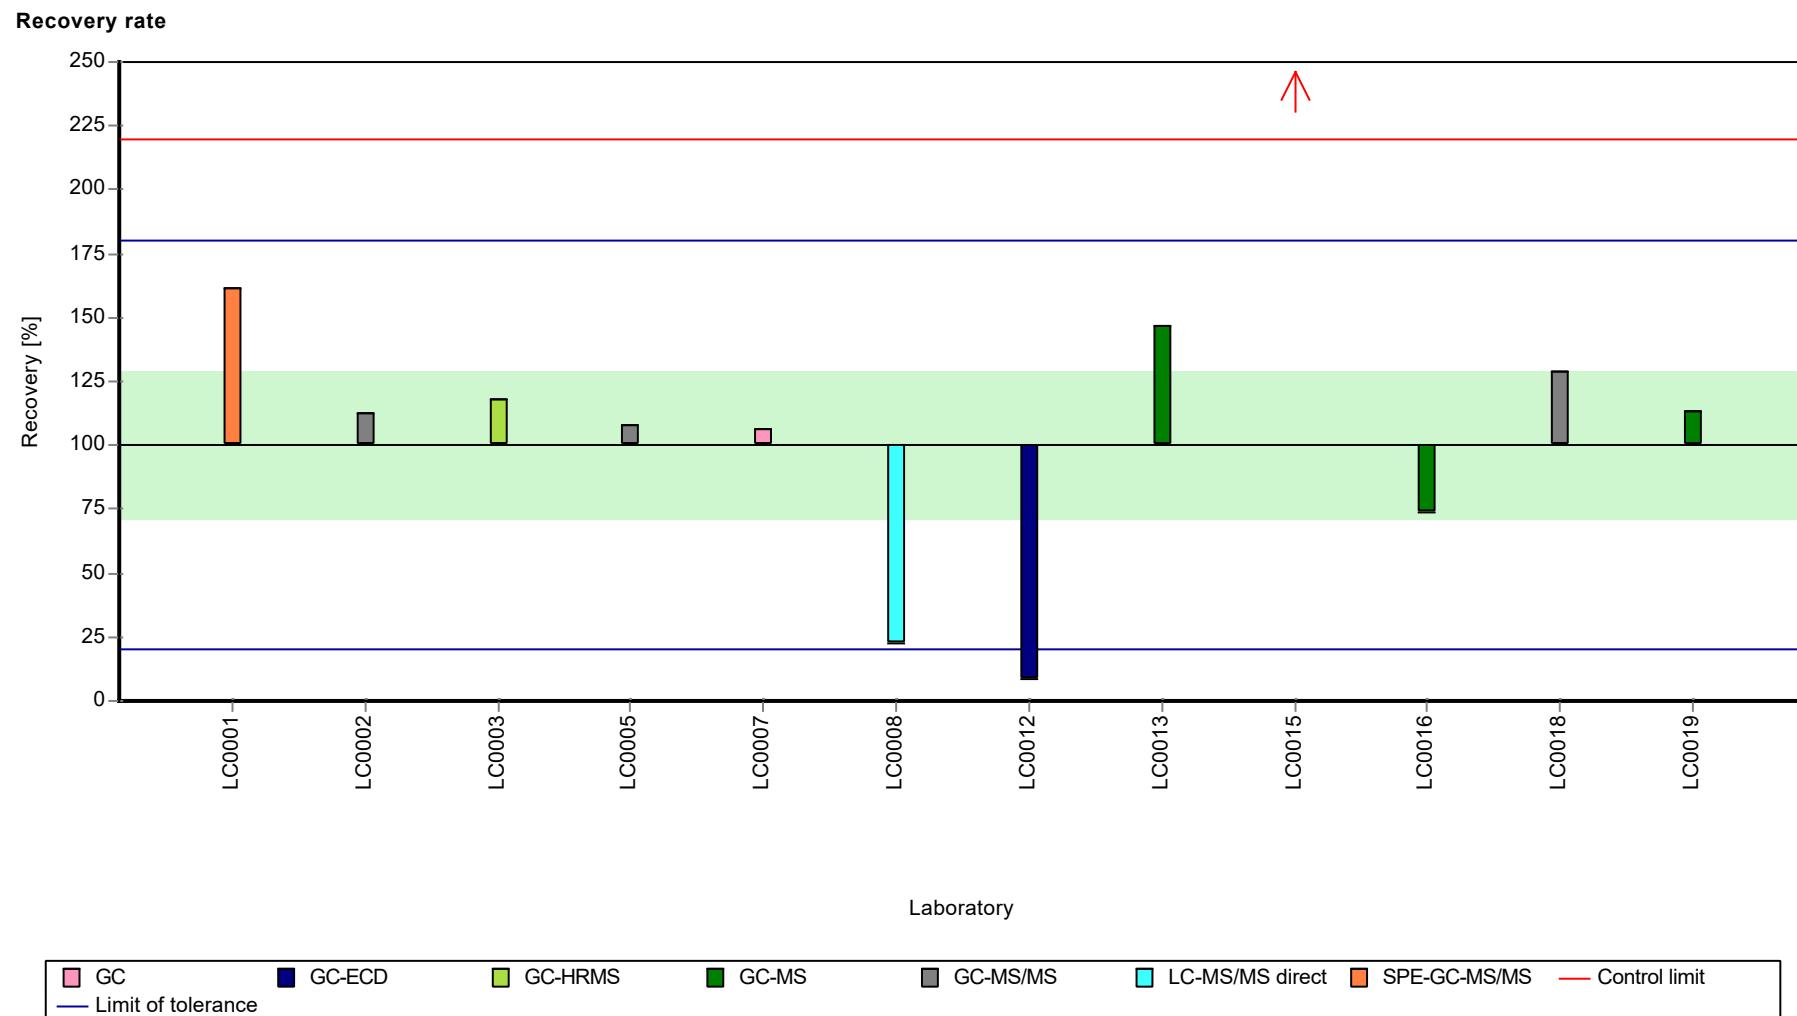

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Heptachlor

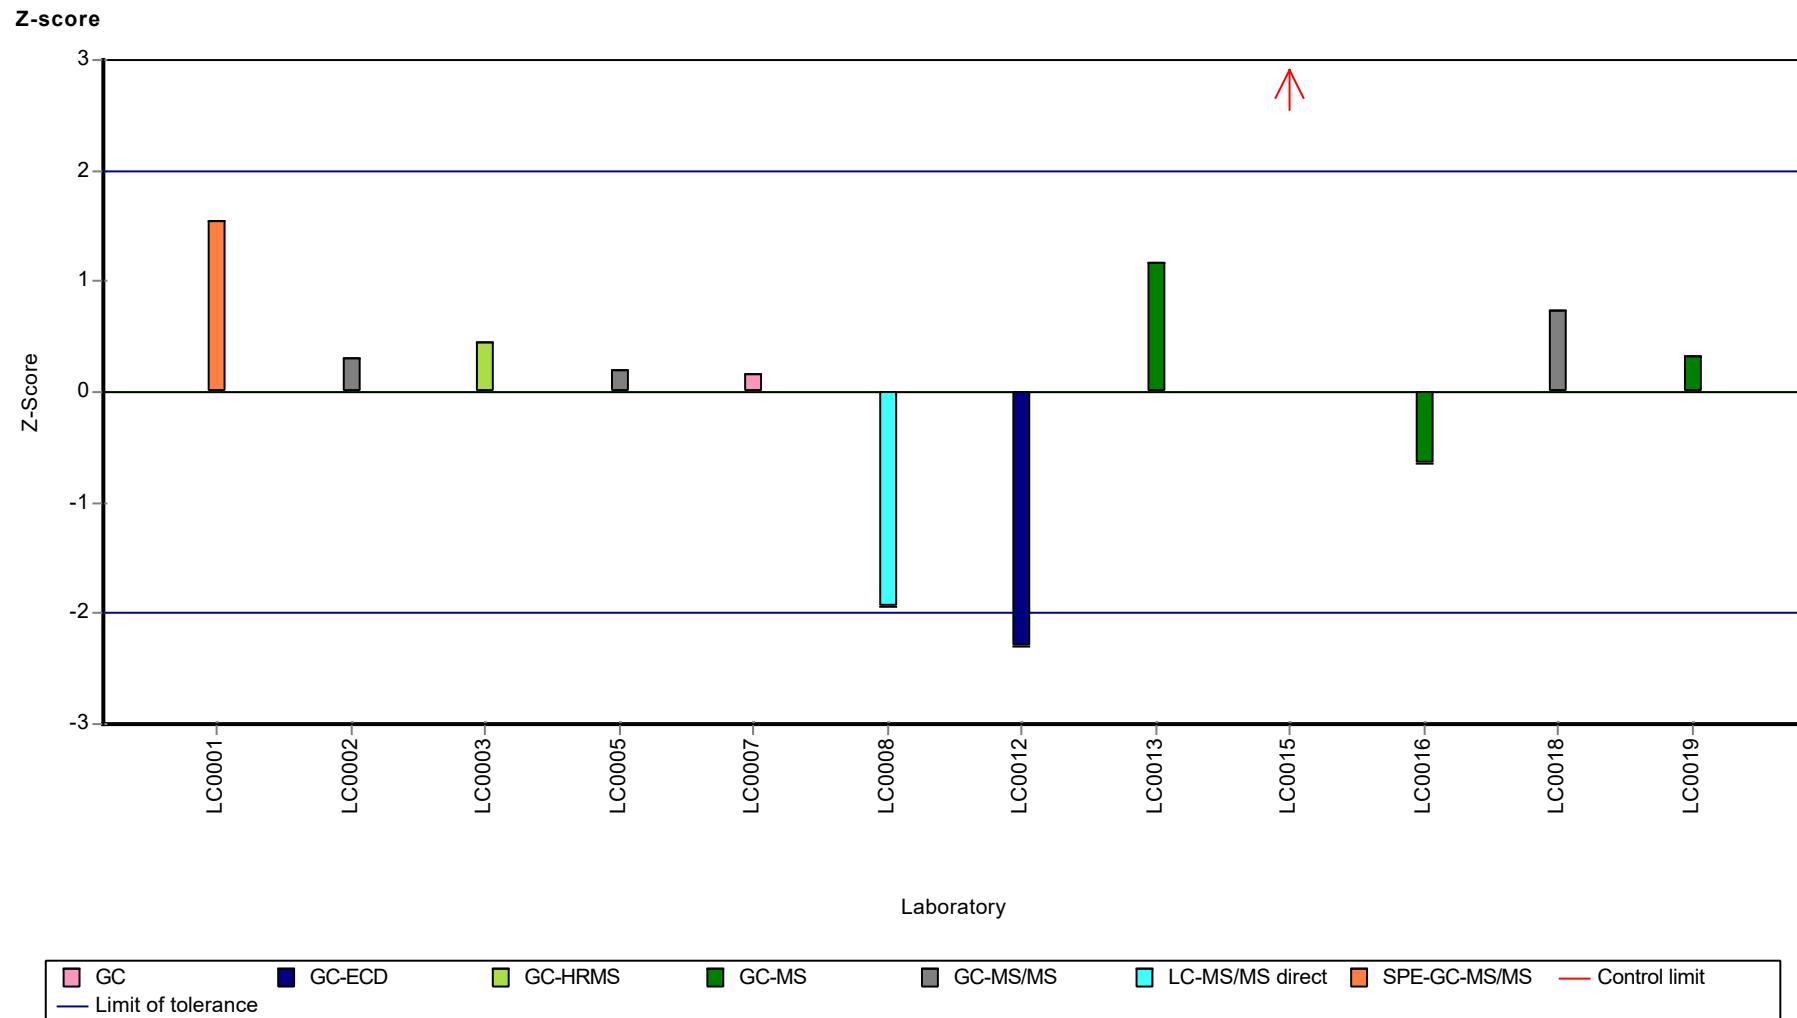

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Heptachlor

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Heptachlor

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.349 ± 0.0655
Criterion	0.14 (40 %)
Minimum - Maximum	0.229 - 0.546
Control test value ± U (k=2)	0.388 ± 0.155

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.17	0.0425	-	-	
LC0002	0.2729	0.1187	78.2	-0.55	
LC0003	0.247	0.00742	70.8	-0.73	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.339	0.061	97.1	-0.07	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.322	0.065	92.2	-0.19	
LC0008	0.026	0.007	7.5	-2.31	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.042	0.021	12	-2.2	H
LC0013	0.403	0.036	115	0.39	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.546	0.082	156	1.41	
LC0016	0.229	0.042	65.6	-0.86	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.405	0.203	116	0.4	
LC0019	0.3777	0.057	108	0.21	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.292 ± 0.14	0.349 ± 0.0982	µg/l
Minimum	0.026	0.229	µg/l
Maximum	0.546	0.546	µg/l
Standard deviation	0.155	0.0982	µg/l
rel. standard deviation	53.1	28.1 %	
n	11	9	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Heptachlor


### Graphical presentation of results

#### Results

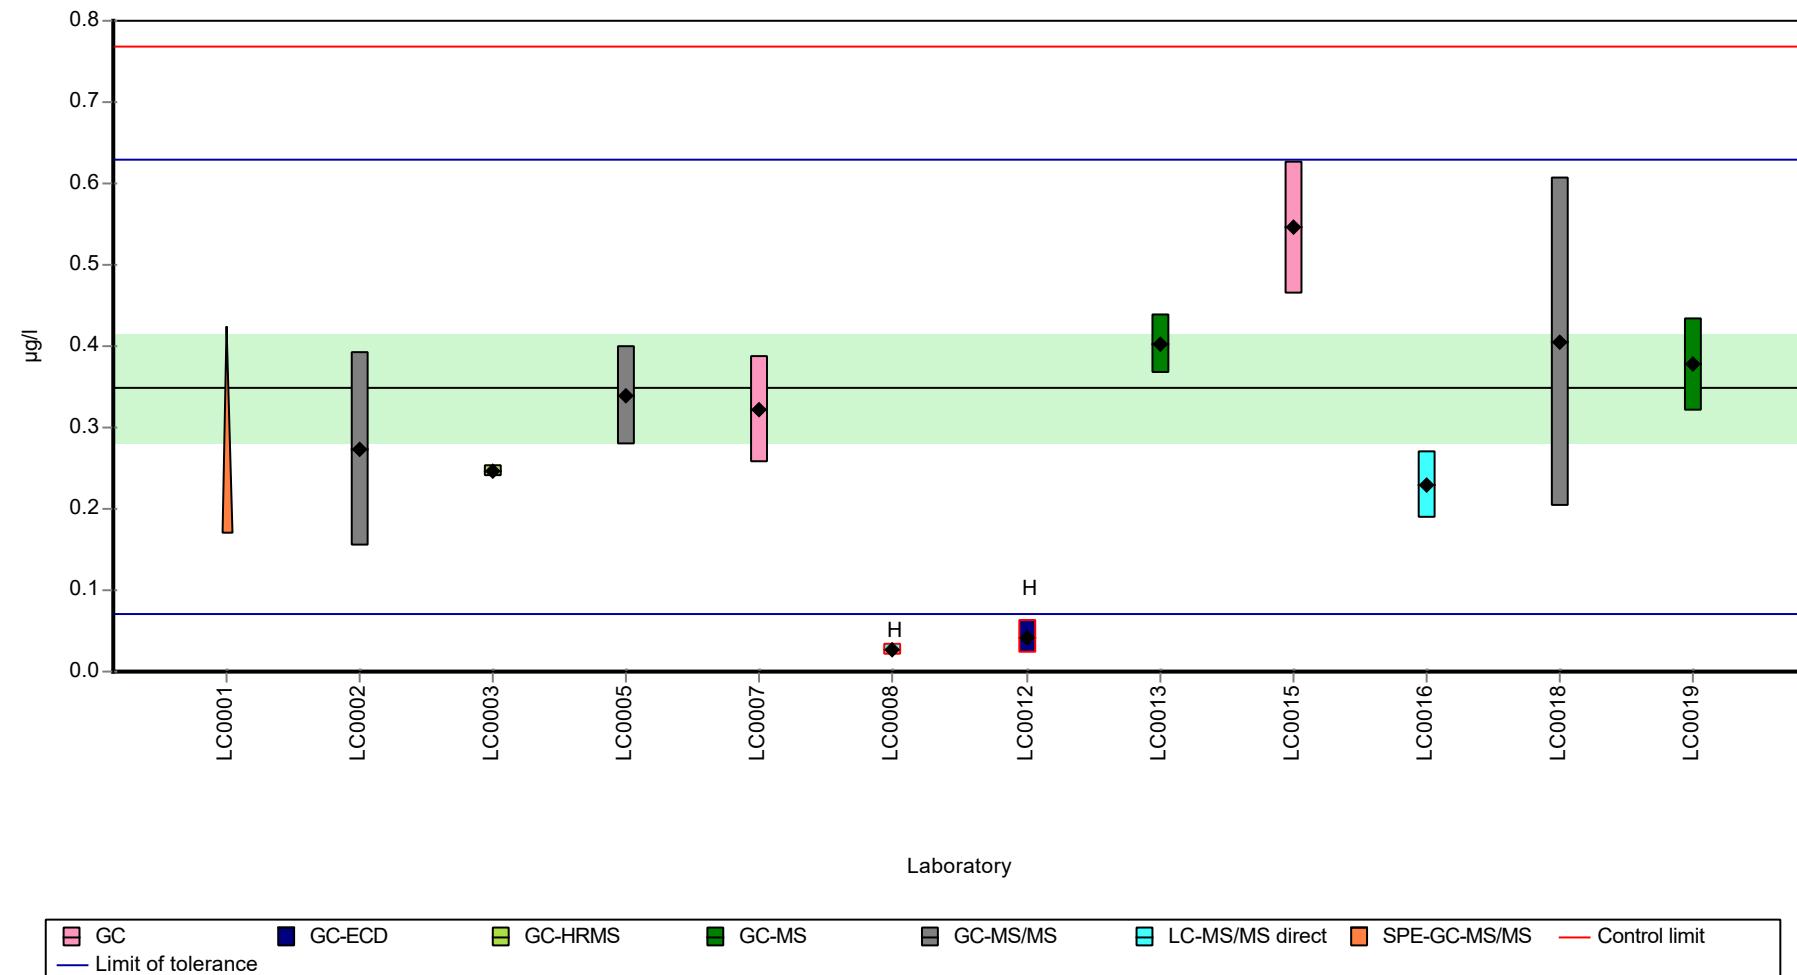


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Heptachlor

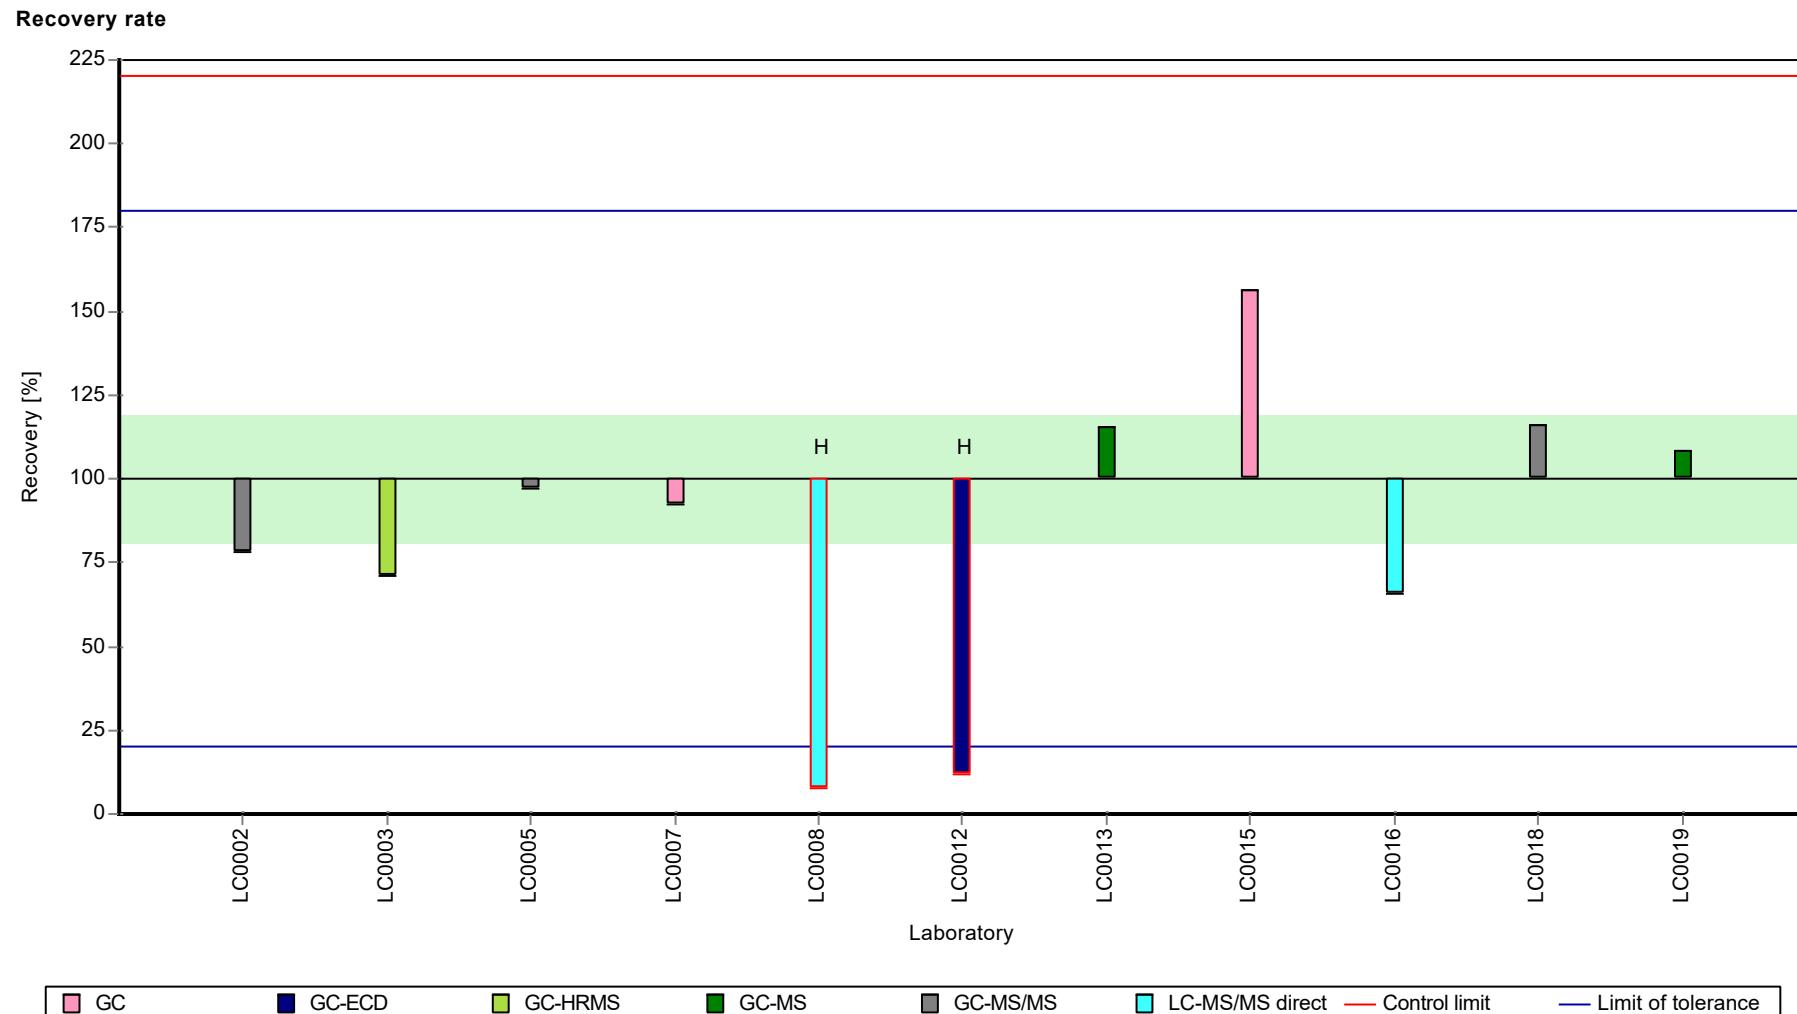

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Heptachlor

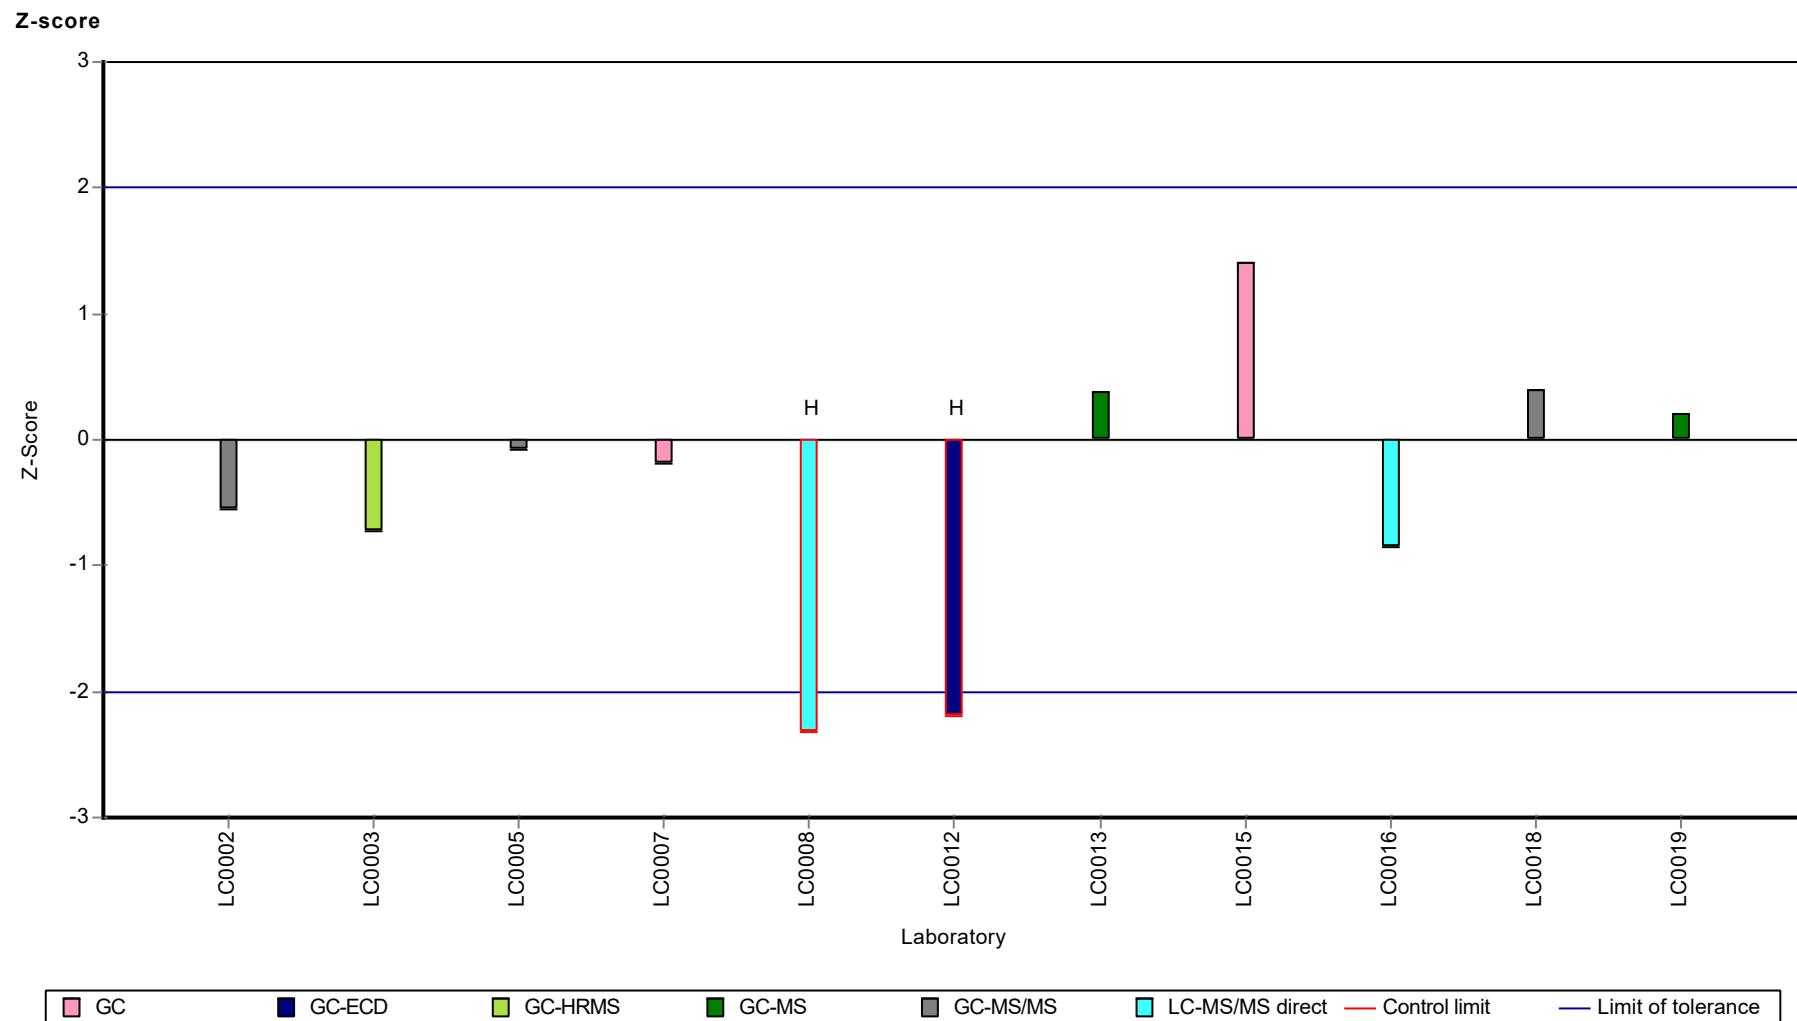

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Imidacloprid

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Imidacloprid

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.419 ± 0.0225
Criterion	0.0628 (15 %)
Minimum - Maximum	0.371 - 0.477
Control test value ± U (k=2)	0.3520 ± 0.0879

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	0.3808	0.0952	90.9	-0.61	
LC0002	0.3707	0.0924	88.5	-0.77	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	0.395	0.119	94.3	-0.38	
LC0005	0.464	0.0836	111	0.72	
LC0006	0.39	0.01	93.1	-0.46	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	0.394	0.099	94.1	-0.4	
LC0009	0.396	0.079	94.5	-0.36	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	0.477	0.18	114	0.93	
LC0012	0.1121	0.0561	26.8	-4.88	H
LC0013	0.461	0.005	110	0.67	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.395	0.059	94.3	-0.38	
LC0016	0.468	0.107	112	0.78	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.435	0.218	104	0.26	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.395 ± 0.0773	0.419 ± 0.0338	µg/l
Minimum	0.112	0.371	µg/l
Maximum	0.477	0.477	µg/l
Standard deviation	0.0929	0.039	µg/l
rel. standard deviation	23.5	9.32 %	
n	13	12	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Imidacloprid


#### Graphical presentation of results

##### Results

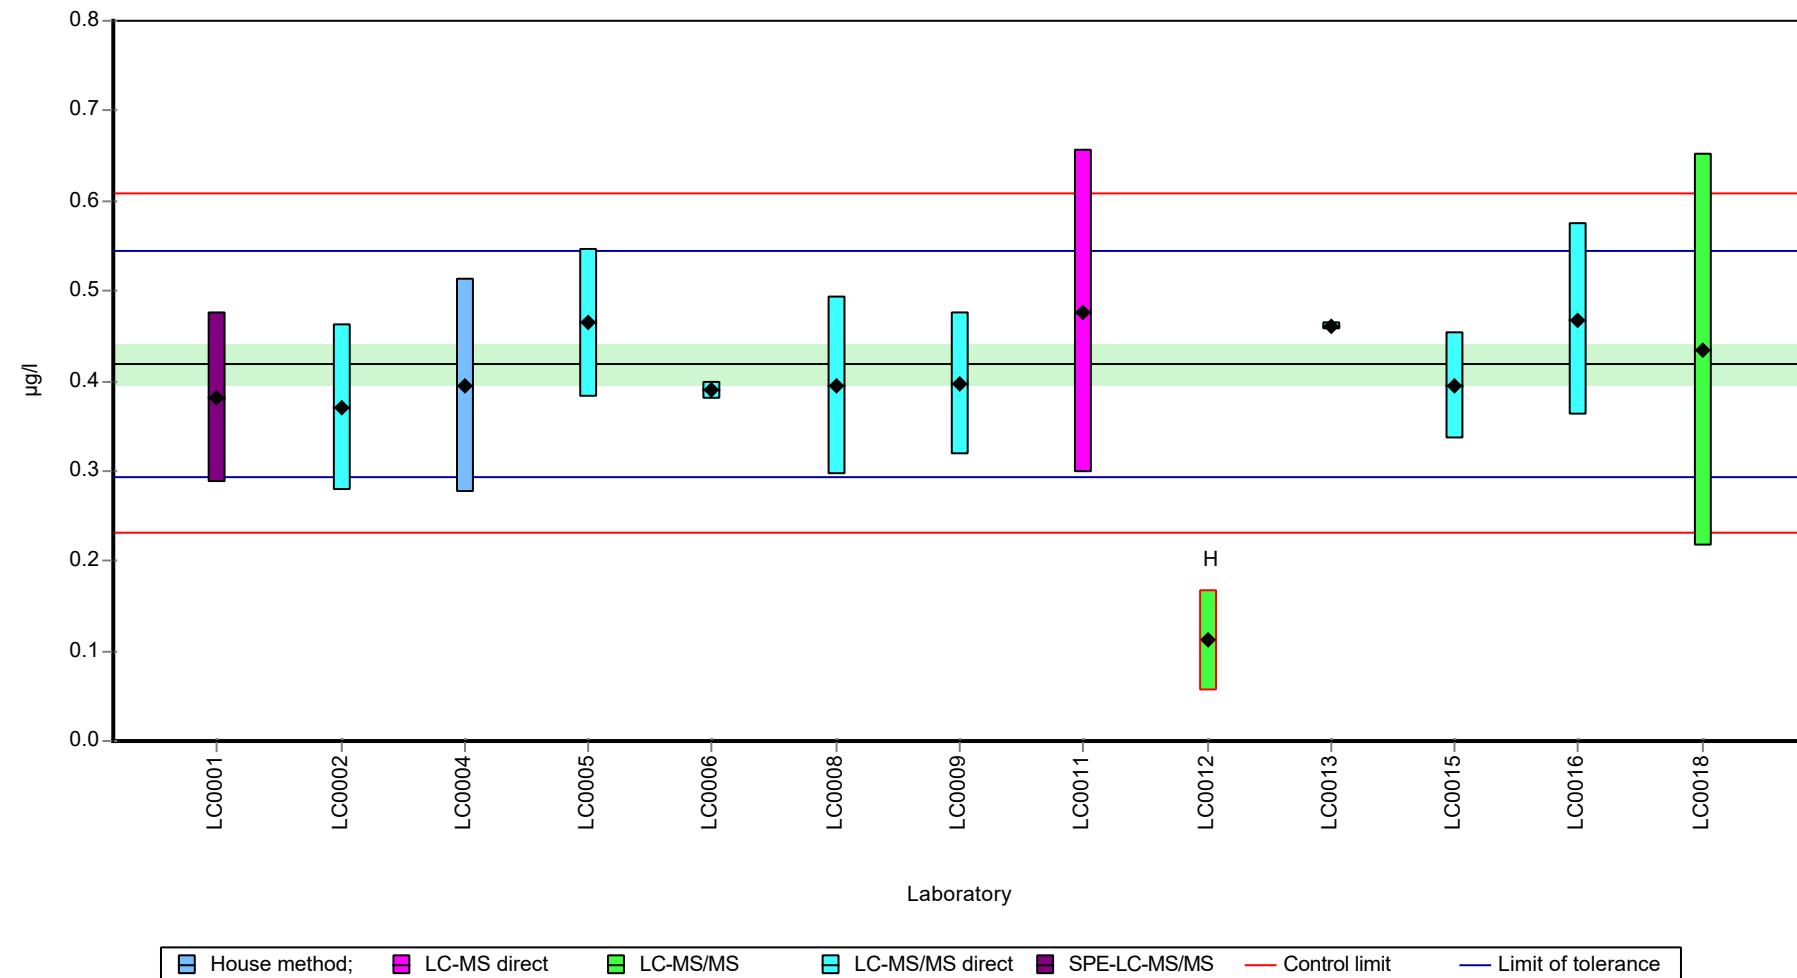


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Imidacloprid

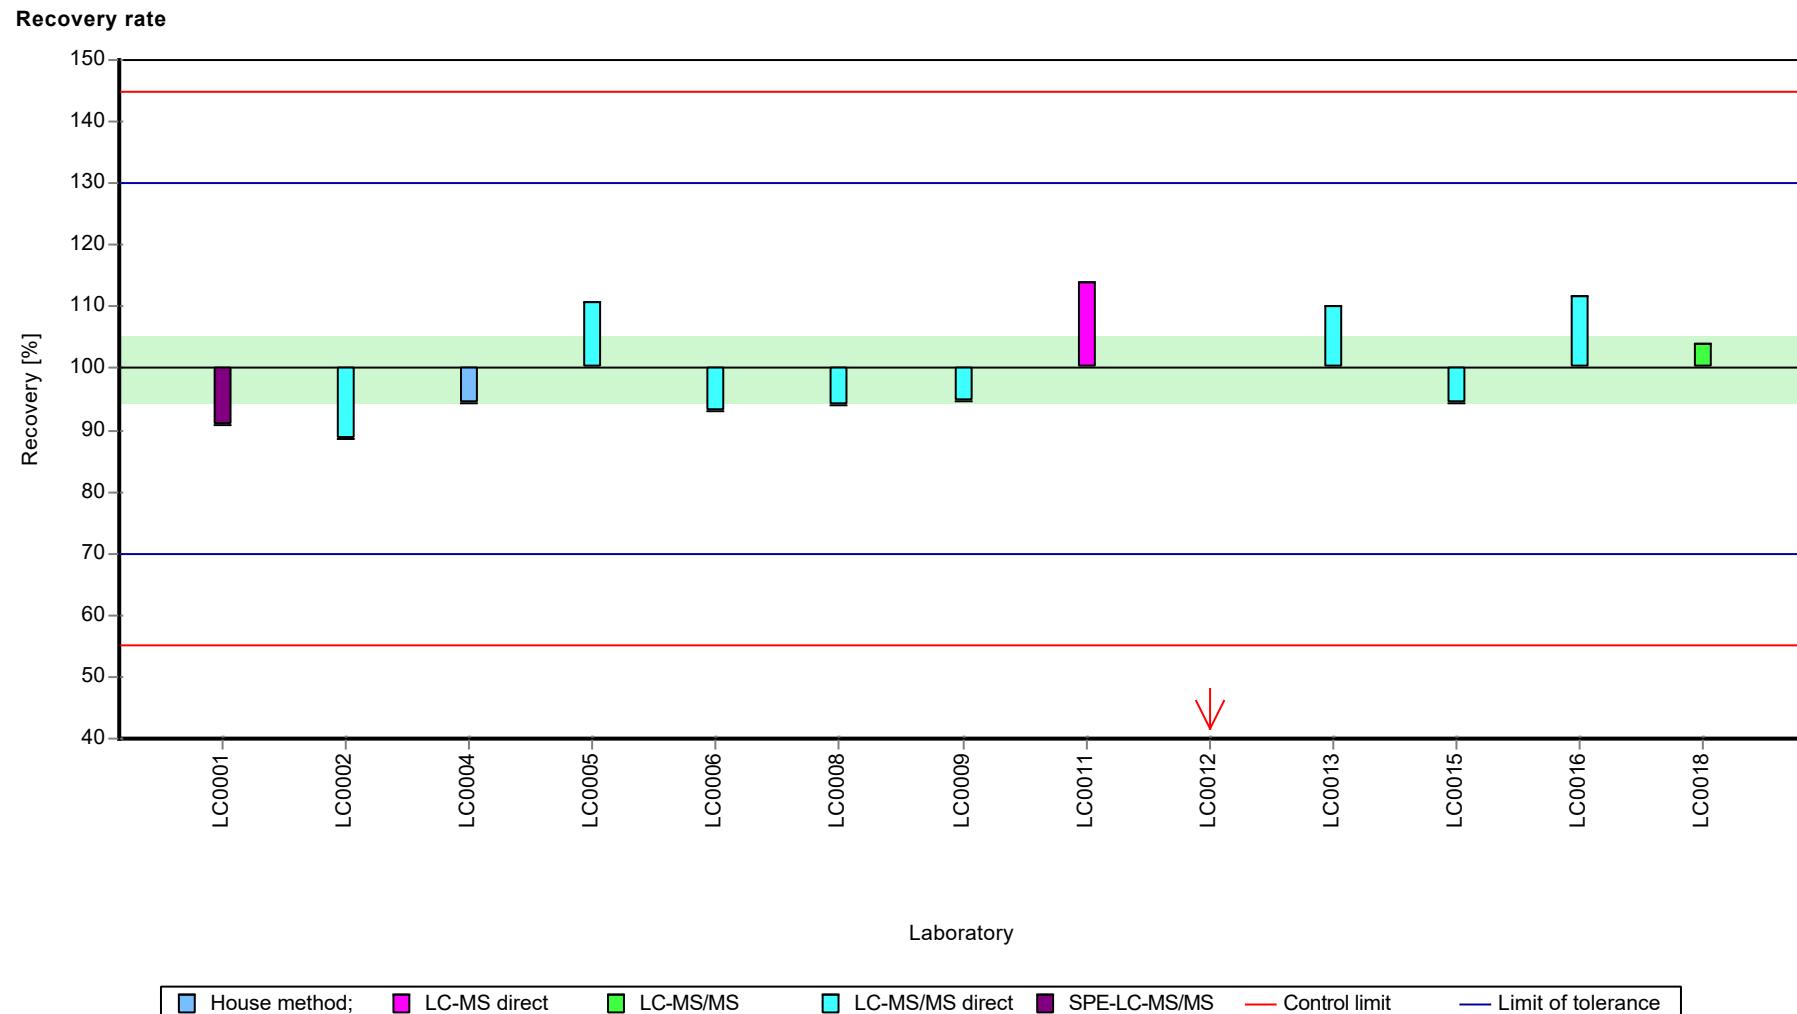

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Imidacloprid

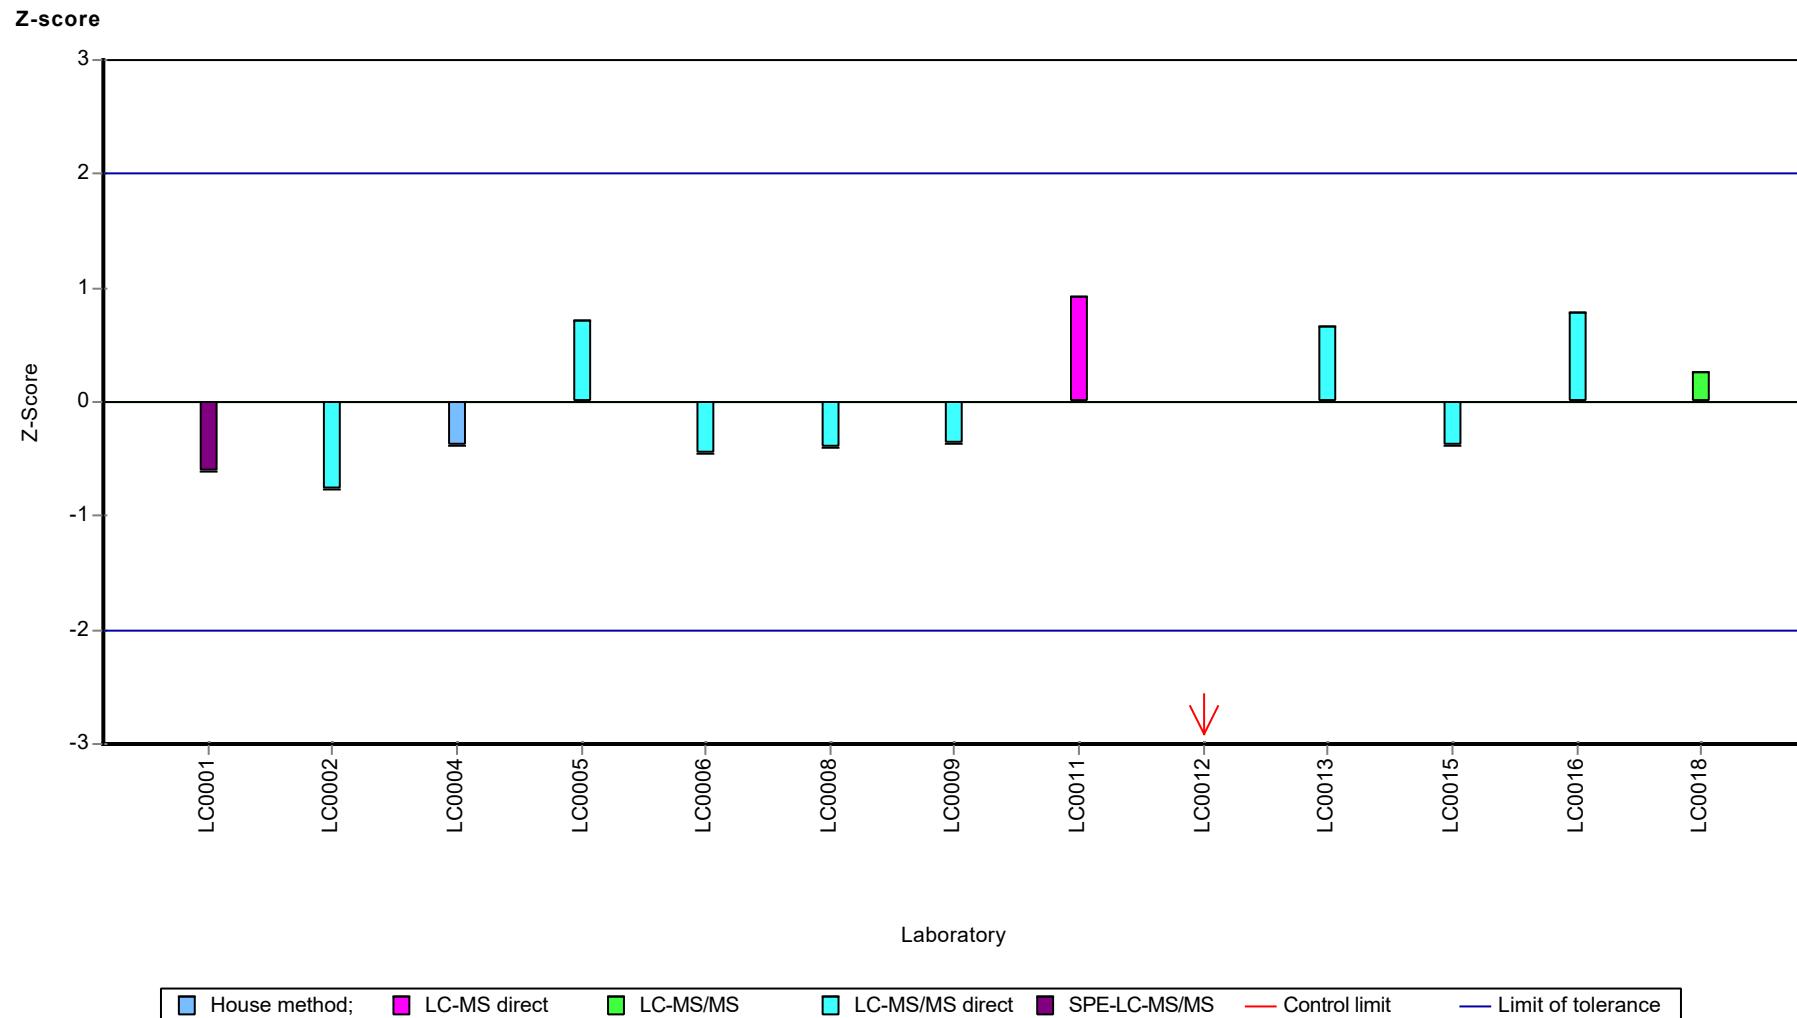

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Imidacloprid

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Imidacloprid

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	2.18 ± 0.116
Criterion	0.327 (15 %)
Minimum - Maximum	1.97 - 2.5
Control test value ± U (k=2)	1.870 ± 0.468

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.40	0.1	-	-	
LC0002	1.9967	0.4976	91.7	-0.55	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	2.19	0.66	101	0.04	
LC0005	2.43	0.437	112	0.78	
LC0006	1.97	0.05	90.5	-0.63	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	2.068	0.517	95	-0.33	
LC0009	2.275	0.455	105	0.3	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	1.985	0.6	91.2	-0.59	
LC0012	0.5542	0.2771	25.5	-4.97	H
LC0013	2.26	0.031	104	0.26	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	1.969	0.295	90.5	-0.64	
LC0016	2.3	0.52	106	0.38	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	2.5	1.25	115	0.99	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	2.04 ± 0.435	2.18 ± 0.173	µg/l
Minimum	0.554	1.97	µg/l
Maximum	2.5	2.5	µg/l
Standard deviation	0.503	0.192	µg/l
rel. standard deviation	24.6	8.81	%
n	12	11	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Imidacloprid


#### Graphical presentation of results

##### Results

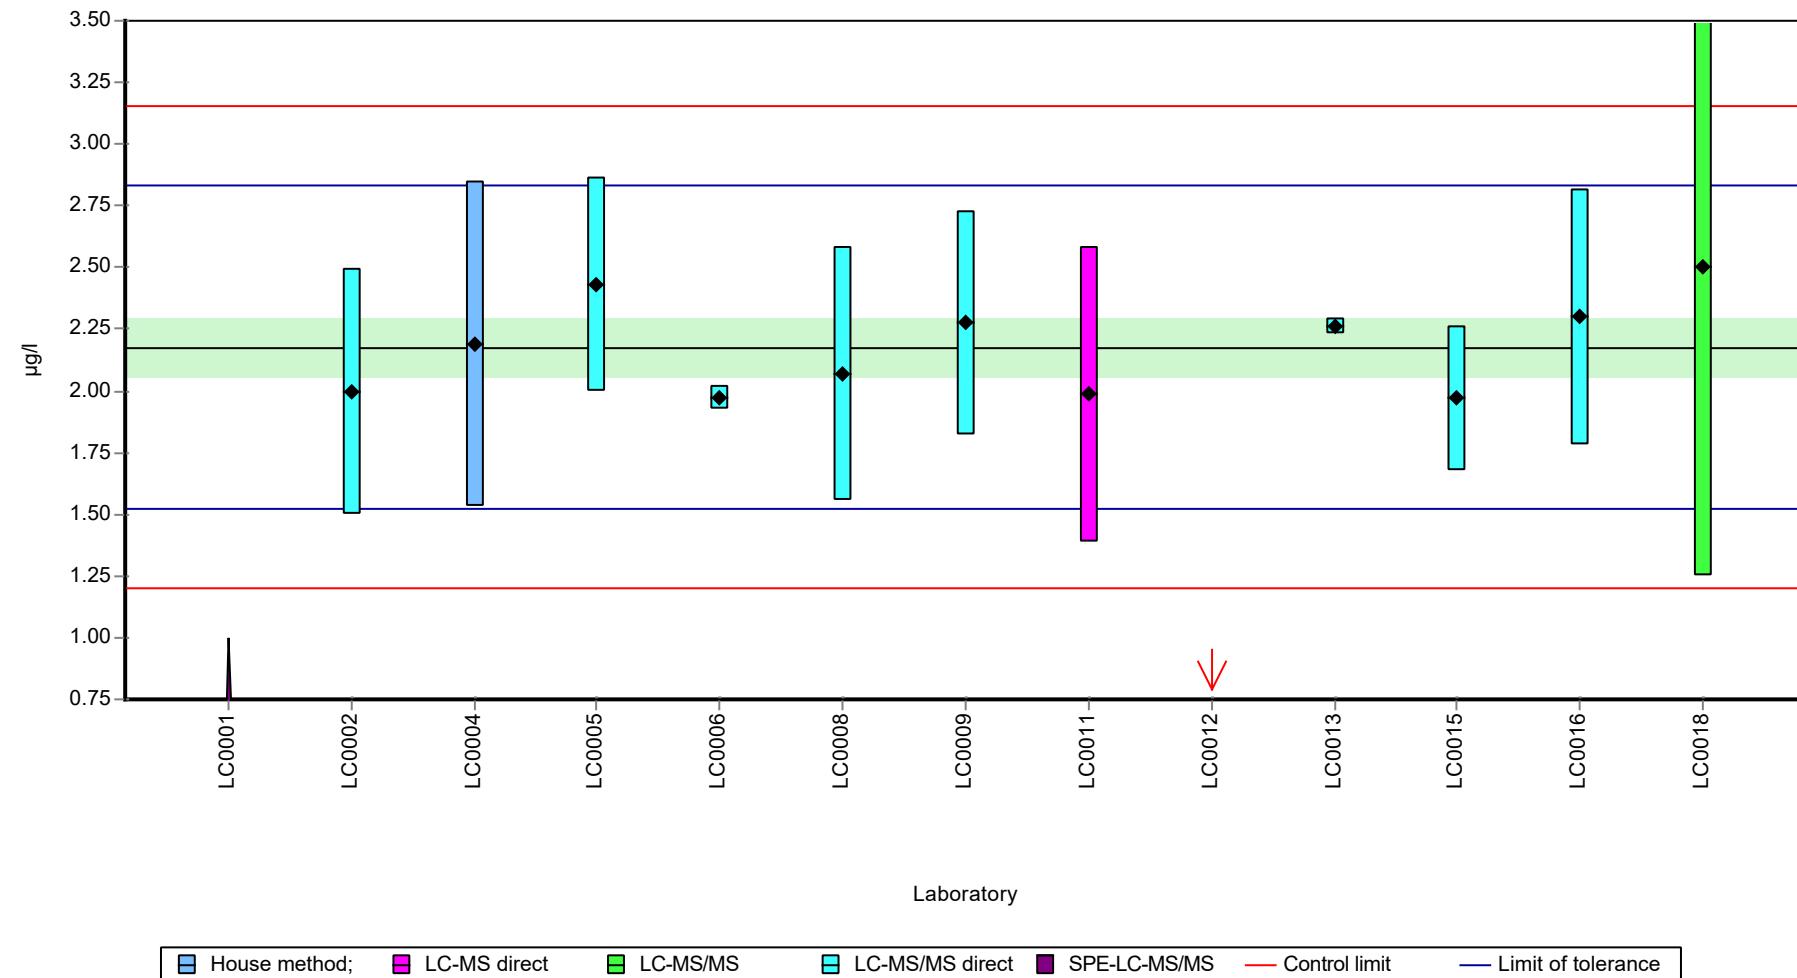


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Imidacloprid

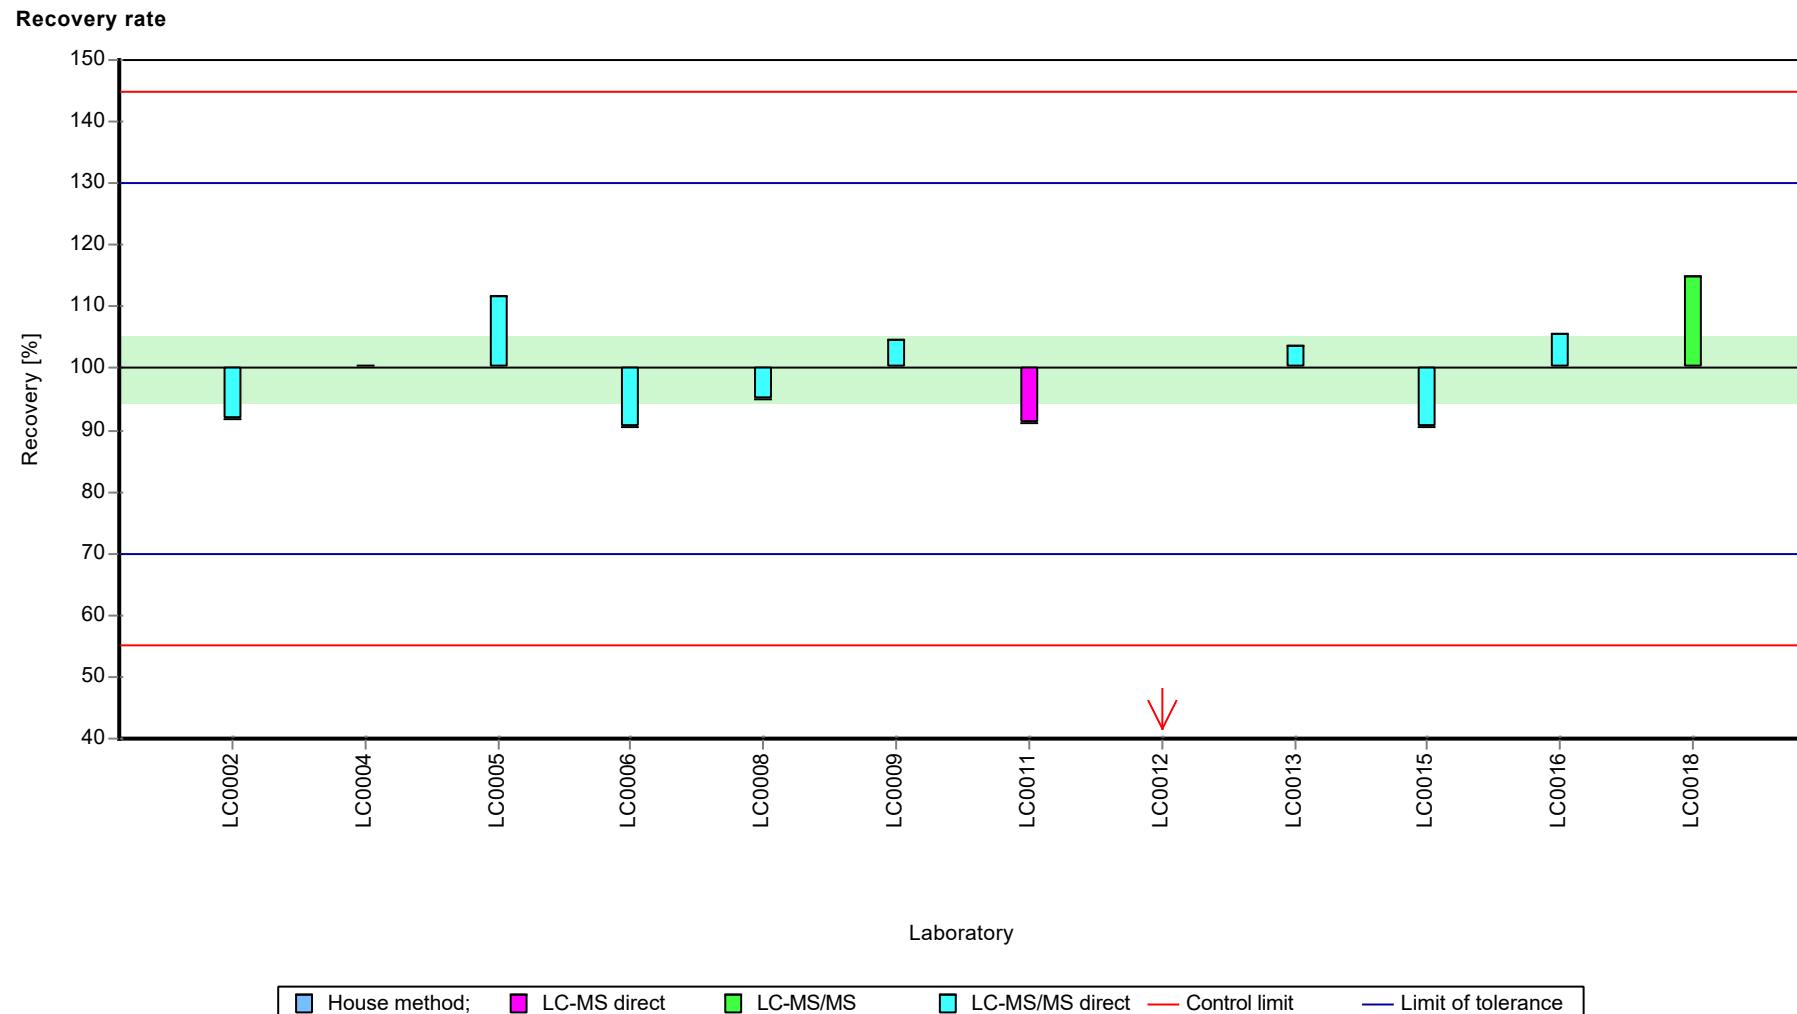

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Imidacloprid

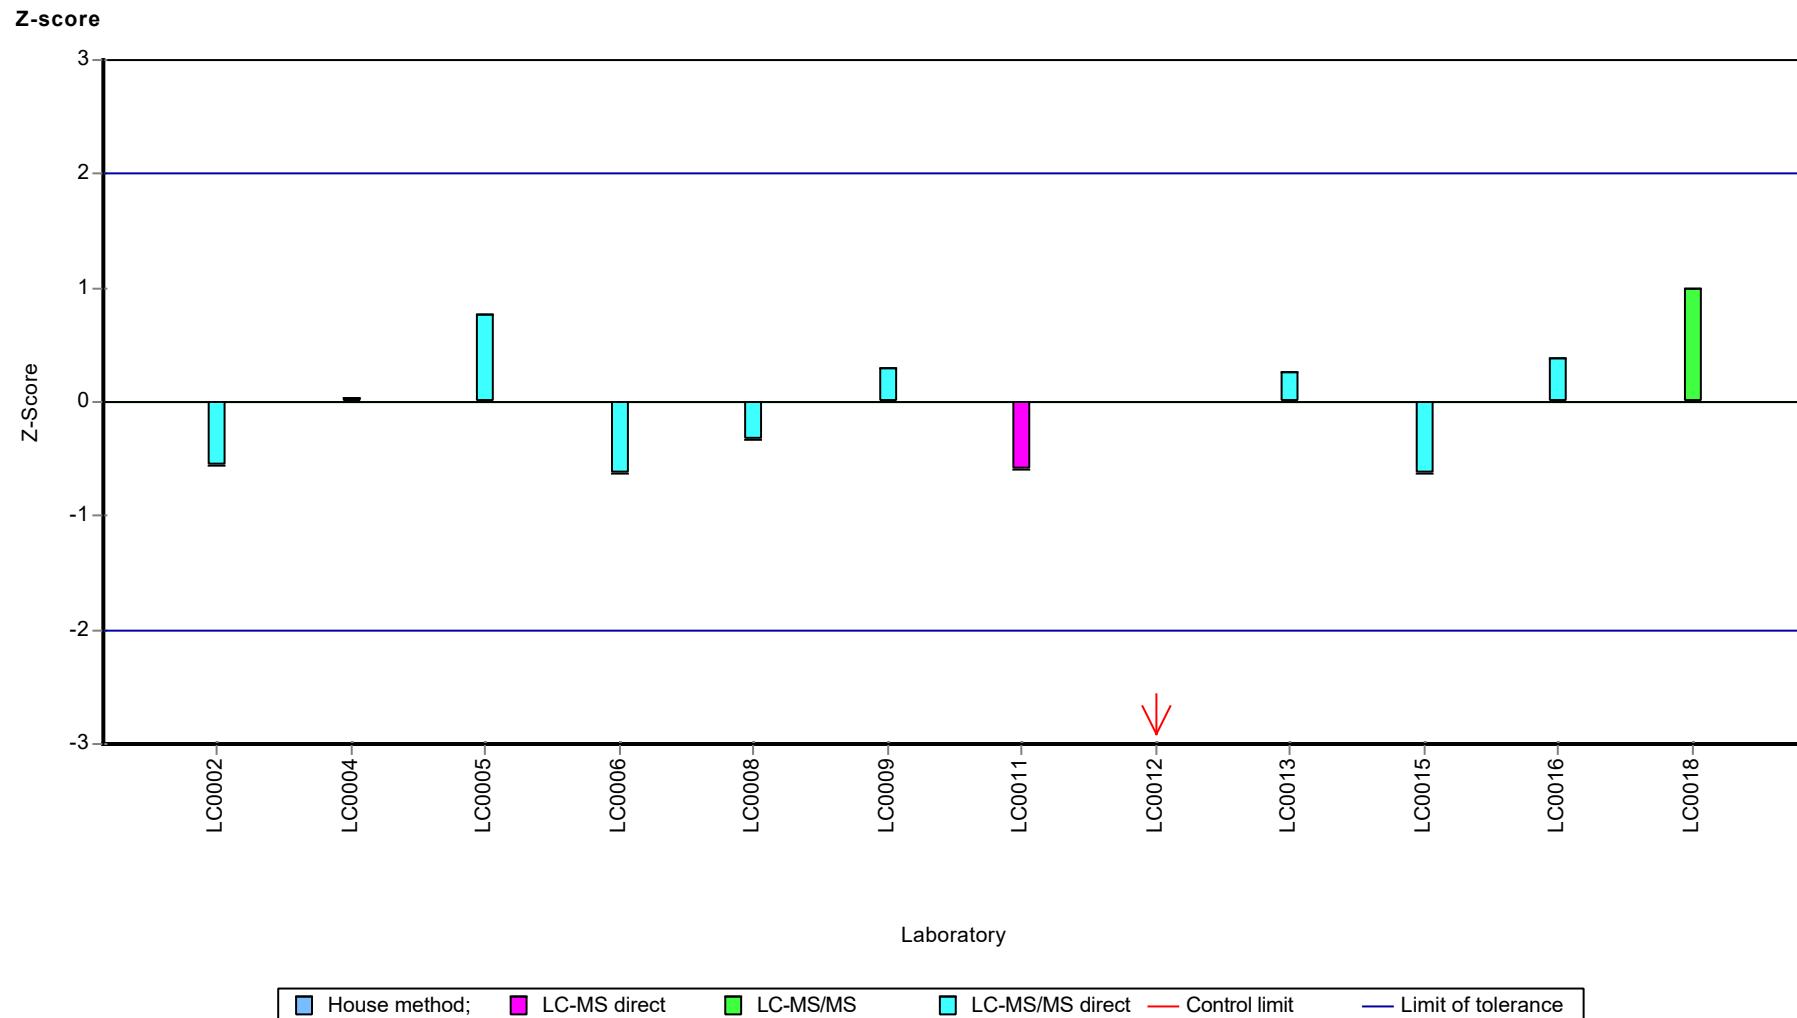

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Lindane (Gamma-HCH)

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Lindane (Gamma-HCH)

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.135 ± 0.00809
Criterion	0.0269 (20 %)
Minimum - Maximum	0.112 - 0.151
Control test value ± U (k=2)	0.1510 ± 0.0453

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	0.1325	0.0331	98.4	-0.08	
LC0002	0.1442	0.0371	107	0.35	
LC0003	0.127	0.00382	94.3	-0.29	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.151	0.027	112	0.61	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.134	0.027	99.5	-0.03	
LC0008	0.112	0.028	83.2	-0.84	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	< 0.01 (LOQ)	-	-	-	FN
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	0.061	0.031	45.3	-2.74	H
LC0015	0.193	0.029	143	2.17	H
LC0016	0.146	0.013	108	0.42	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.14	0.07	104	0.2	
LC0019	0.1254	0.019	93.1	-0.34	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.133 ± 0.0286	0.135 ± 0.0121	µg/l
Minimum	0.061	0.112	µg/l
Maximum	0.193	0.151	µg/l
Standard deviation	0.0316	0.0121	µg/l
rel. standard deviation	23.7	9.01	%
n	11	9	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Lindane (Gamma-HCH)


#### Graphical presentation of results

##### Results

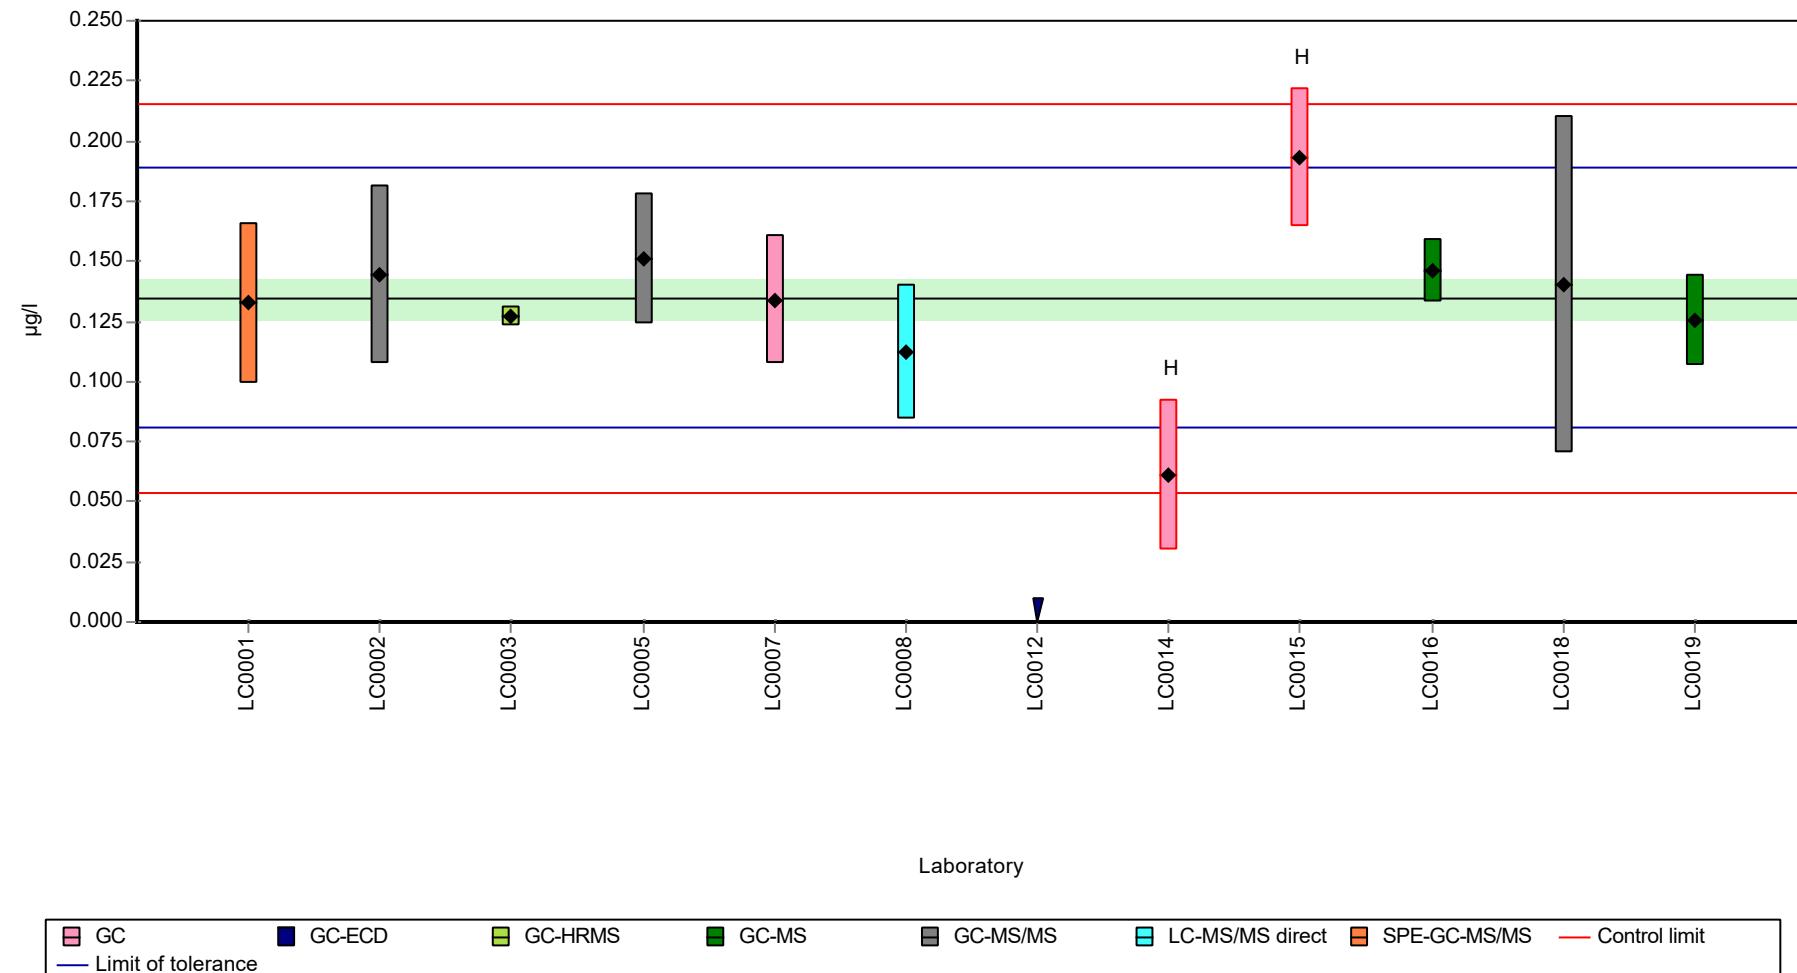


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Lindane (Gamma-HCH)

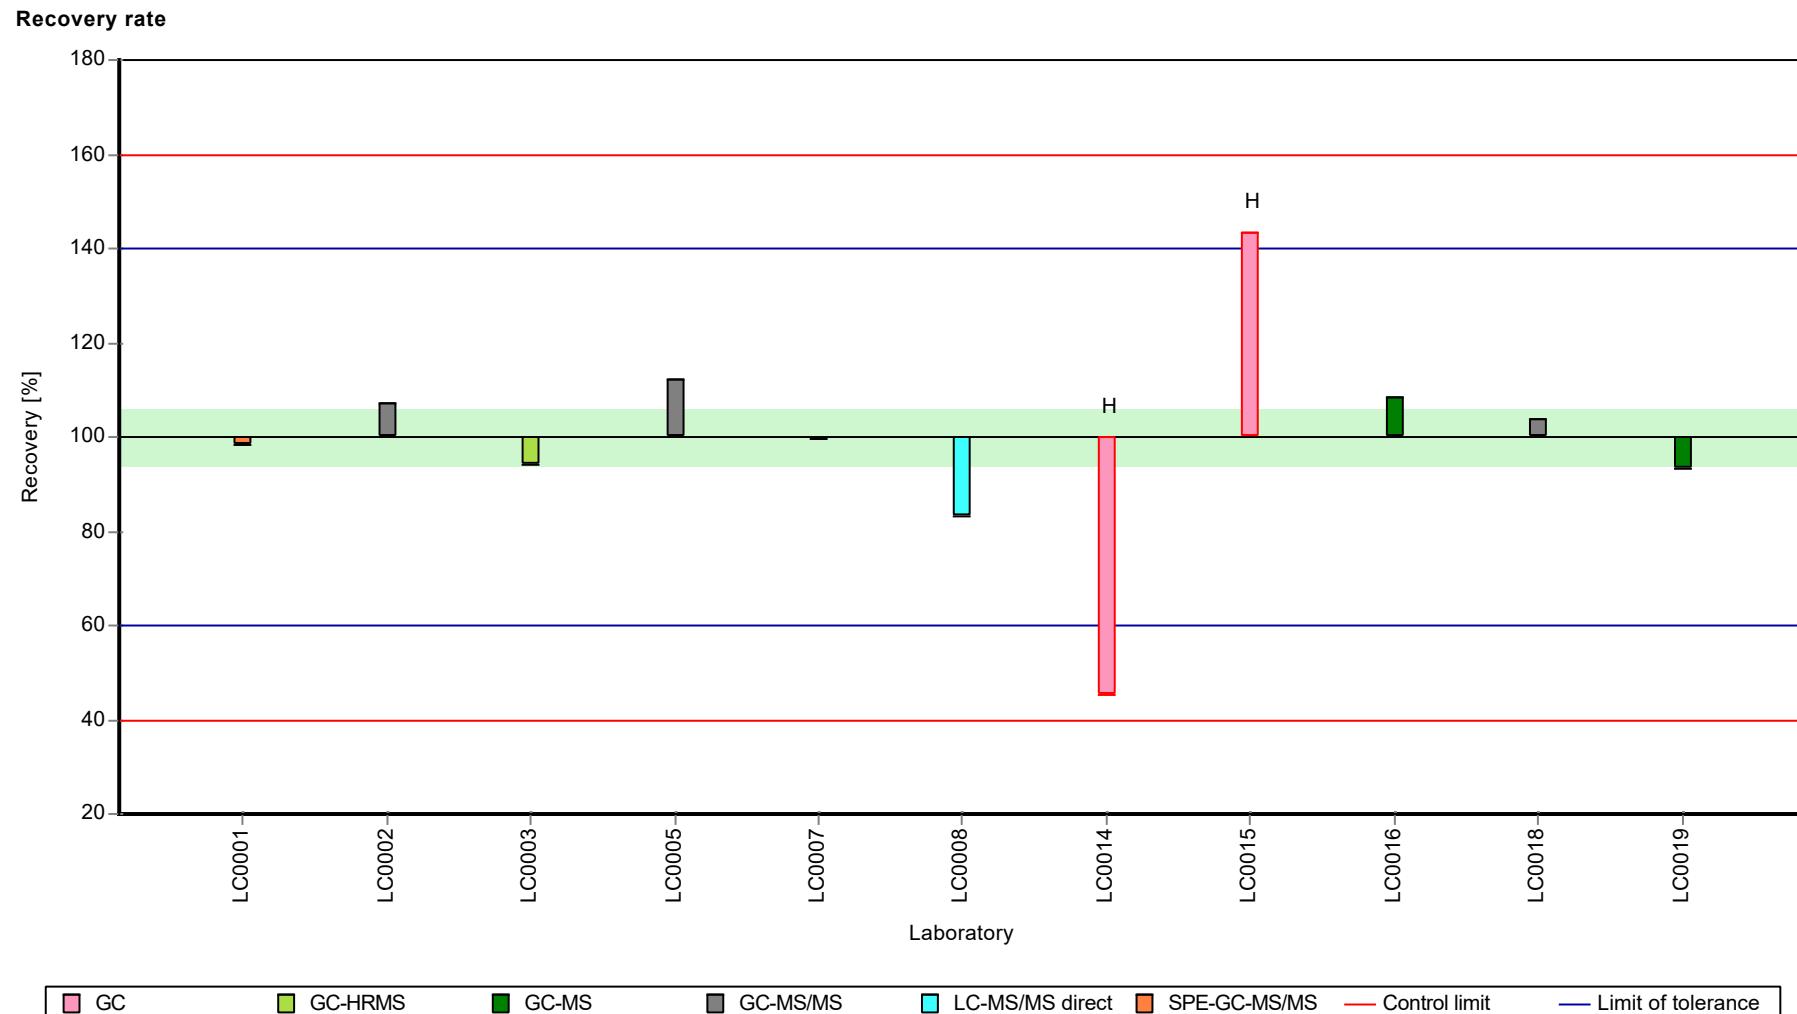

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Lindane (Gamma-HCH)

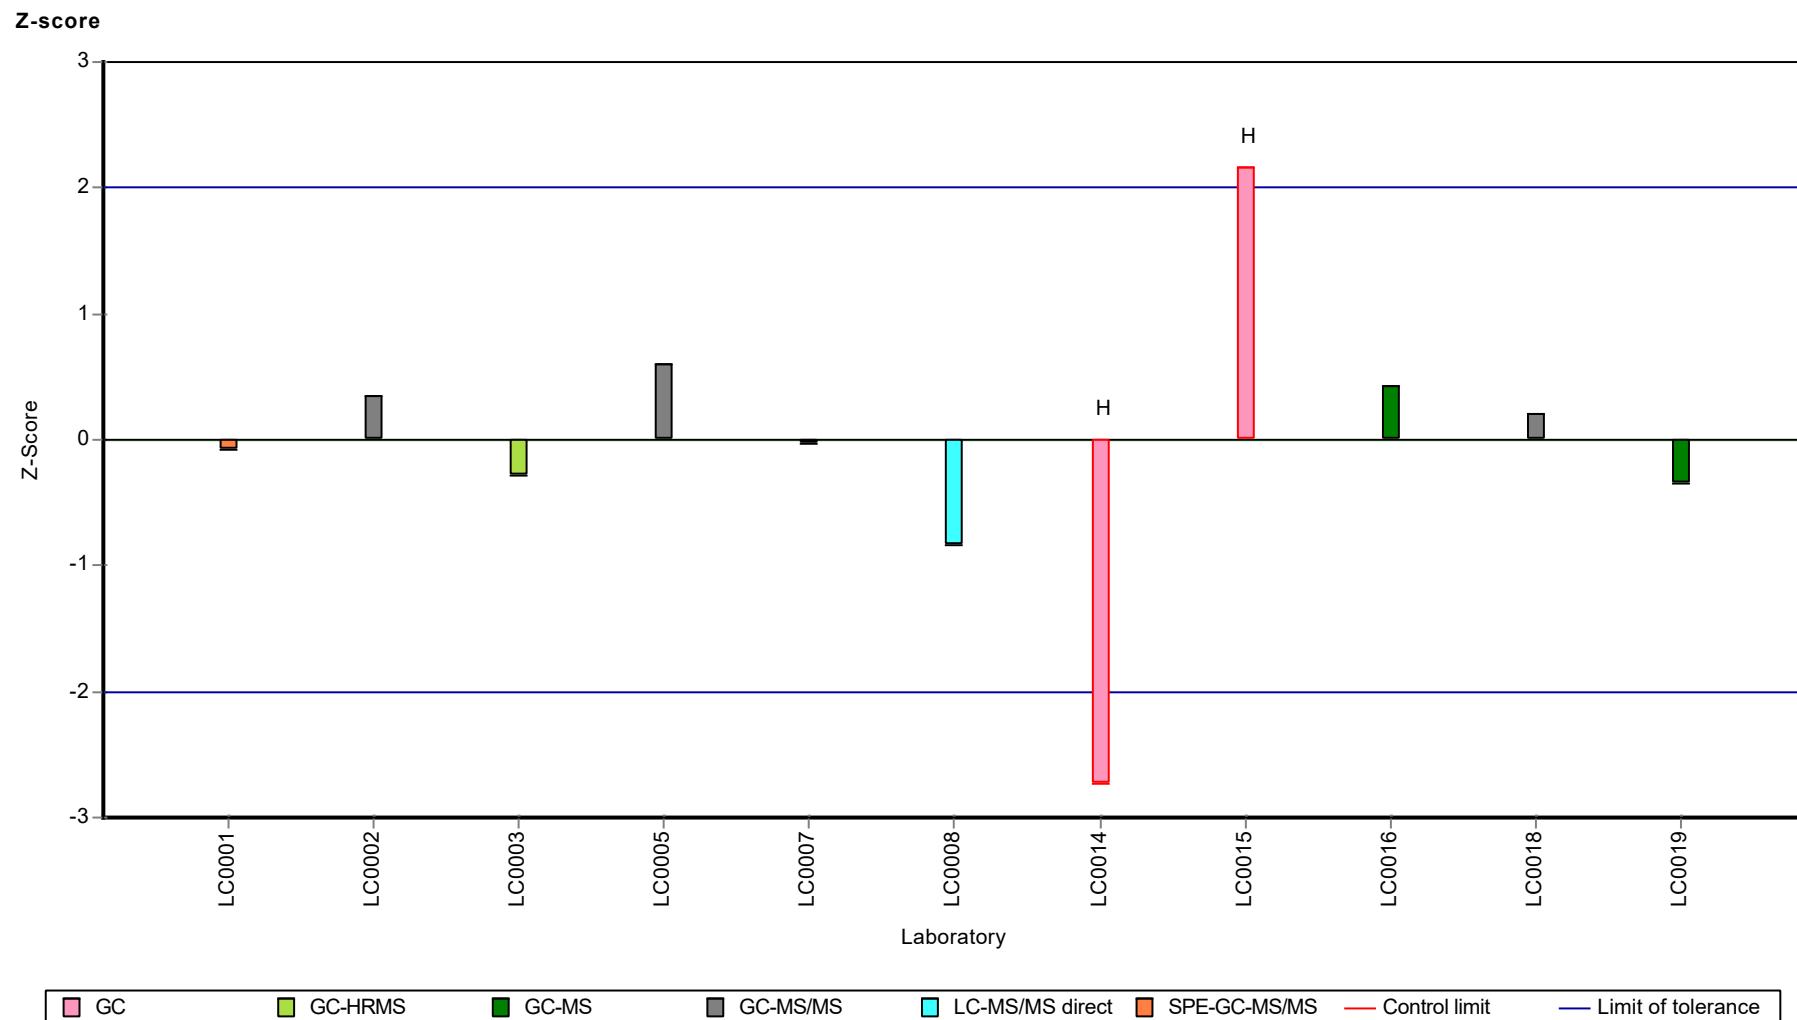

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Lindane (Gamma-HCH)

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Lindane (Gamma-HCH)

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.729 ± 0.0329
Criterion	0.146 (20 %)
Minimum - Maximum	0.636 - 0.81
Control test value ± U (k=2)	0.742 ± 0.223

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.17	0.0425	-	-	
LC0002	0.7596	0.1951	104	0.21	
LC0003	0.432	0.013	59.3	-2.04	H
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.772	0.139	106	0.3	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.723	0.145	99.2	-0.04	
LC0008	0.73	0.183	100	0.01	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.073	0.037	10	-4.5	H
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	0.636	0.337	87.3	-0.64	
LC0015	0.696	0.104	95.5	-0.22	
LC0016	0.715	0.064	98.1	-0.09	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.81	0.405	111	0.56	
LC0019	0.7152	0.107	98.2	-0.09	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.642 ± 0.193	0.729 ± 0.0494	µg/l
Minimum	0.073	0.636	µg/l
Maximum	0.81	0.81	µg/l
Standard deviation	0.213	0.0494	µg/l
rel. standard deviation	33.2	6.78	%
n	11	9	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Lindane (Gamma-HCH)


#### Graphical presentation of results

##### Results

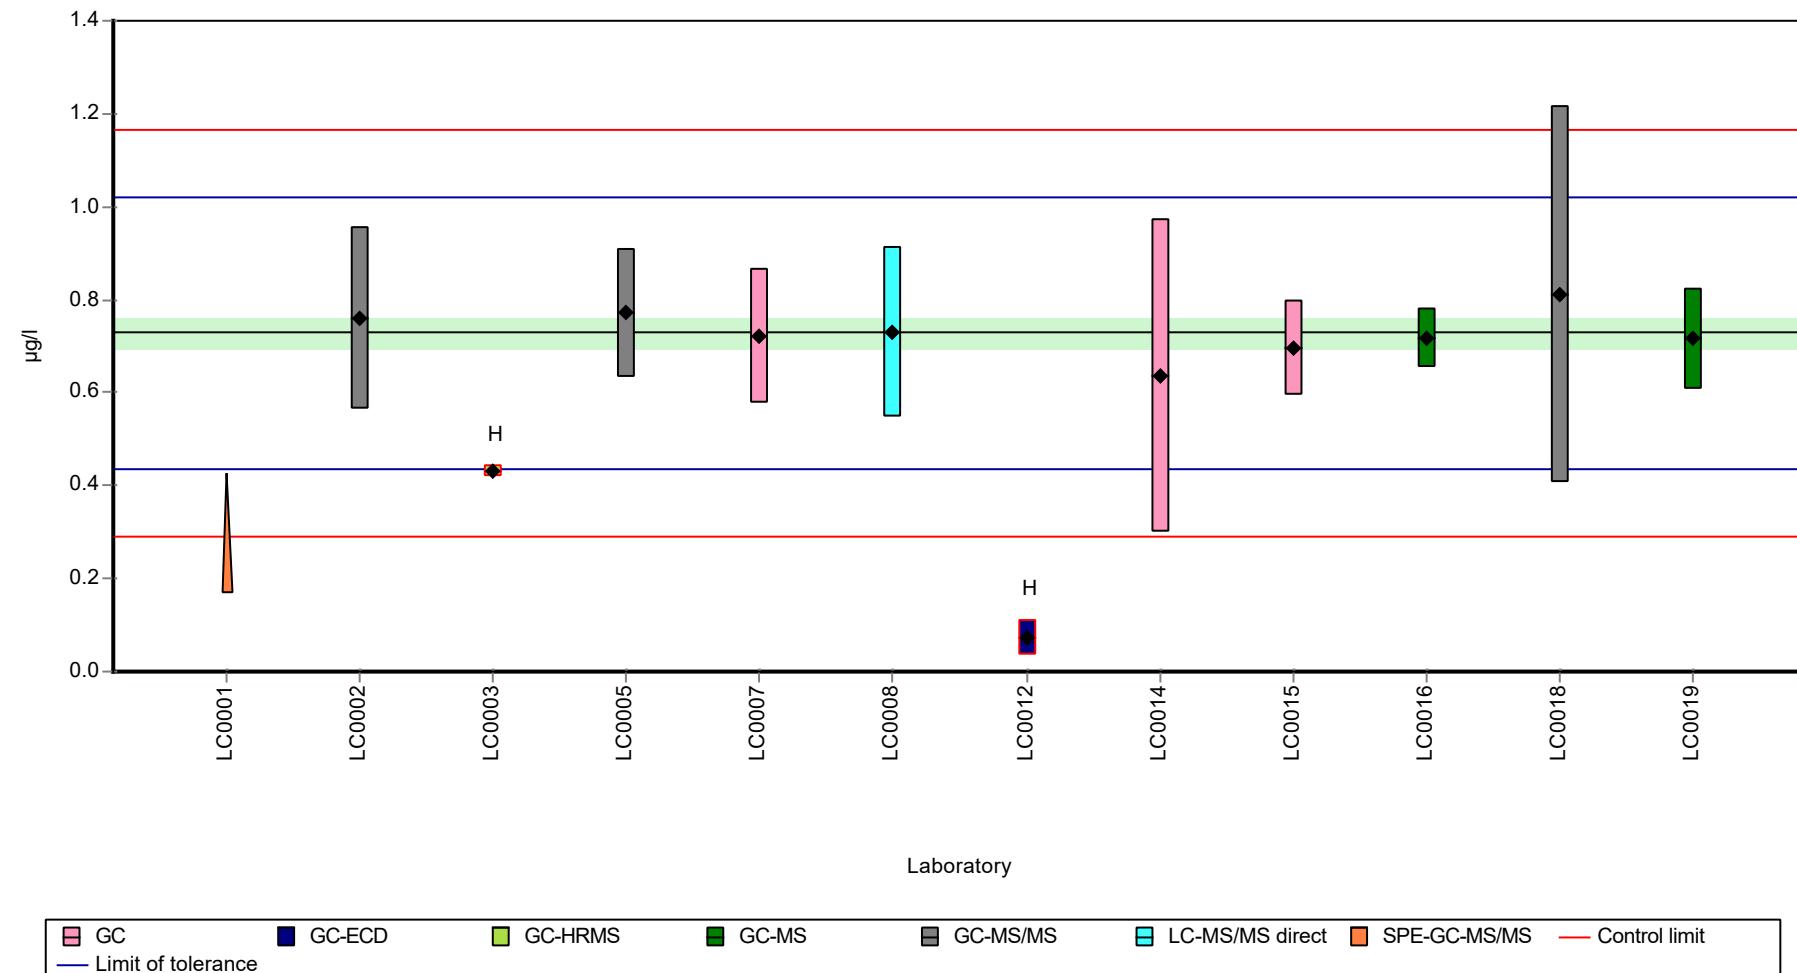


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Lindane (Gamma-HCH)

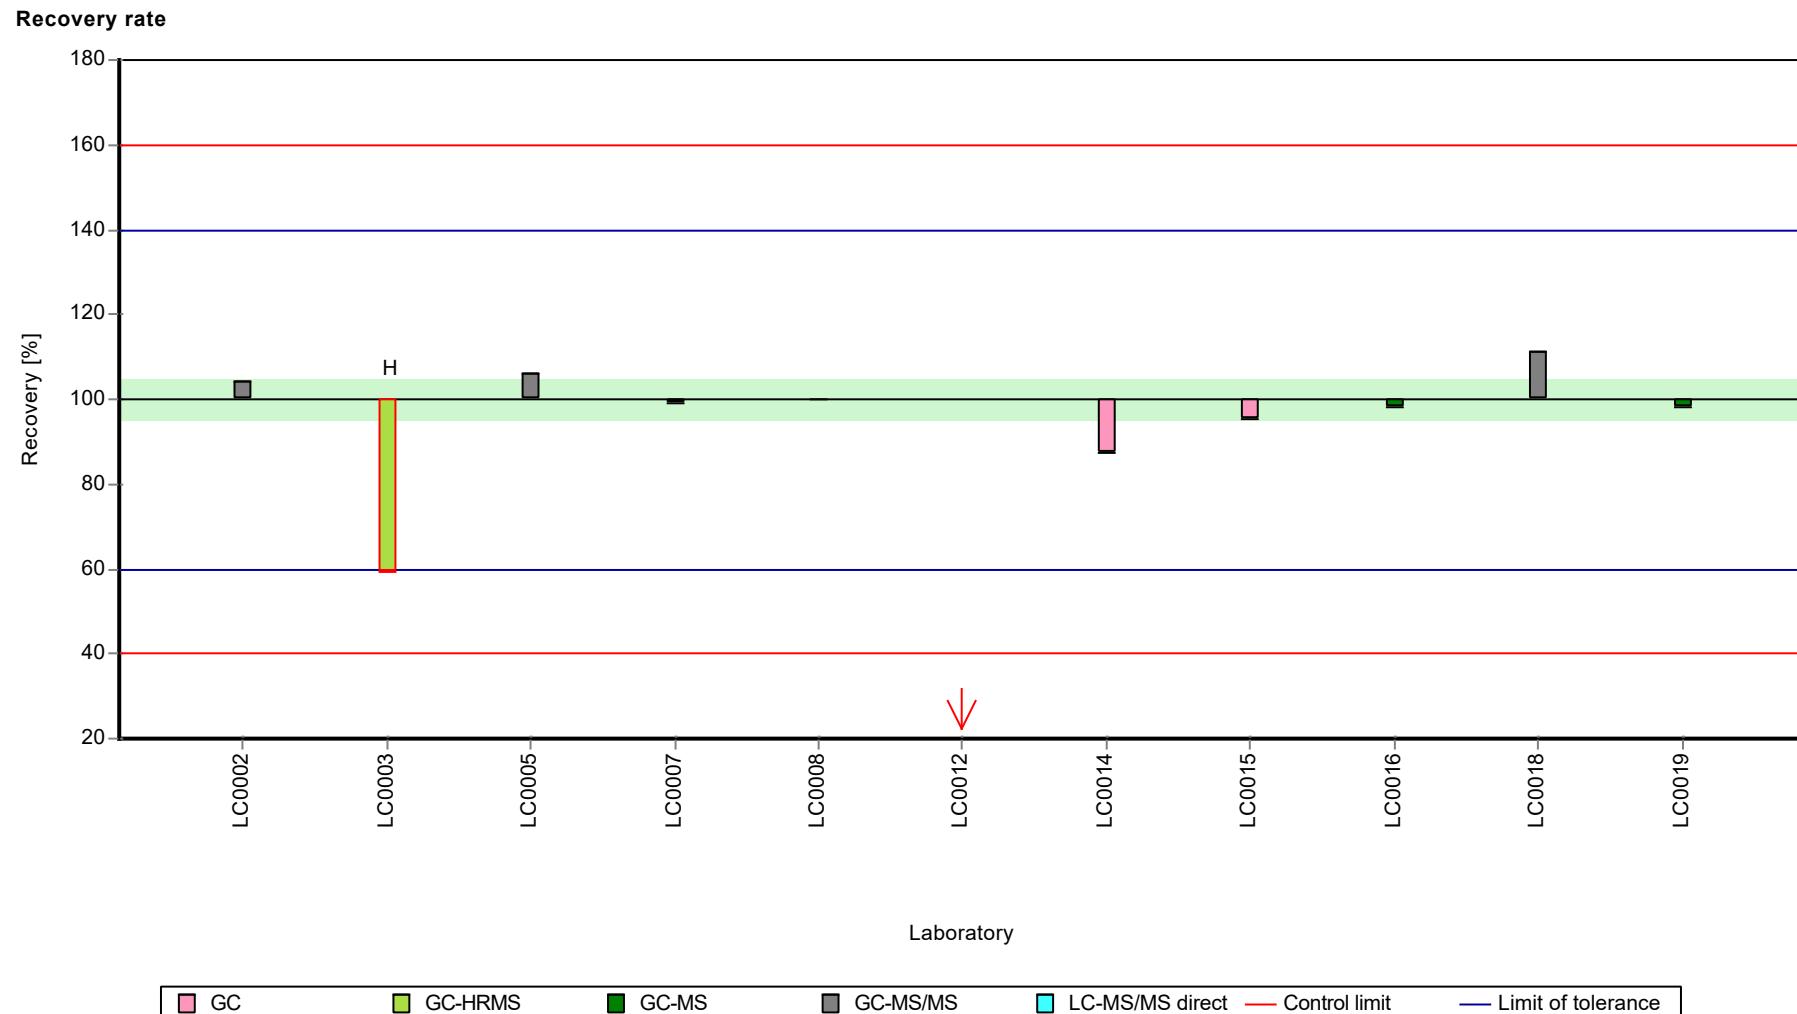

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Lindane (Gamma-HCH)

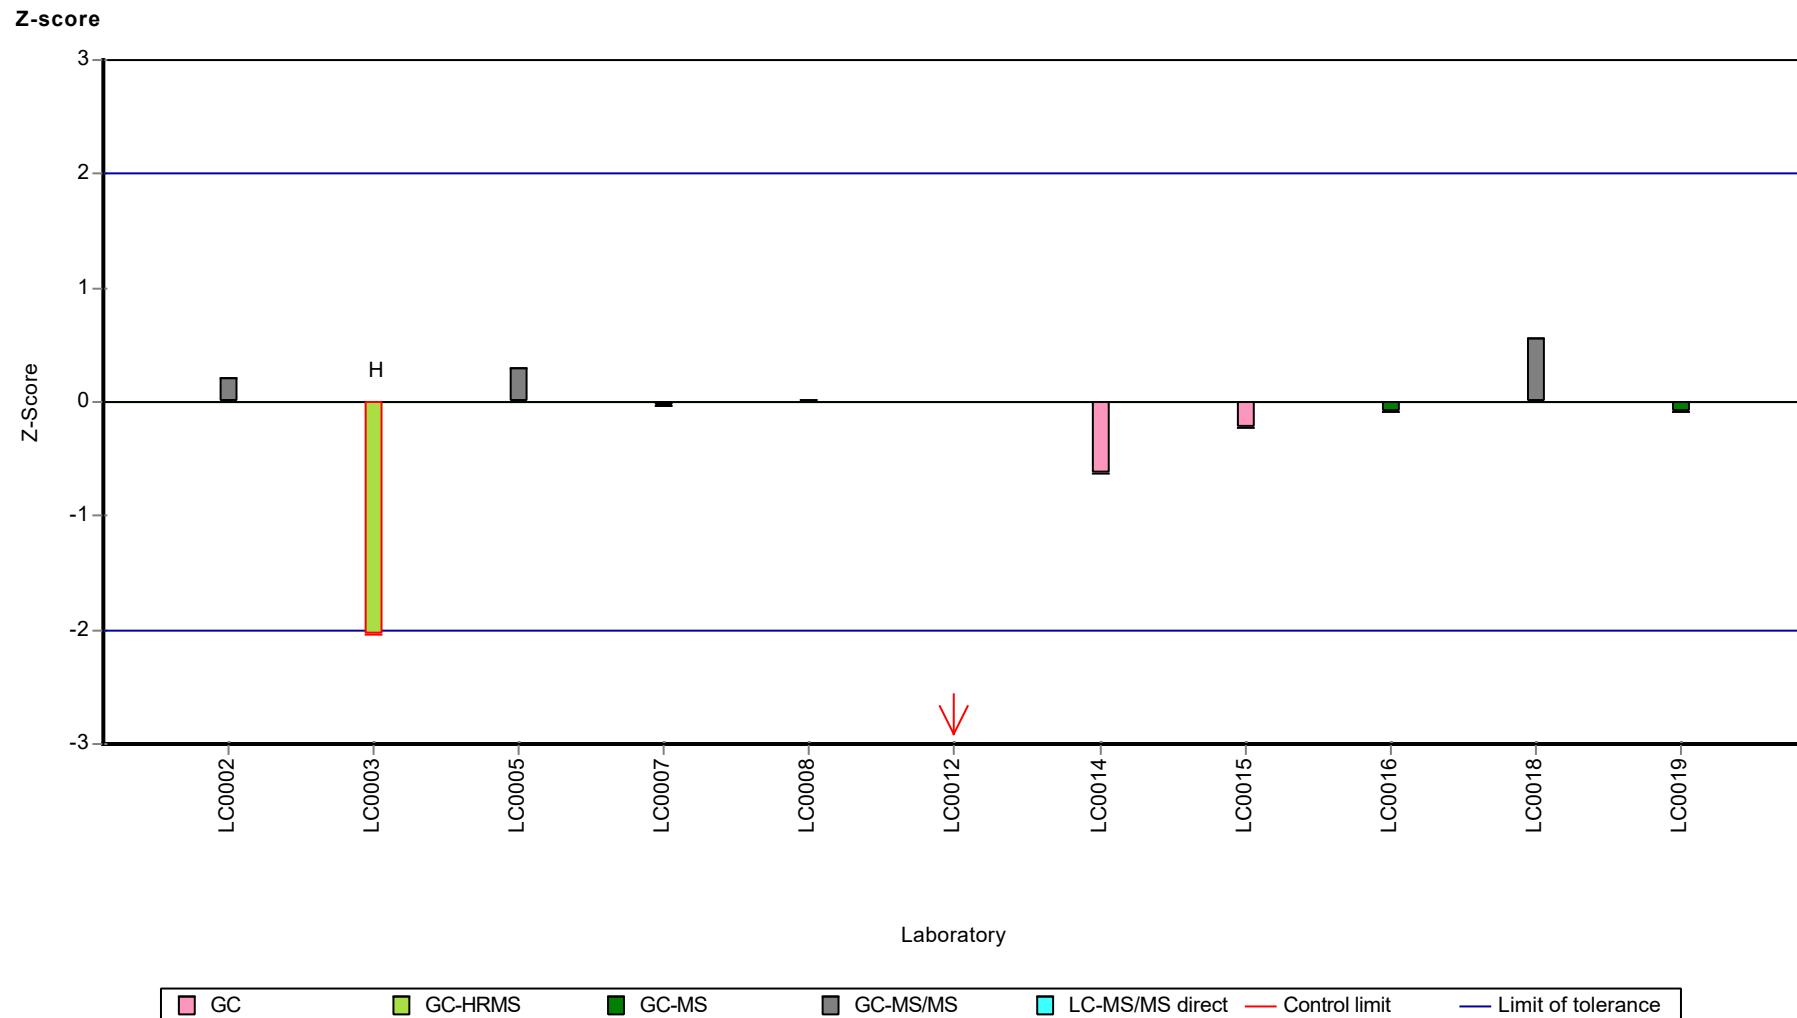

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Nitenpyram

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Nitenpyram

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	-
Criterion	-
Minimum - Maximum	0.0164 - 0.138
Control test value ± U (k=2)	0.0917 ± 0.0138

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	-	-	-	-	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	0.138	0.035	-	-	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.0164	0.0082	-	-	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	-	-	-	-	
LC0016	0.117	0.02	-	-	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.115	0.058	-	-	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.0966 ± 0.0817	-	µg/l
Minimum	0.0164	0.0164	µg/l
Maximum	0.138	0.138	µg/l
Standard deviation	0.0545	-	µg/l
rel. standard deviation	56.4	-	%
n	4	4	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Nitenpyram

**Graphical presentation of results**

**Results**

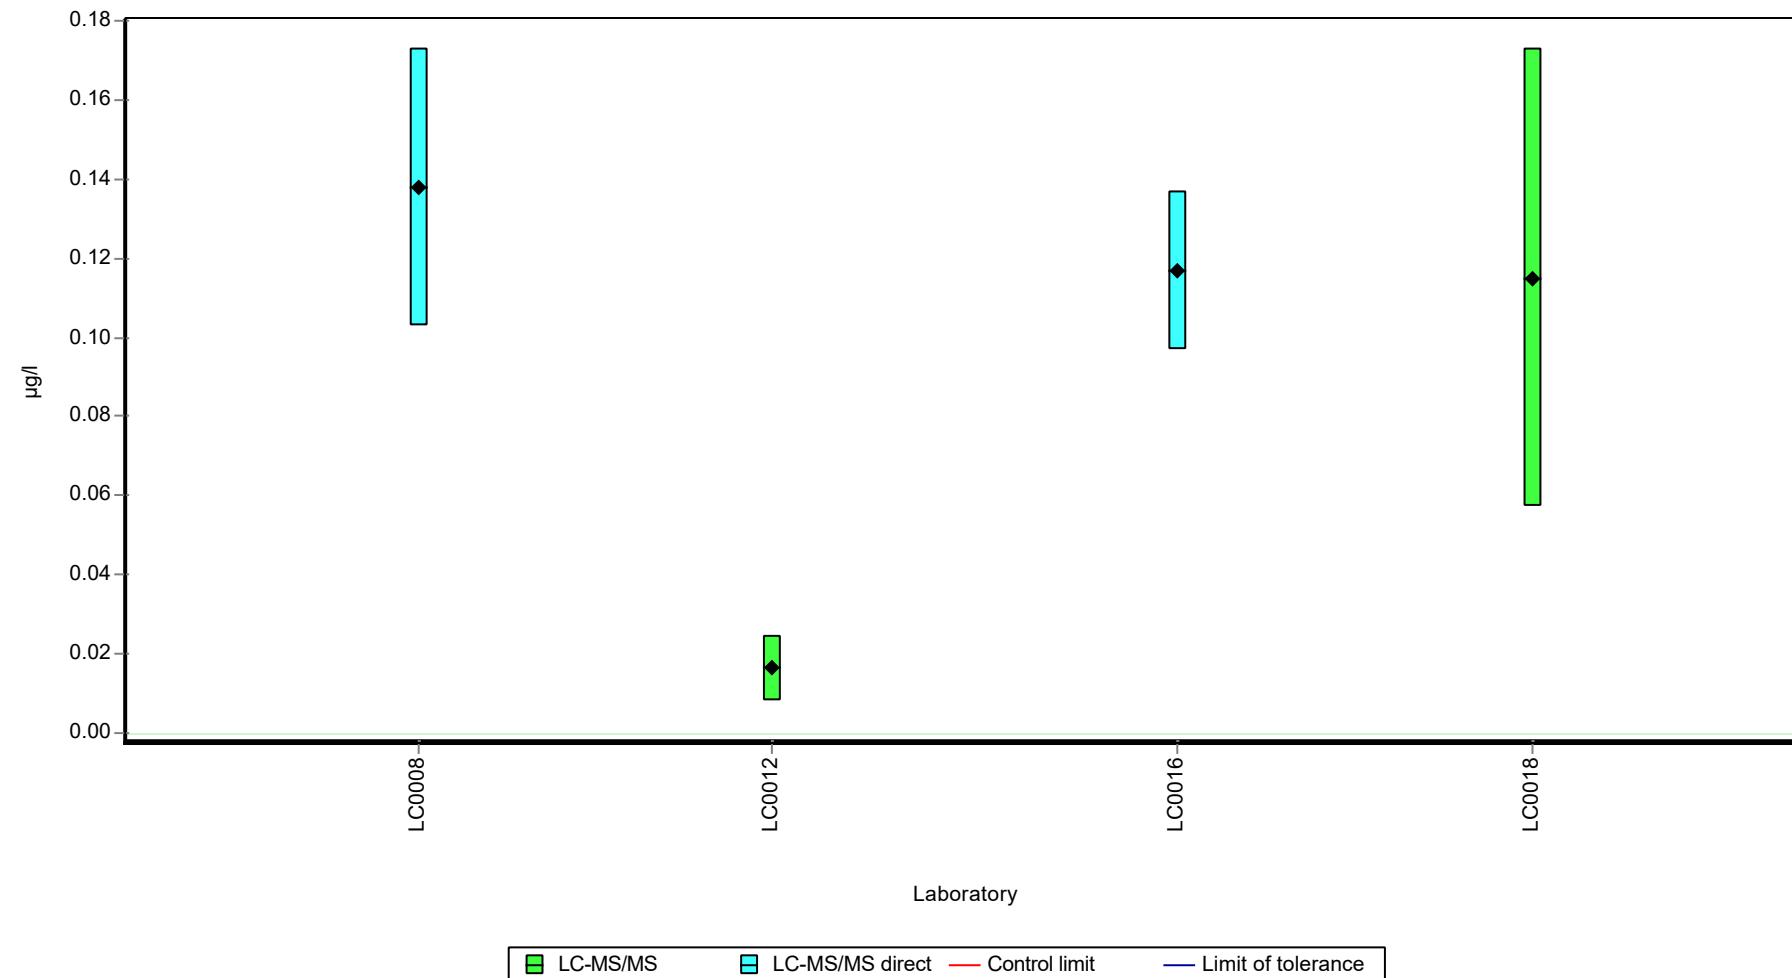

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Nitenpyram

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Nitenpyram

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	-
Criterion	-
Minimum - Maximum	0.681 - 2.8
Control test value ± U (k=2)	2.110 ± 0.316

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	-	-	-	-	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	2.798	0.7	-	-	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.6814	0.3407	-	-	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	-	-	-	-	
LC0016	2.52	0.43	-	-	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	2.45	1.23	-	-	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	2.11 ± 1.45	-	µg/l
Minimum	0.681	0.681	µg/l
Maximum	2.8	2.8	µg/l
Standard deviation	0.966	-	µg/l
rel. standard deviation	45.7	-	%
n	4	4	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Nitenpyram

**Graphical presentation of results**

**Results**

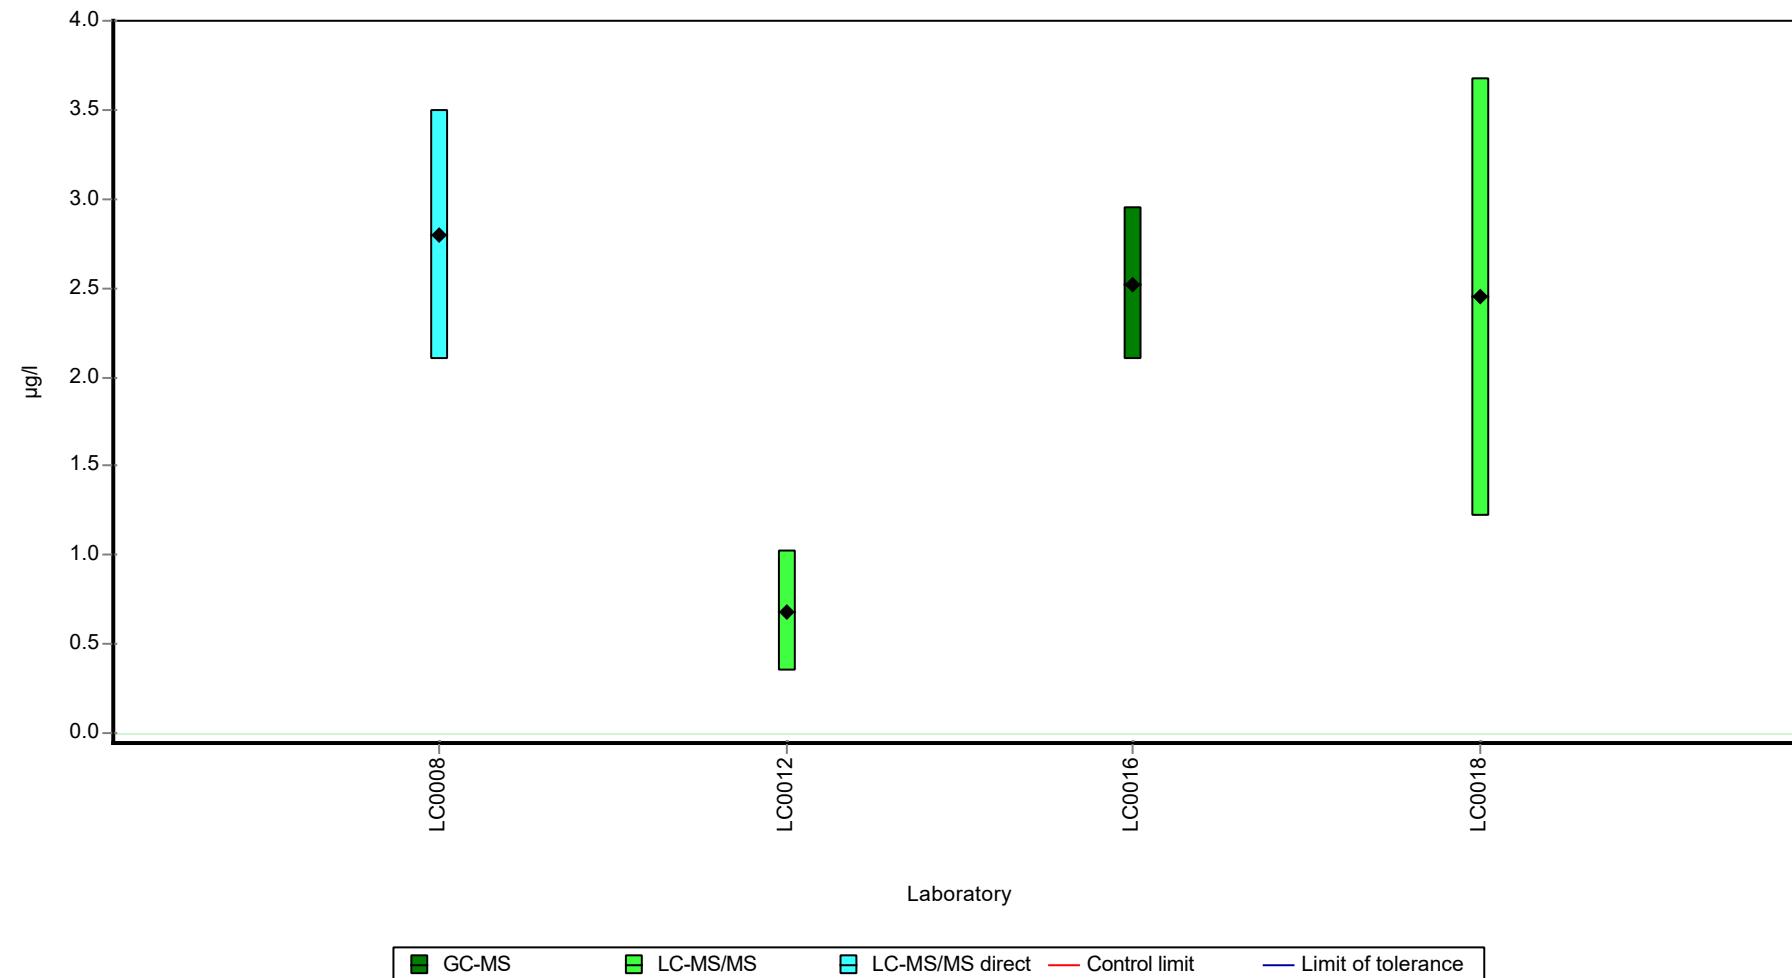

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Prometryn

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Prometryn

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.237 ± 0.00991
Criterion	0.0308 (13 %)
Minimum - Maximum	0.22 - 0.266
Control test value ± U (k=2)	0.2310 ± 0.0346

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	0.2309	0.056	97.4	-0.2	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.233	0.042	98.3	-0.13	
LC0006	0.22	0.006	92.8	-0.55	
LC0007	0.299	0.037	126	2.01	H
LC0008	0.336	0.084	142	3.21	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	0.253	0.051	107	0.52	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.1401	0.0701	59.1	-3.15	H
LC0013	0.266	0.002	112	0.94	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.222	0.033	93.6	-0.49	
LC0016	0.244	0.043	103	0.23	
LC0017	0.2346	0.05161	99	-0.08	
LC0018	0.23	0.115	97	-0.23	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.242 ± 0.0408	0.237 ± 0.0149	µg/l
Minimum	0.14	0.22	µg/l
Maximum	0.336	0.266	µg/l
Standard deviation	0.0471	0.0149	µg/l
rel. standard deviation	19.5	6.27	%
n	12	9	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Prometryn


**Graphical presentation of results**

**Results**

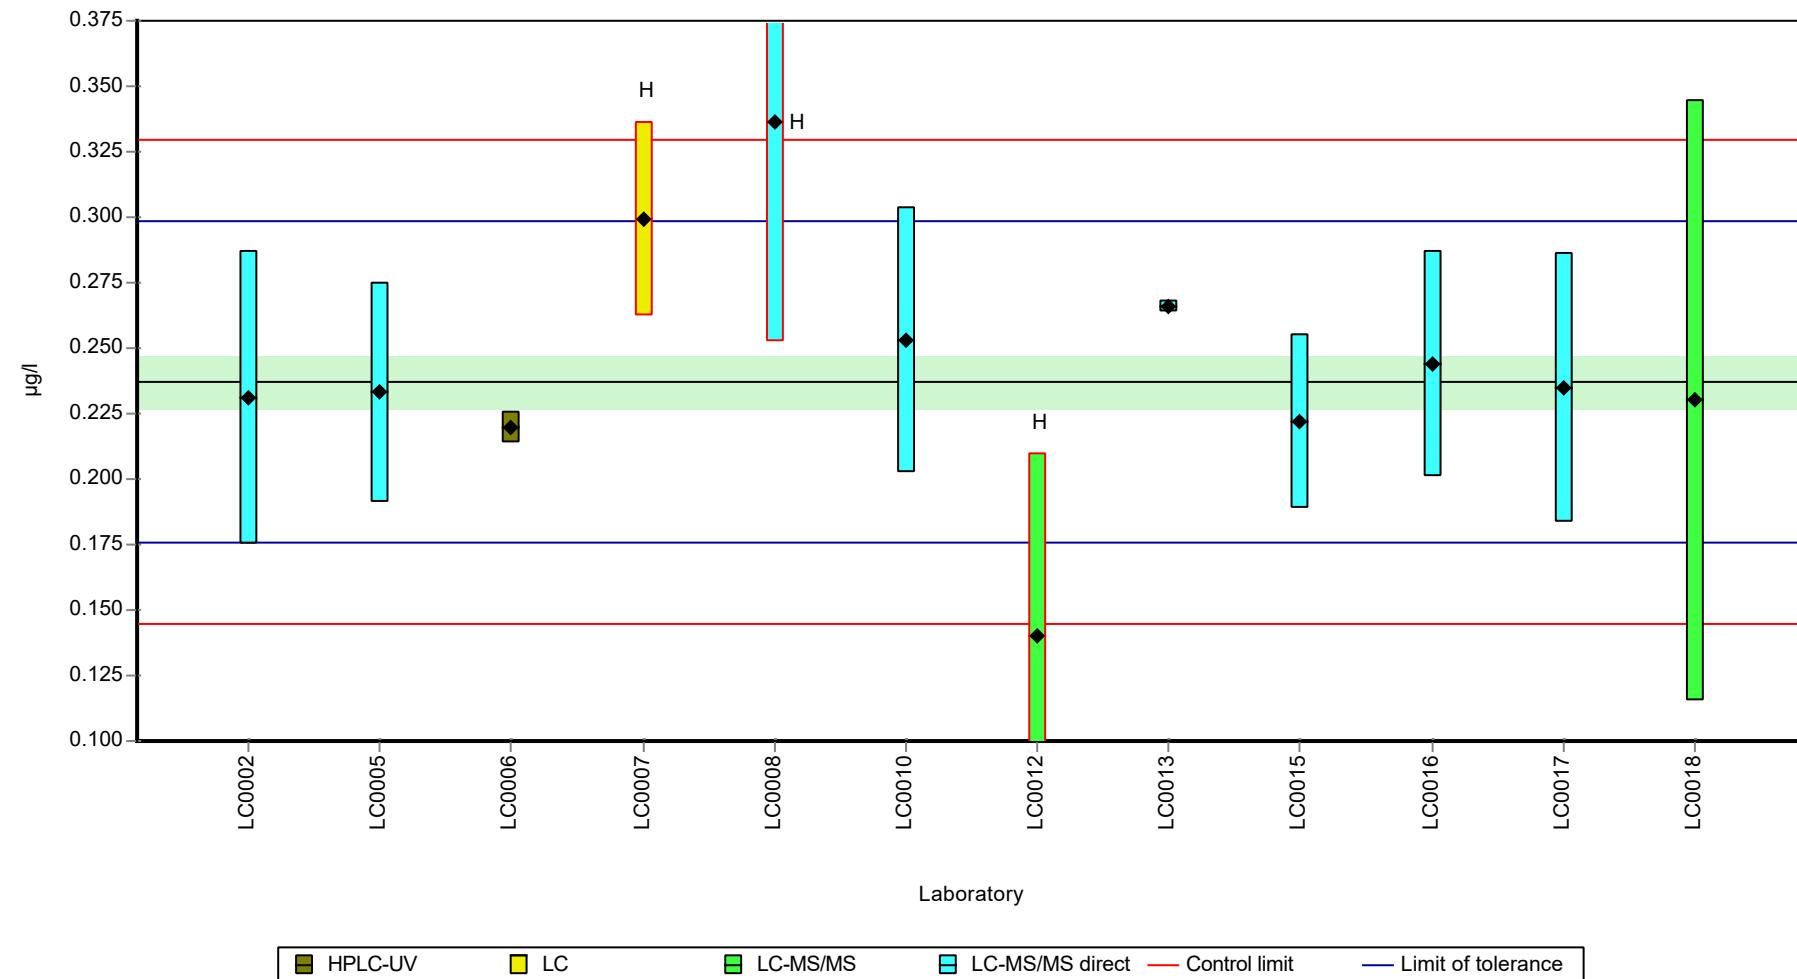


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Prometryn

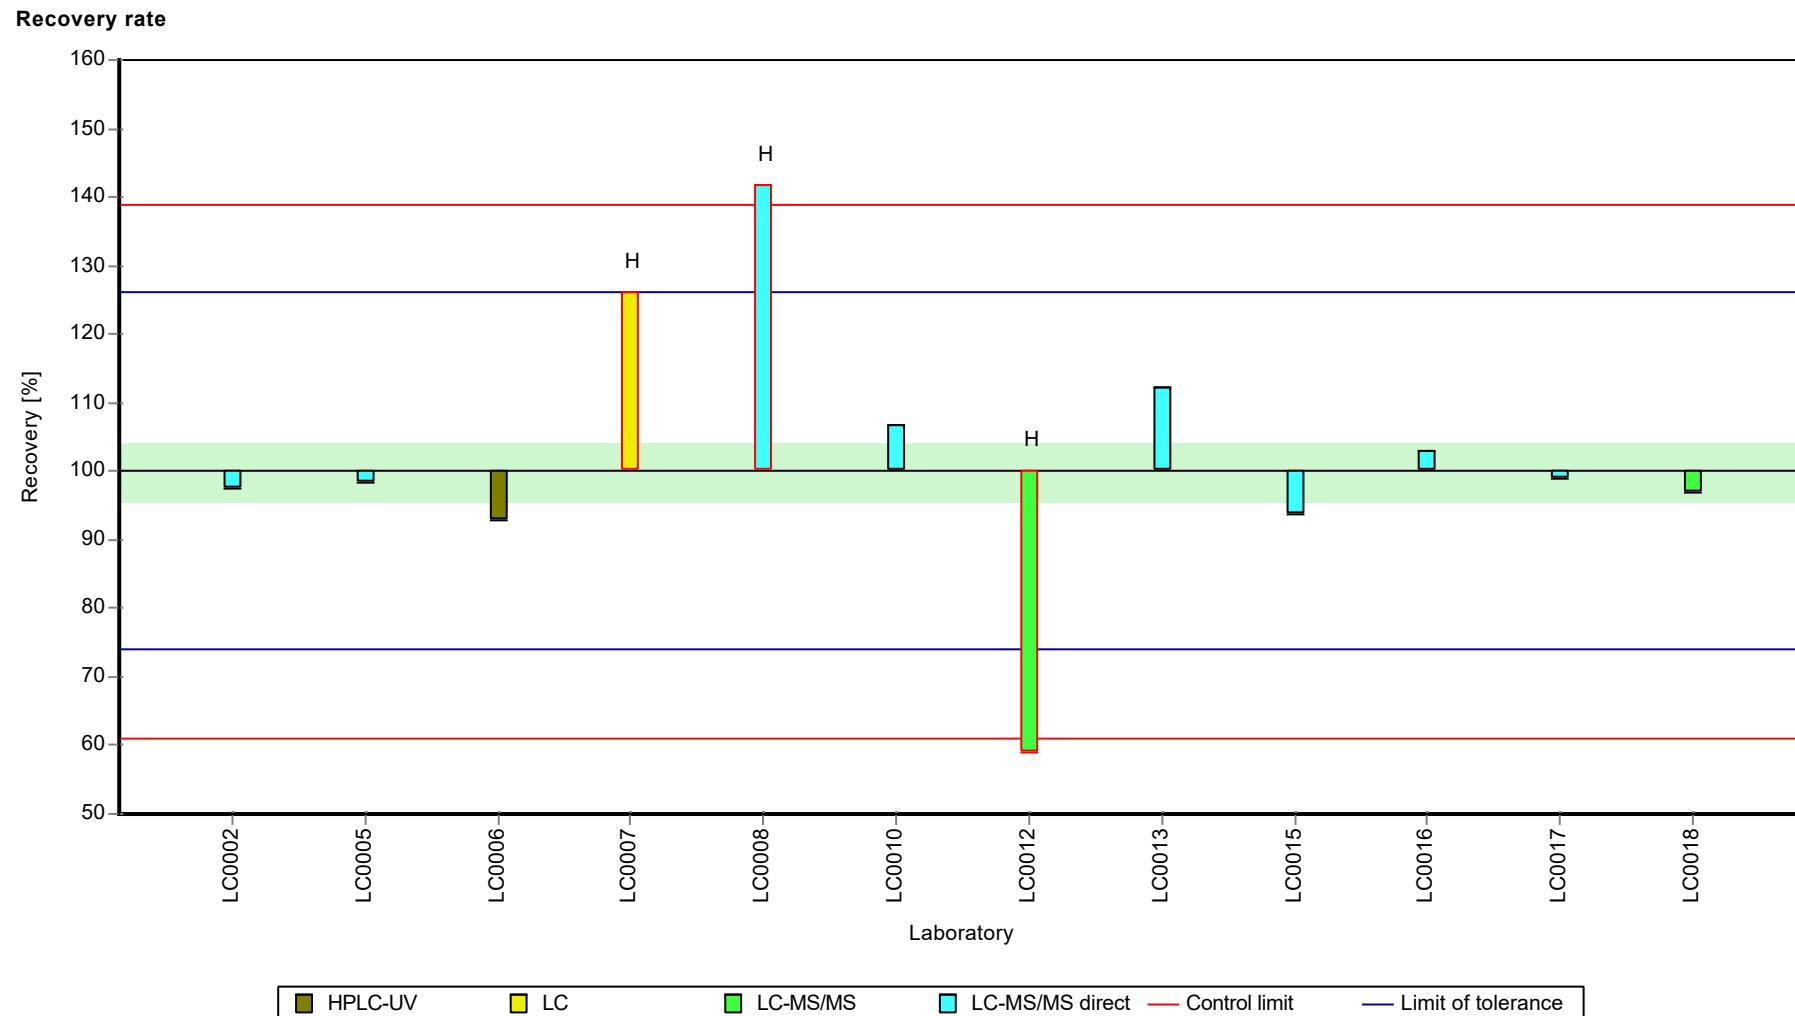

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Prometryn

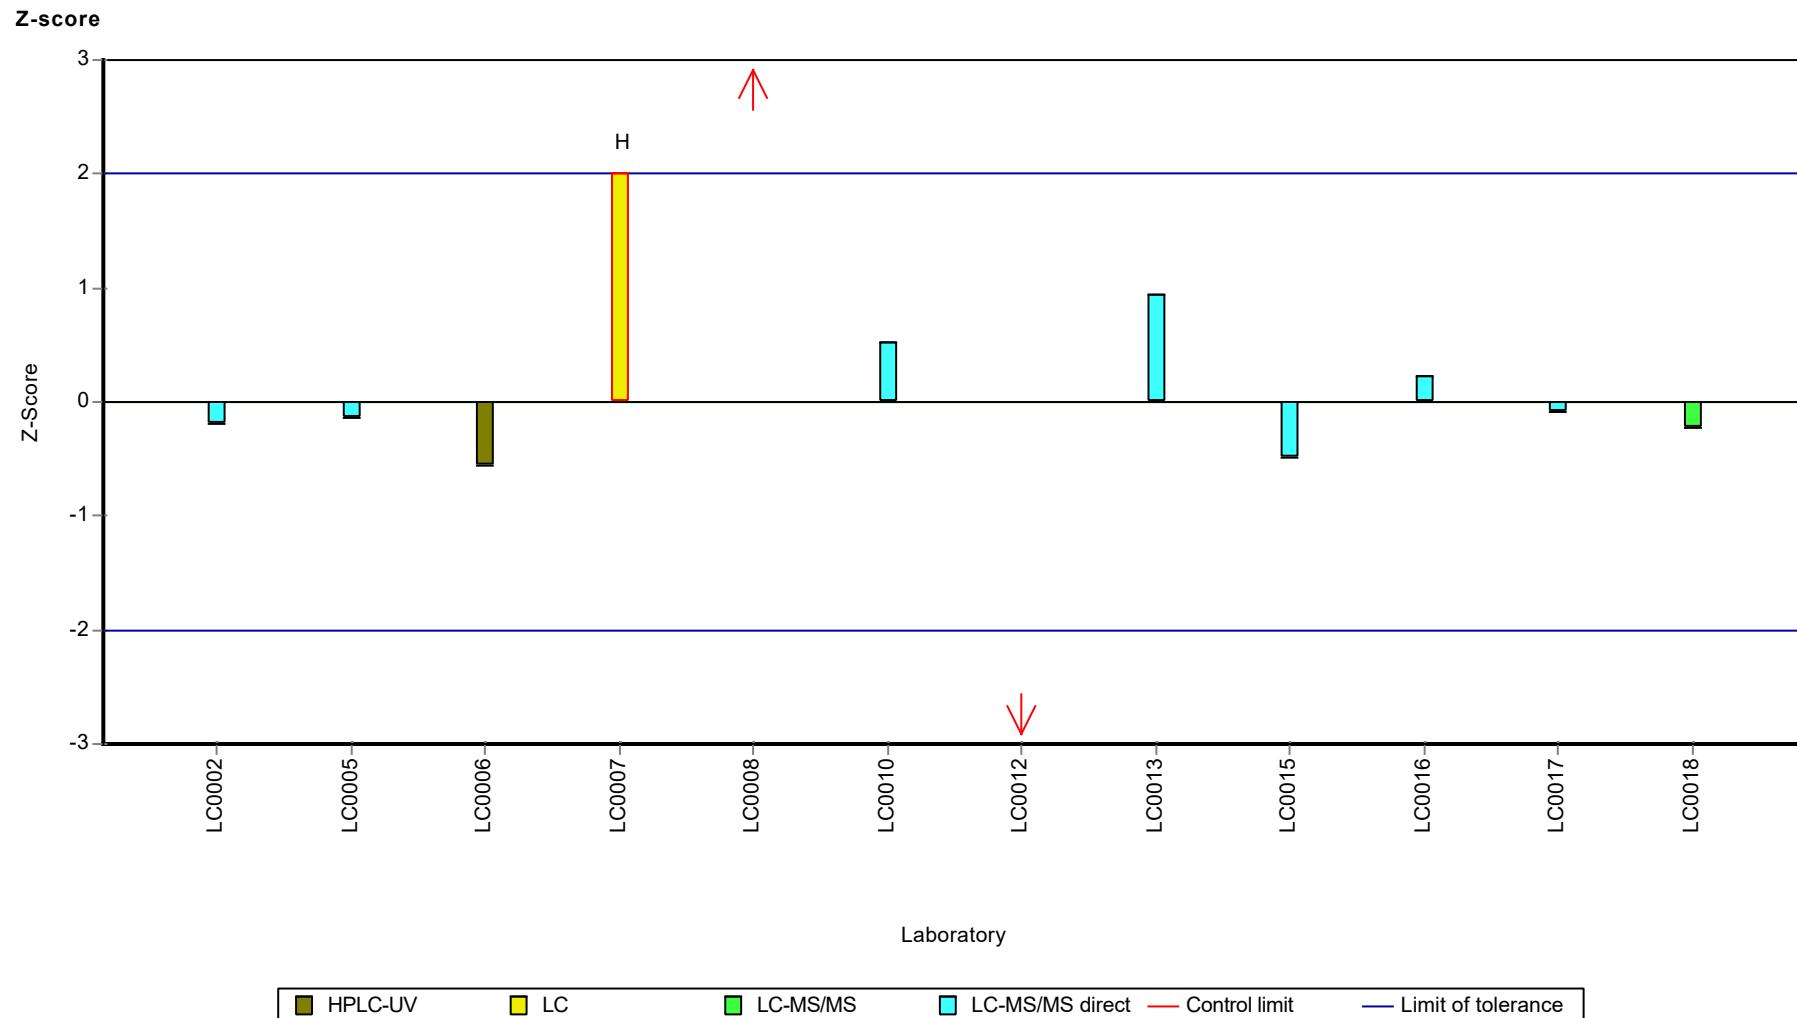

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Prometryn

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Prometryn

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	2.24 ± 0.107
Criterion	0.291 (13 %)
Minimum - Maximum	2.12 - 2.58
Control test value ± U (k=2)	2.230 ± 0.334

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	1.6213	0.3932	72.4	-2.12	H
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	2.115	0.381	94.5	-0.42	
LC0006	2.16	0.03	96.5	-0.27	
LC0007	2.885	0.361	129	2.22	H
LC0008	3.054	0.764	136	2.8	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	2.58	0.52	115	1.17	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.9671	0.4836	43.2	-4.37	H
LC0013	2.3	0.046	103	0.21	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	2.127	0.319	95	-0.38	
LC0016	2.25	0.4	101	0.04	
LC0017	2.17533	0.47857	97.2	-0.22	
LC0018	2.2	1.1	98.3	-0.13	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	2.2 ± 0.469	2.24 ± 0.16	µg/l
Minimum	0.967	2.12	µg/l
Maximum	3.05	2.58	µg/l
Standard deviation	0.541	0.151	µg/l
rel. standard deviation	24.6	6.75	%
n	12	8	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Prometryn


**Graphical presentation of results**

**Results**

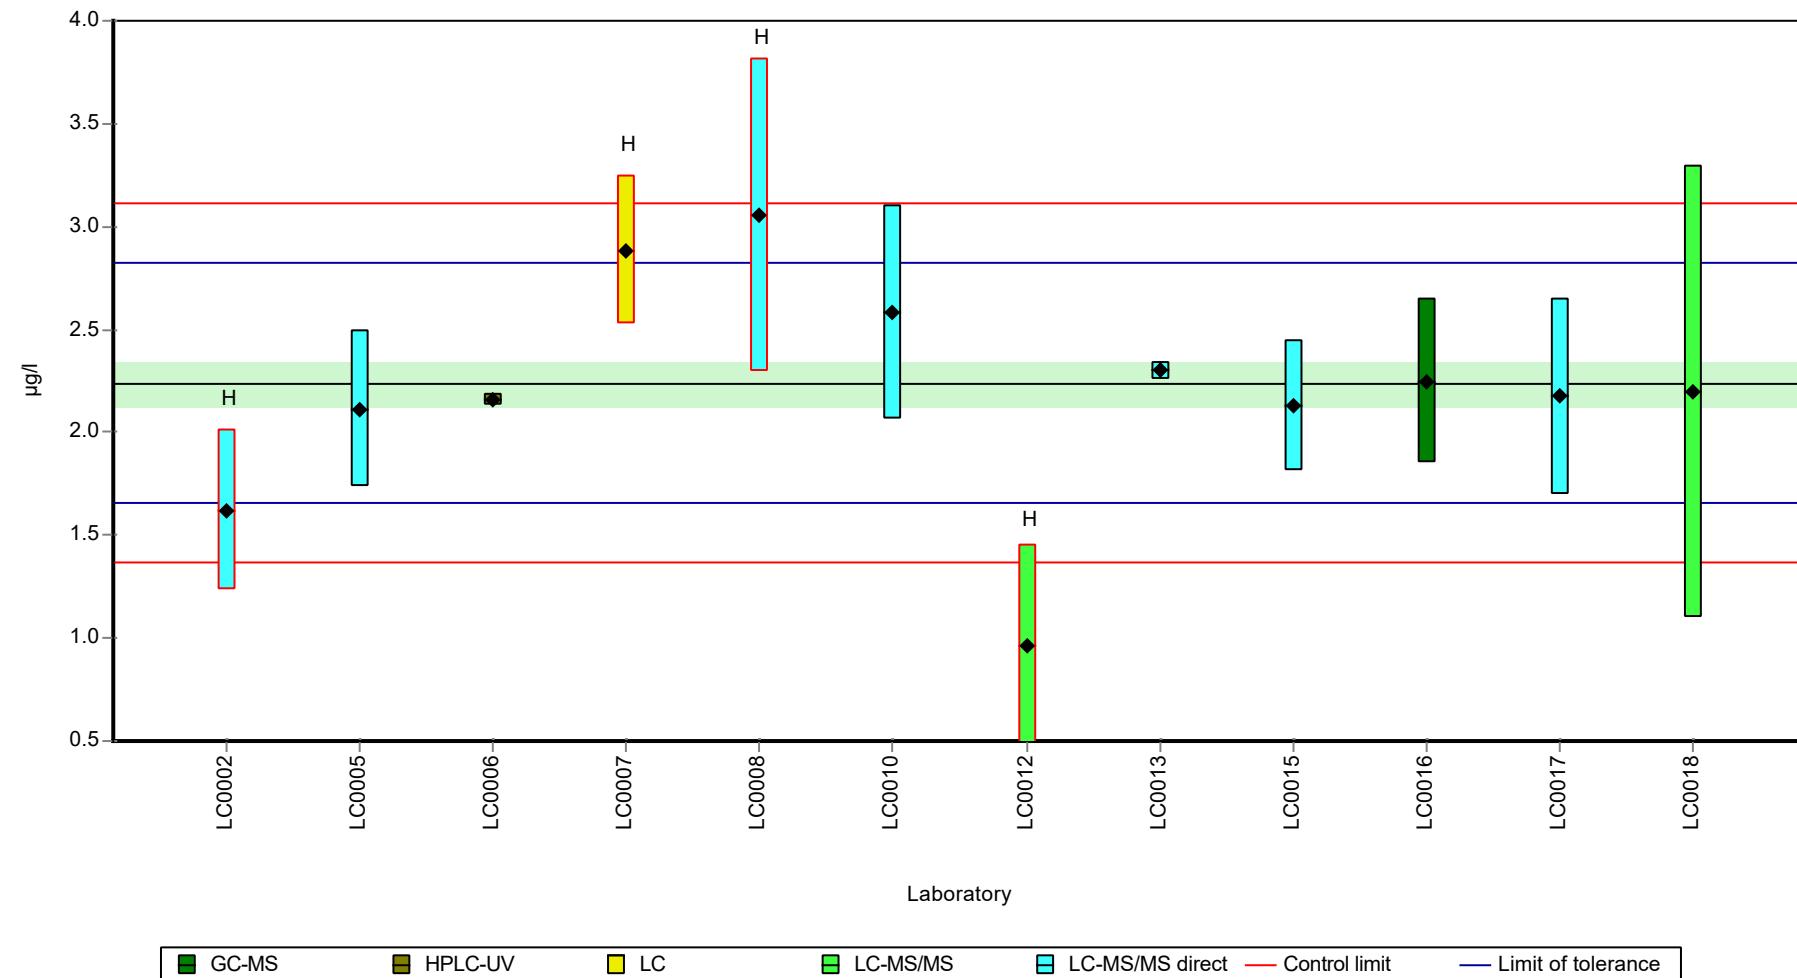


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Prometryn

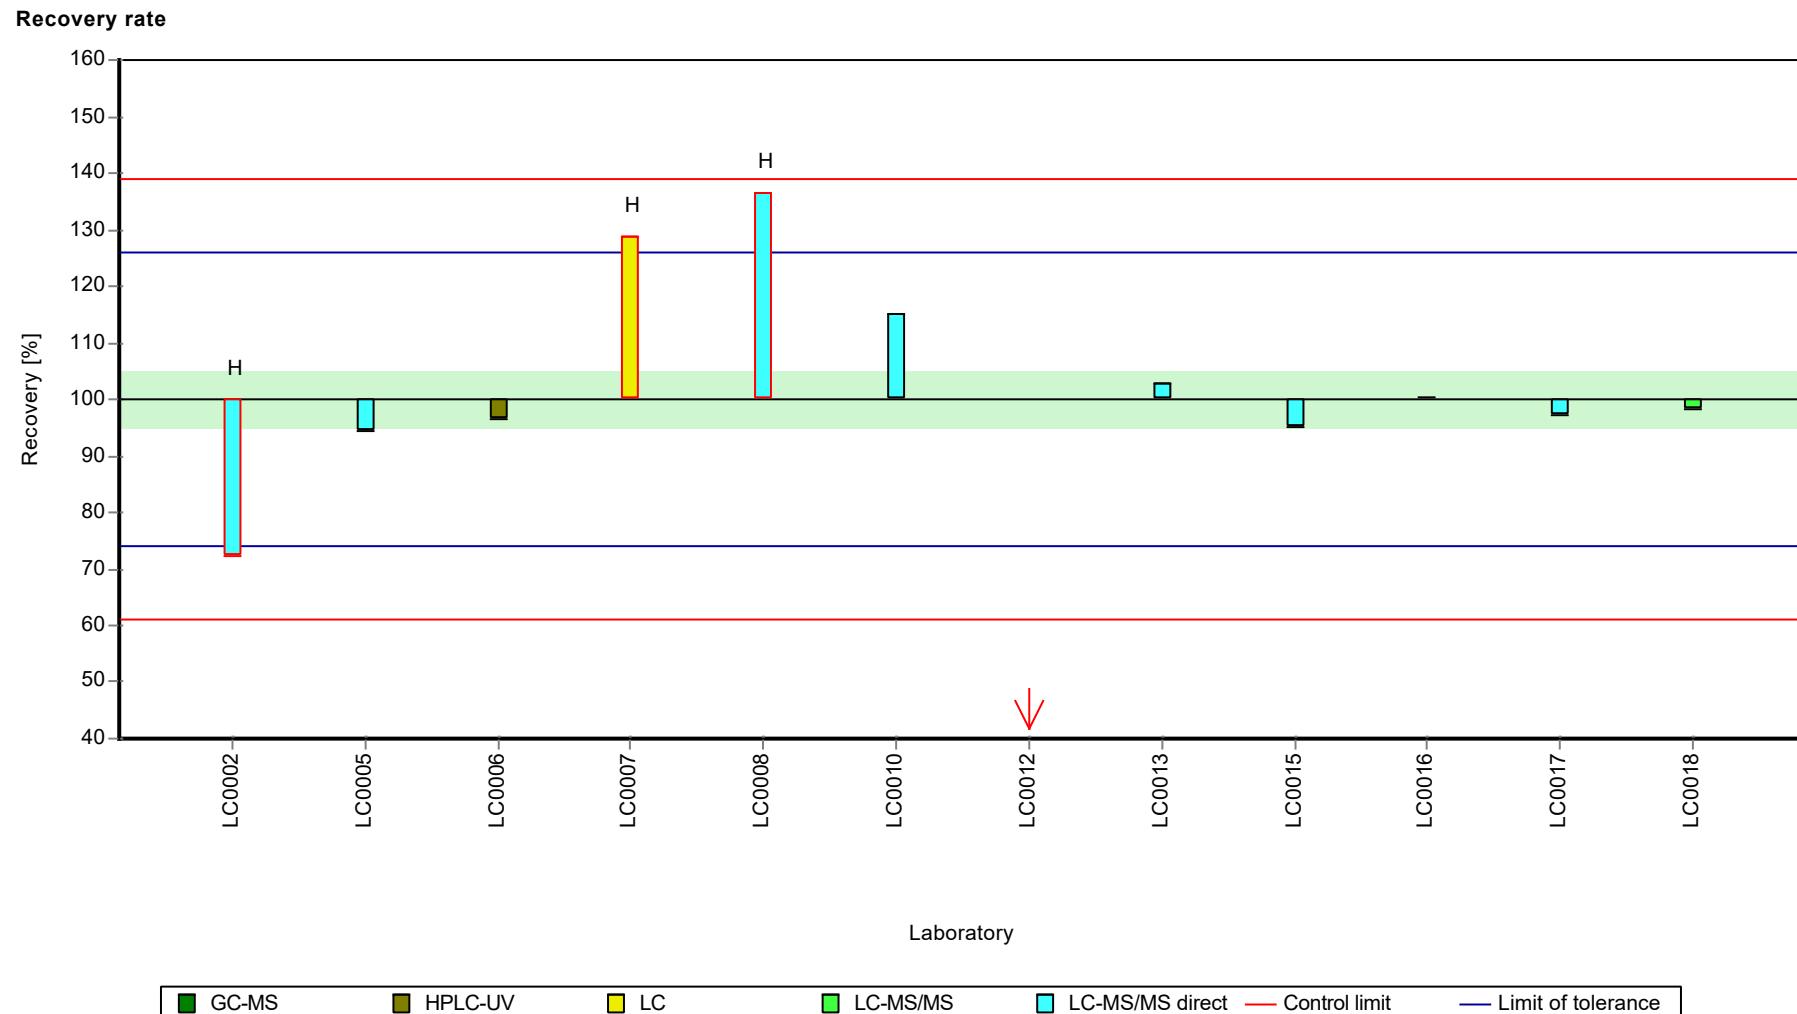

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Prometryn

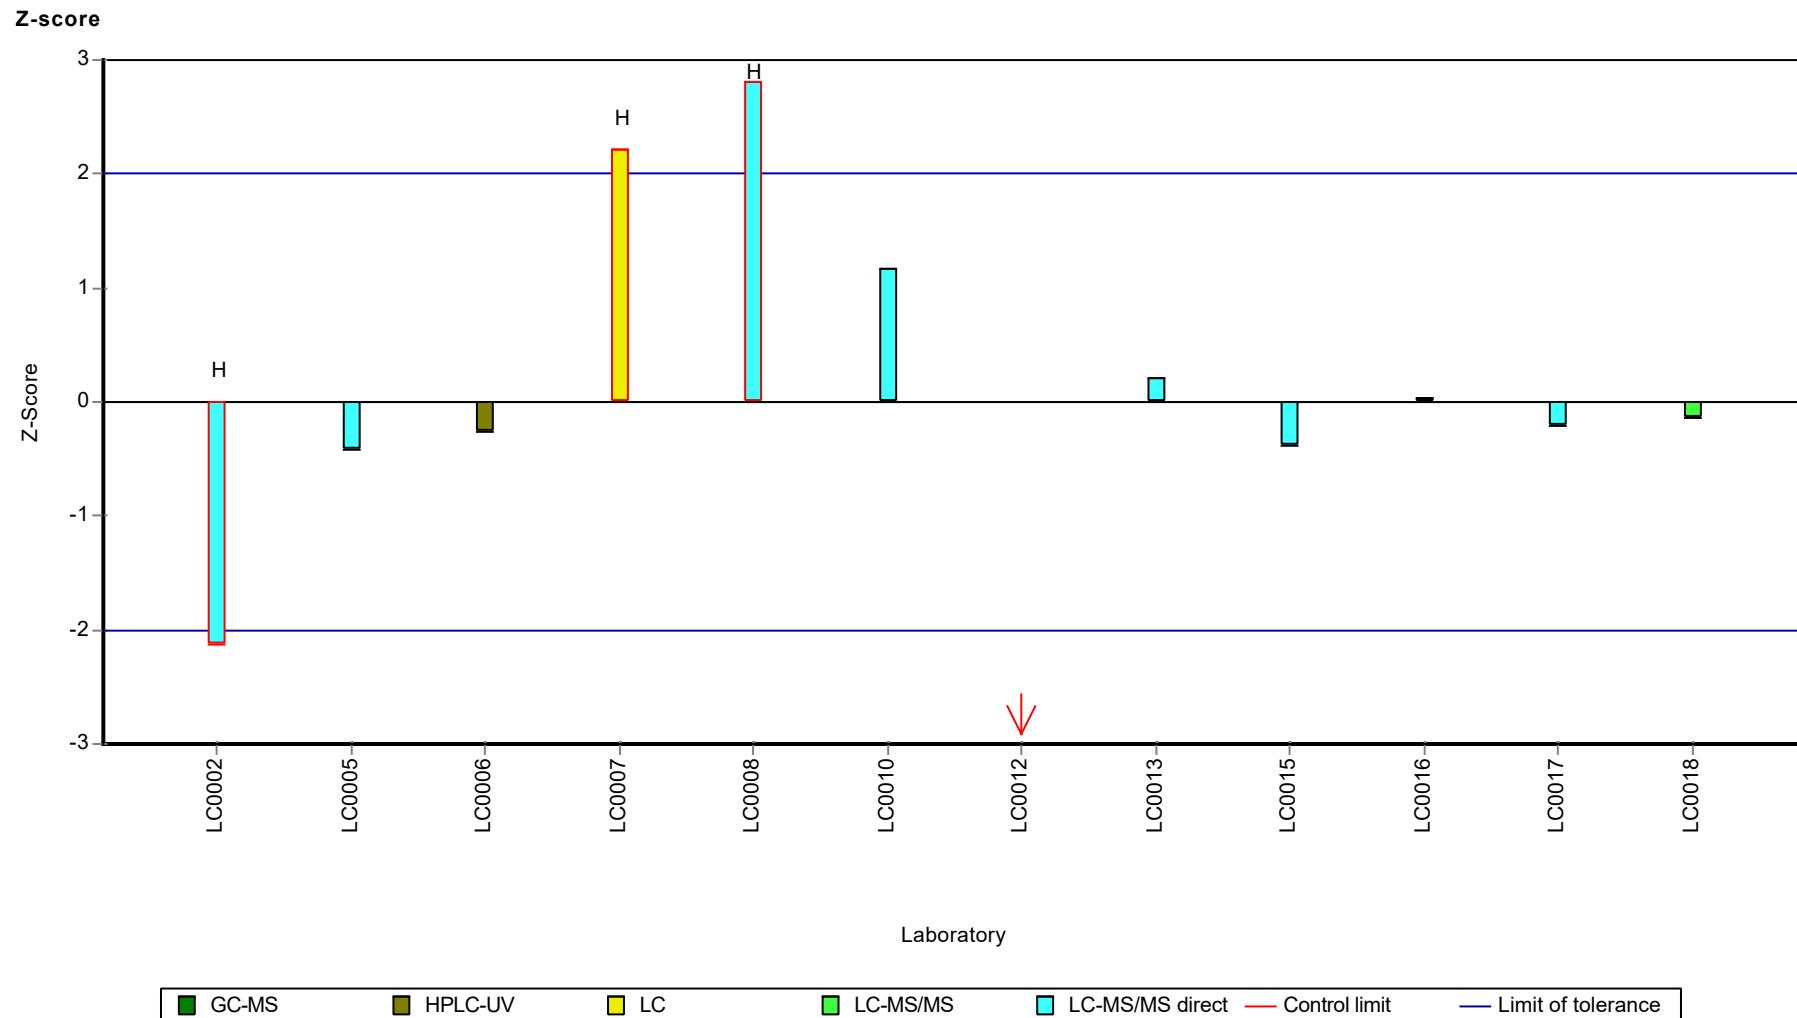

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Propazine

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Propazine

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.06 ± 0.00973
Criterion	0.0174 (29 %)
Minimum - Maximum	0.033 - 0.107
Control test value ± U (k=2)	0.0690 ± 0.0104

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	0.0479	0.0115	79.8	-0.7	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.061	0.011	102	0.06	
LC0006	0.046	0.007	76.6	-0.81	
LC0007	0.071	0.009	118	0.63	
LC0008	0.107	0.027	178	2.7	
LC0009	0.06	0.012	100	0.00	
LC0010	0.0603	0.012	100	0.02	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.033	0.0165	55	-1.55	
LC0013	0.0714	0.001	119	0.65	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.05	0.007	83.3	-0.58	
LC0016	0.058	0.009	96.6	-0.12	
LC0017	0.05275	0.01161	87.9	-0.42	
LC0018	0.062	0.031	103	0.11	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.06 ± 0.0146	0.06 ± 0.0146	µg/l
Minimum	0.033	0.033	µg/l
Maximum	0.107	0.107	µg/l
Standard deviation	0.0175	0.0175	µg/l
rel. standard deviation	29.2	29.2 %	
n	13	13	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Propazine


**Graphical presentation of results**

**Results**

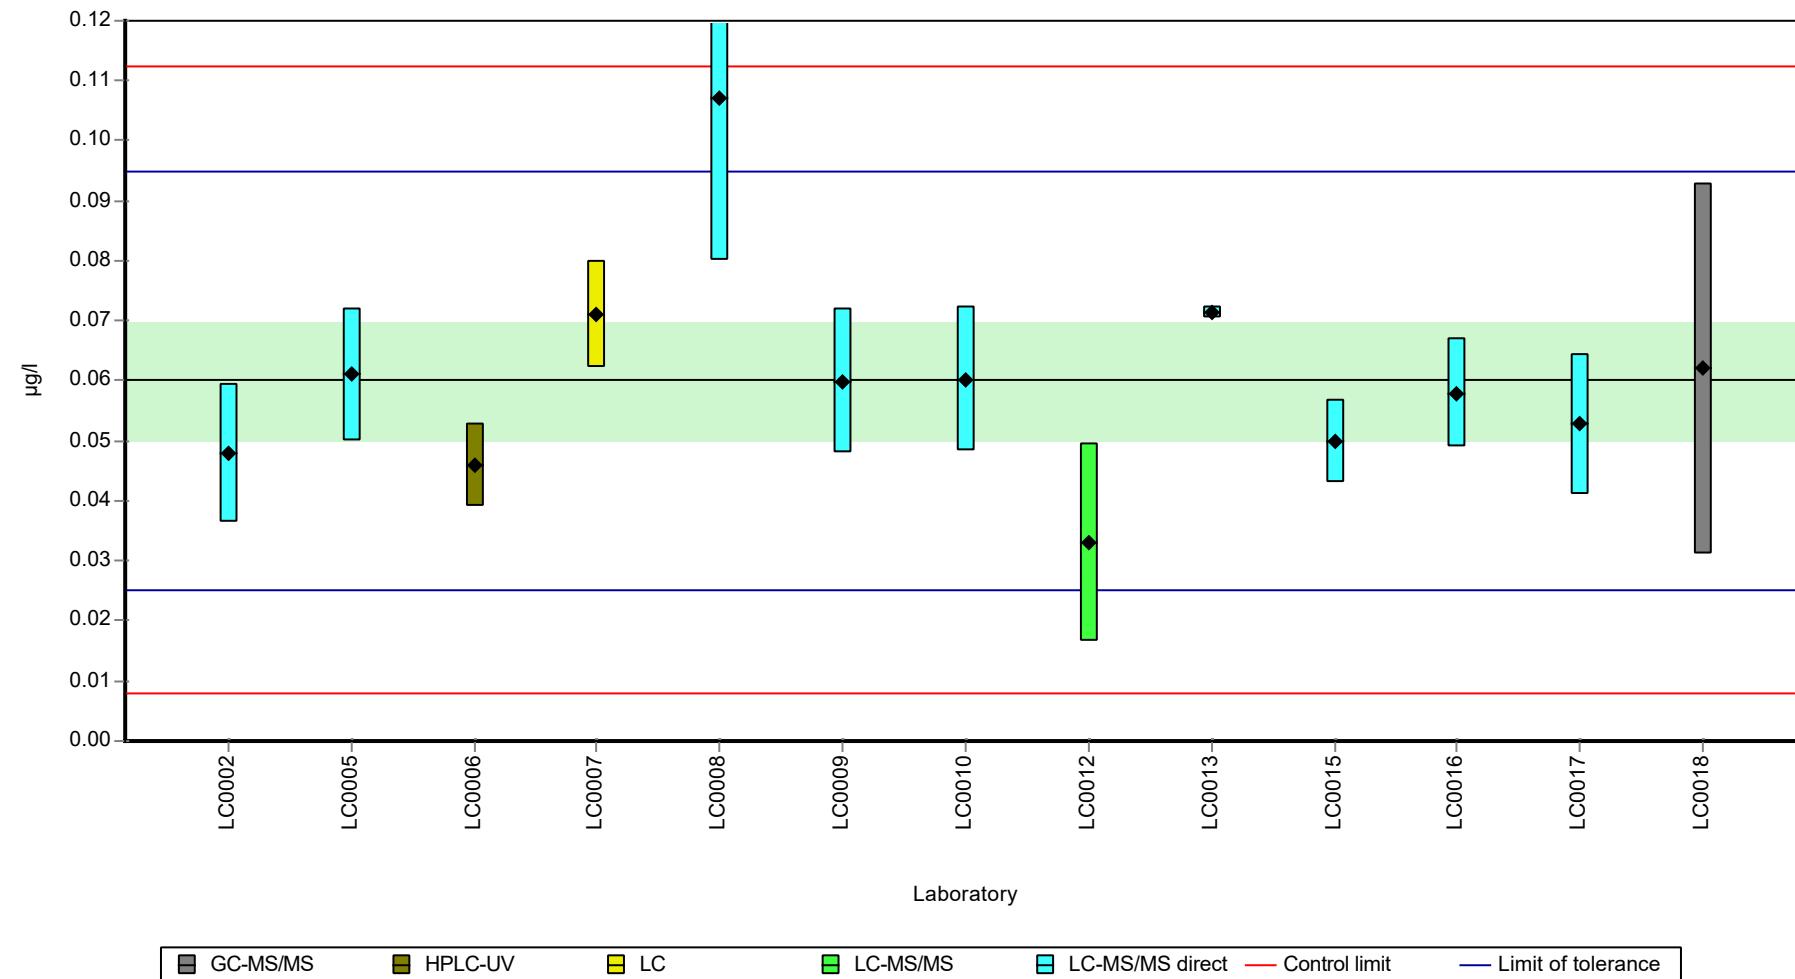


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Propazine

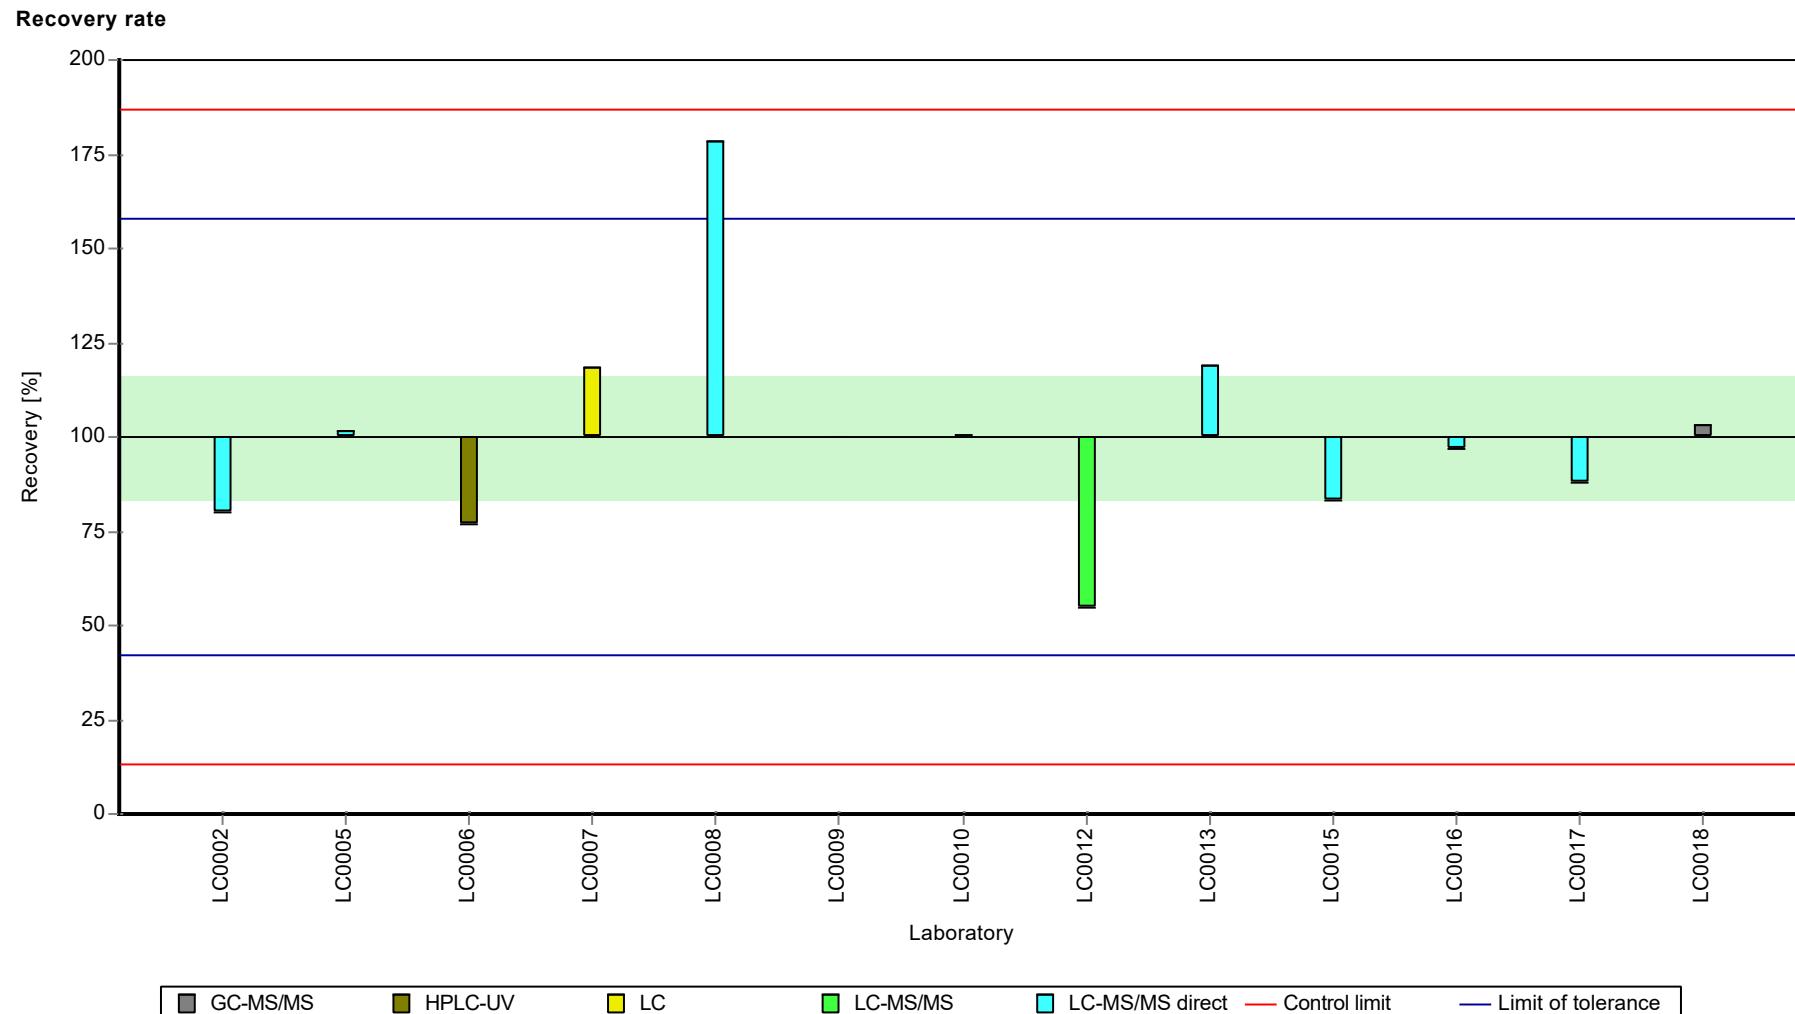

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Propazine

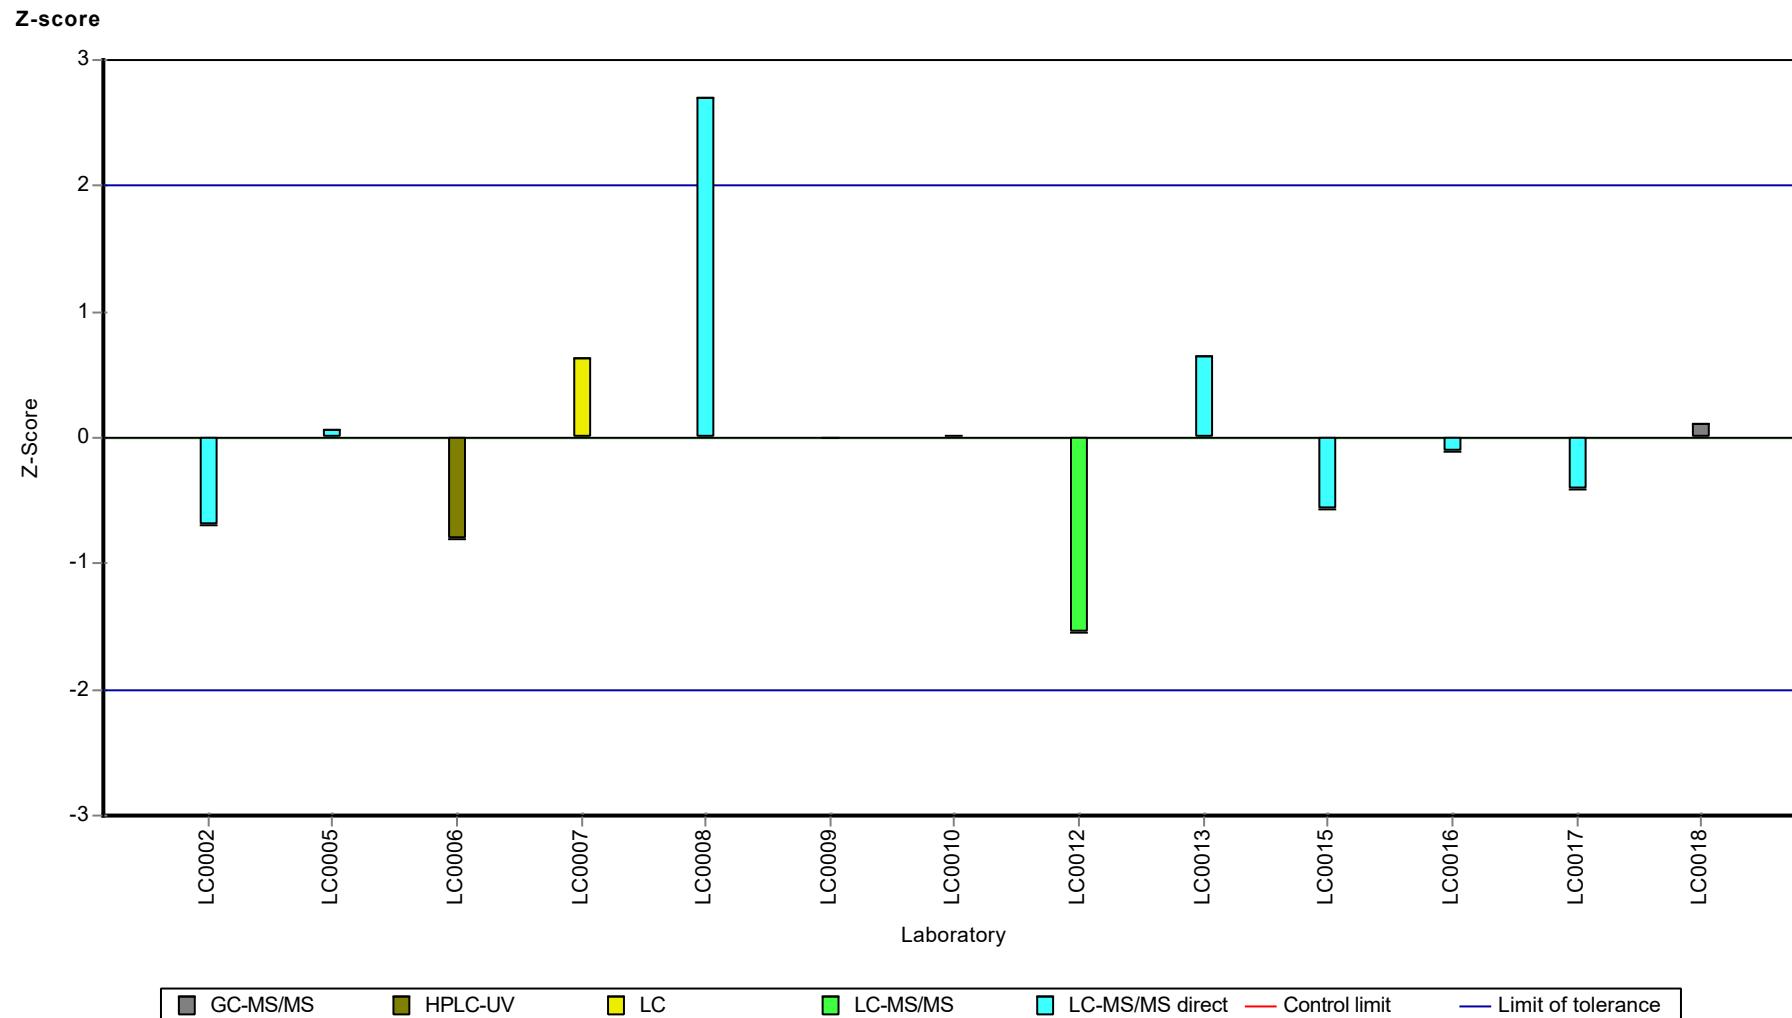

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Propazine

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Propazine

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	2.02 ± 0.141
Criterion	0.262 (13 %)
Minimum - Maximum	1.5 - 2.32
Control test value ± U (k=2)	2.380 ± 0.357

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	1.4961	0.358	74.2	-1.98	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	2.022	0.364	100	0.03	
LC0006	1.62	0.035	80.4	-1.51	
LC0007	2.315	0.289	115	1.14	
LC0008	3.098	0.775	154	4.13	H
LC0009	1.986	0.397	98.5	-0.11	
LC0010	2.24	0.45	111	0.86	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.6888	0.3444	34.2	-5.06	H
LC0013	2.19	0.062	109	0.67	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	1.775	0.266	88.1	-0.92	
LC0016	1.94	0.3	96.3	-0.29	
LC0017	1.86635	0.41059	92.6	-0.57	
LC0018	2.2	1.1	109	0.7	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	1.96 ± 0.456	1.97 ± 0.238	µg/l
Minimum	0.689	1.5	µg/l
Maximum	3.1	2.32	µg/l
Standard deviation	0.548	0.263	µg/l
rel. standard deviation	28	13.4	%
n	13	11	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Propazine


#### Graphical presentation of results

##### Results

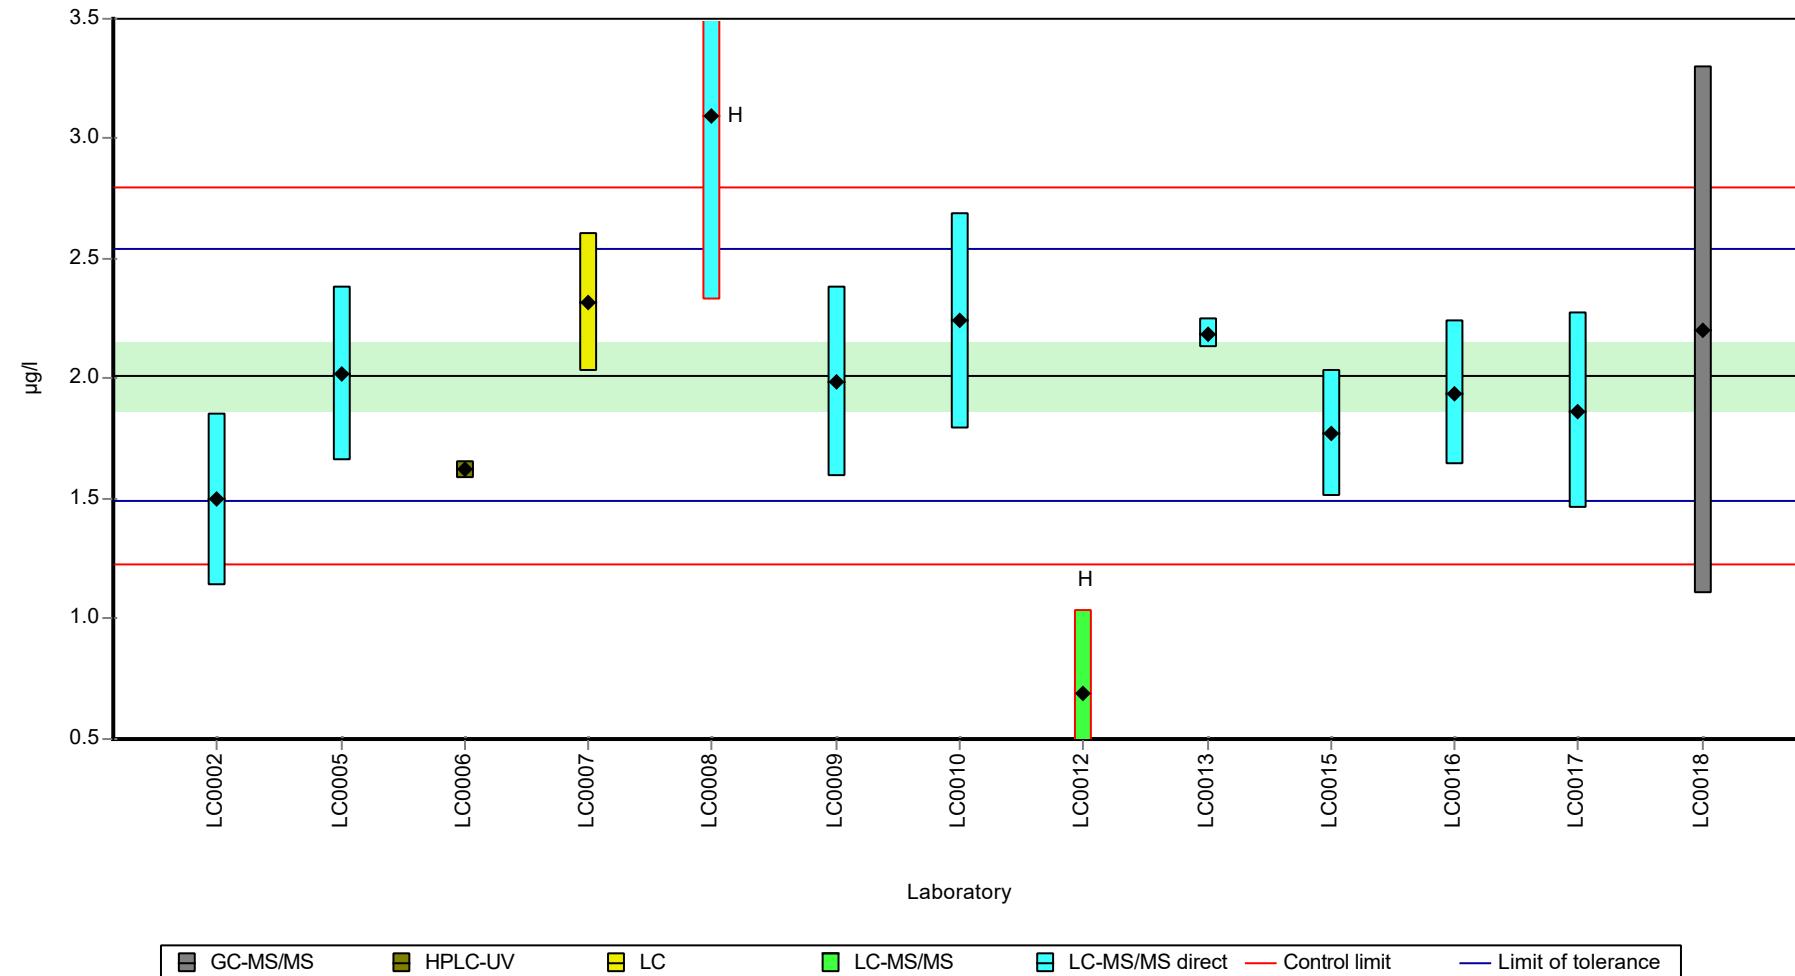


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Propazine

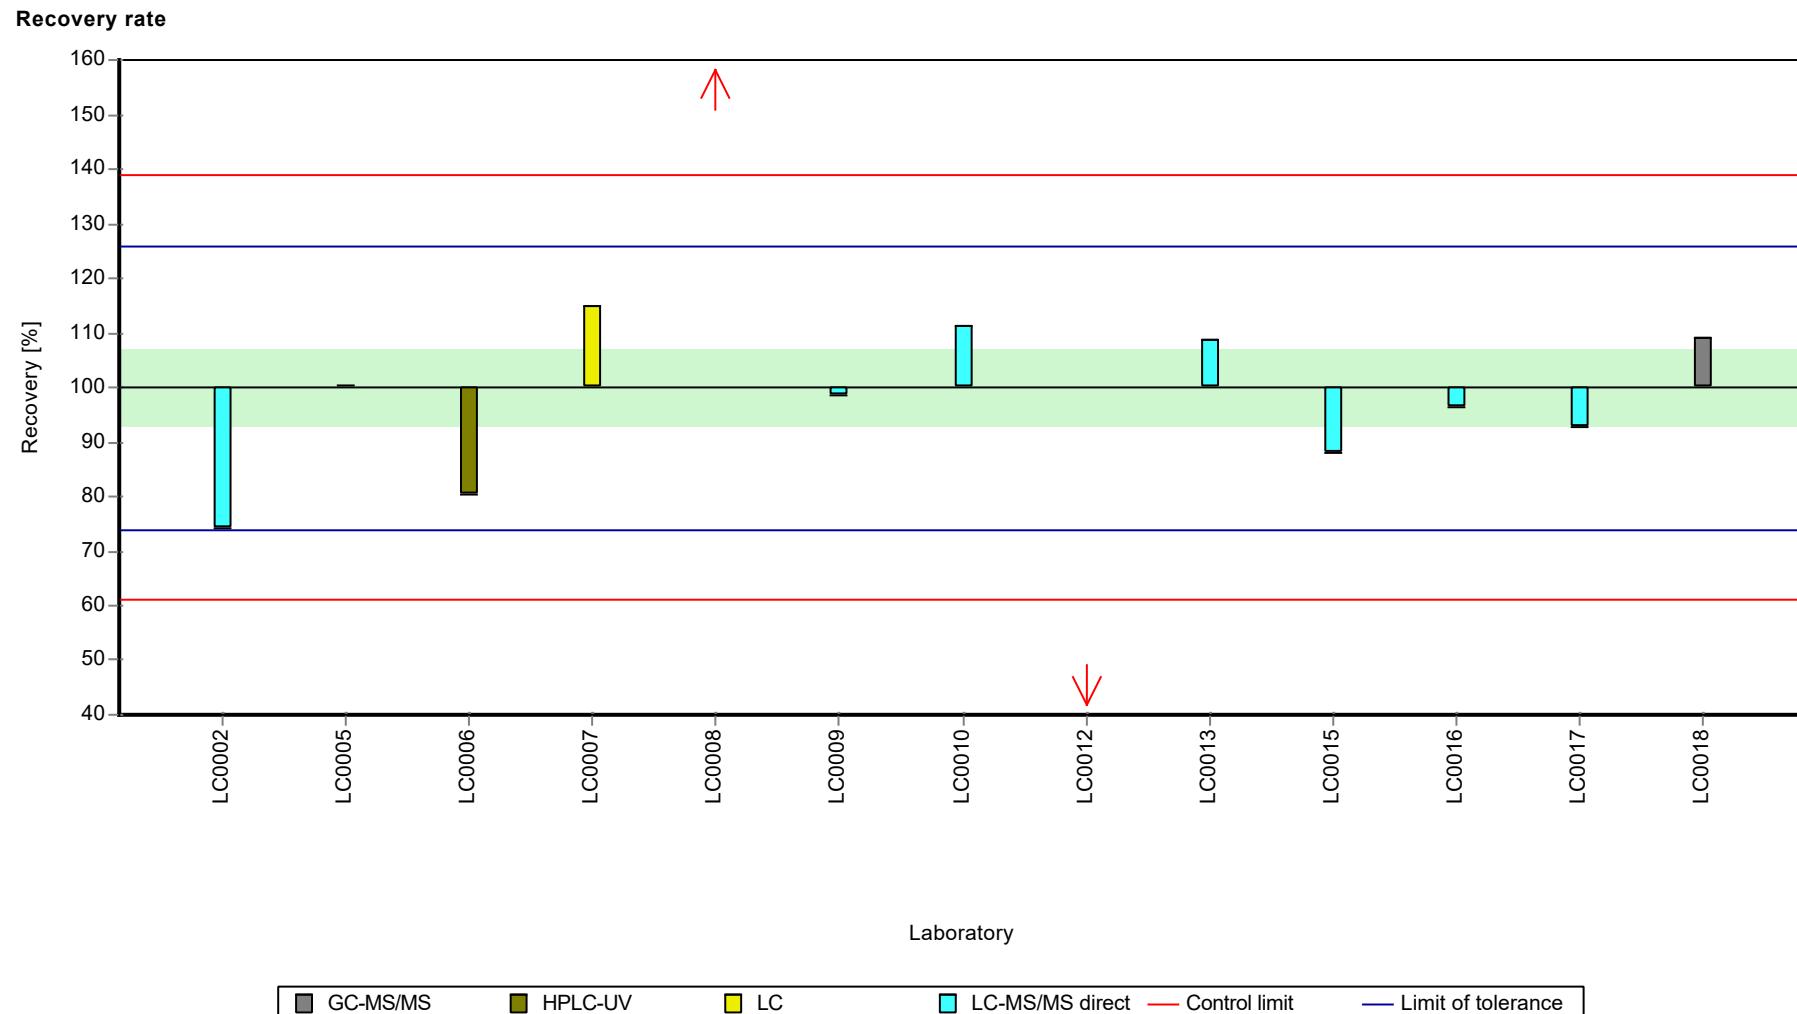

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Propazine

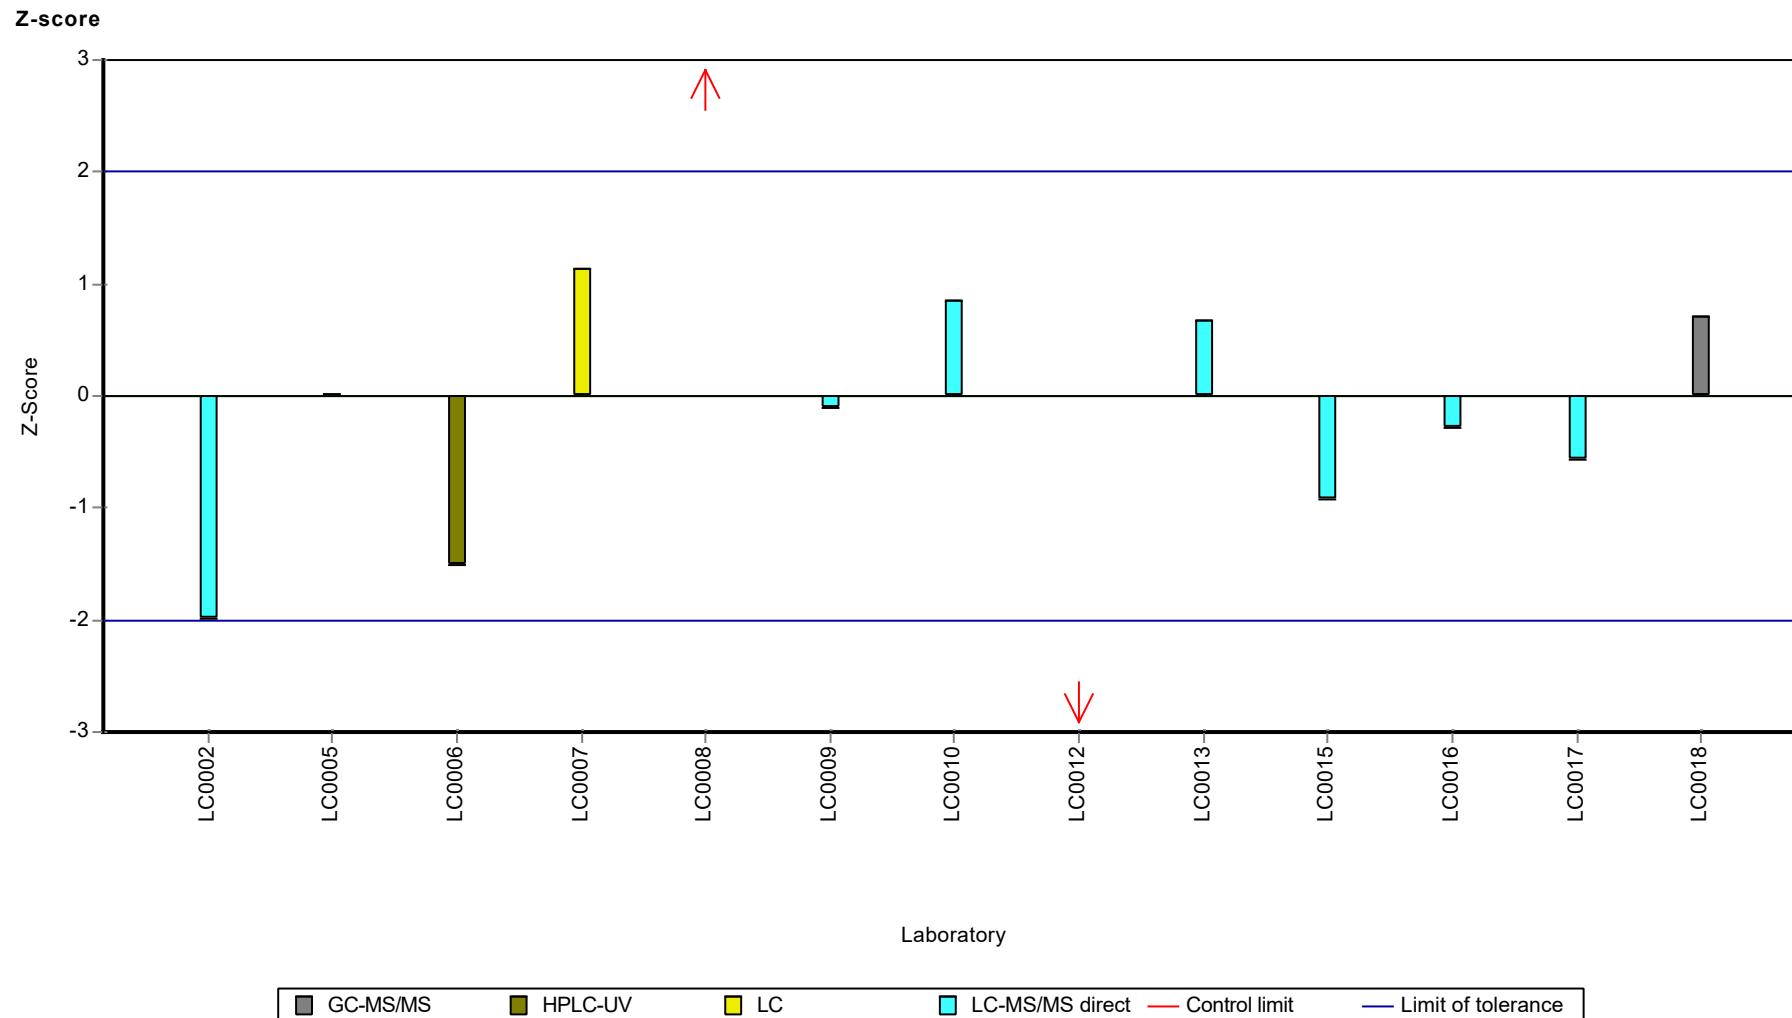

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum Chlordane

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Sum Chlordane

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.0674 ± 0.00891
Criterion	0.0202 (30 %)
Minimum - Maximum	0.054 - 0.083
Control test value ± U (k=2)	0.0774 ± 0.0271

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	0.0582	0.0216	86.4	-0.45	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.076	0.014	113	0.43	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.069	0.014	102	0.08	
LC0008	0.054	0.014	80.2	-0.66	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	-	-	-	-	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.164	0.025	243	4.78	H
LC0016	0.064	0.013	95	-0.17	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.083	0.042	123	0.77	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.0812 ± 0.0429	0.0674 ± 0.0134	µg/l
Minimum	0.054	0.054	µg/l
Maximum	0.164	0.083	µg/l
Standard deviation	0.0379	0.0109	µg/l
rel. standard deviation	46.6	16.2 %	
n	7	6	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum Chlordane


**Graphical presentation of results**

**Results**

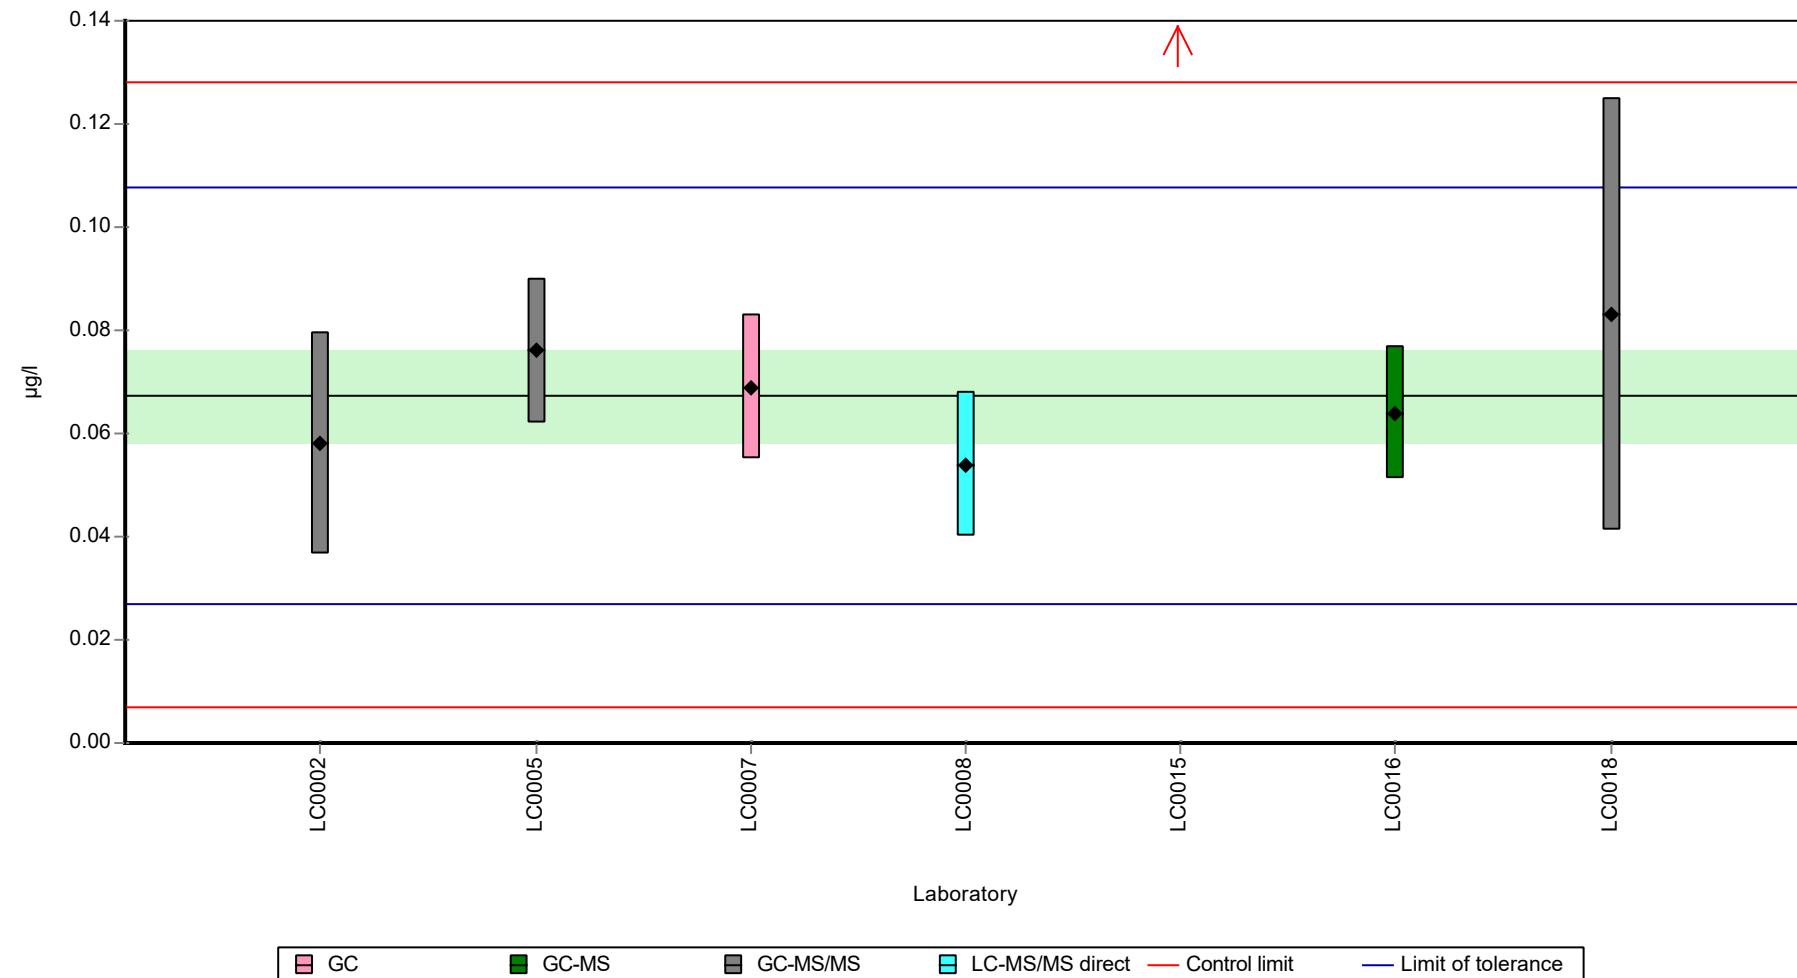


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum Chlordane

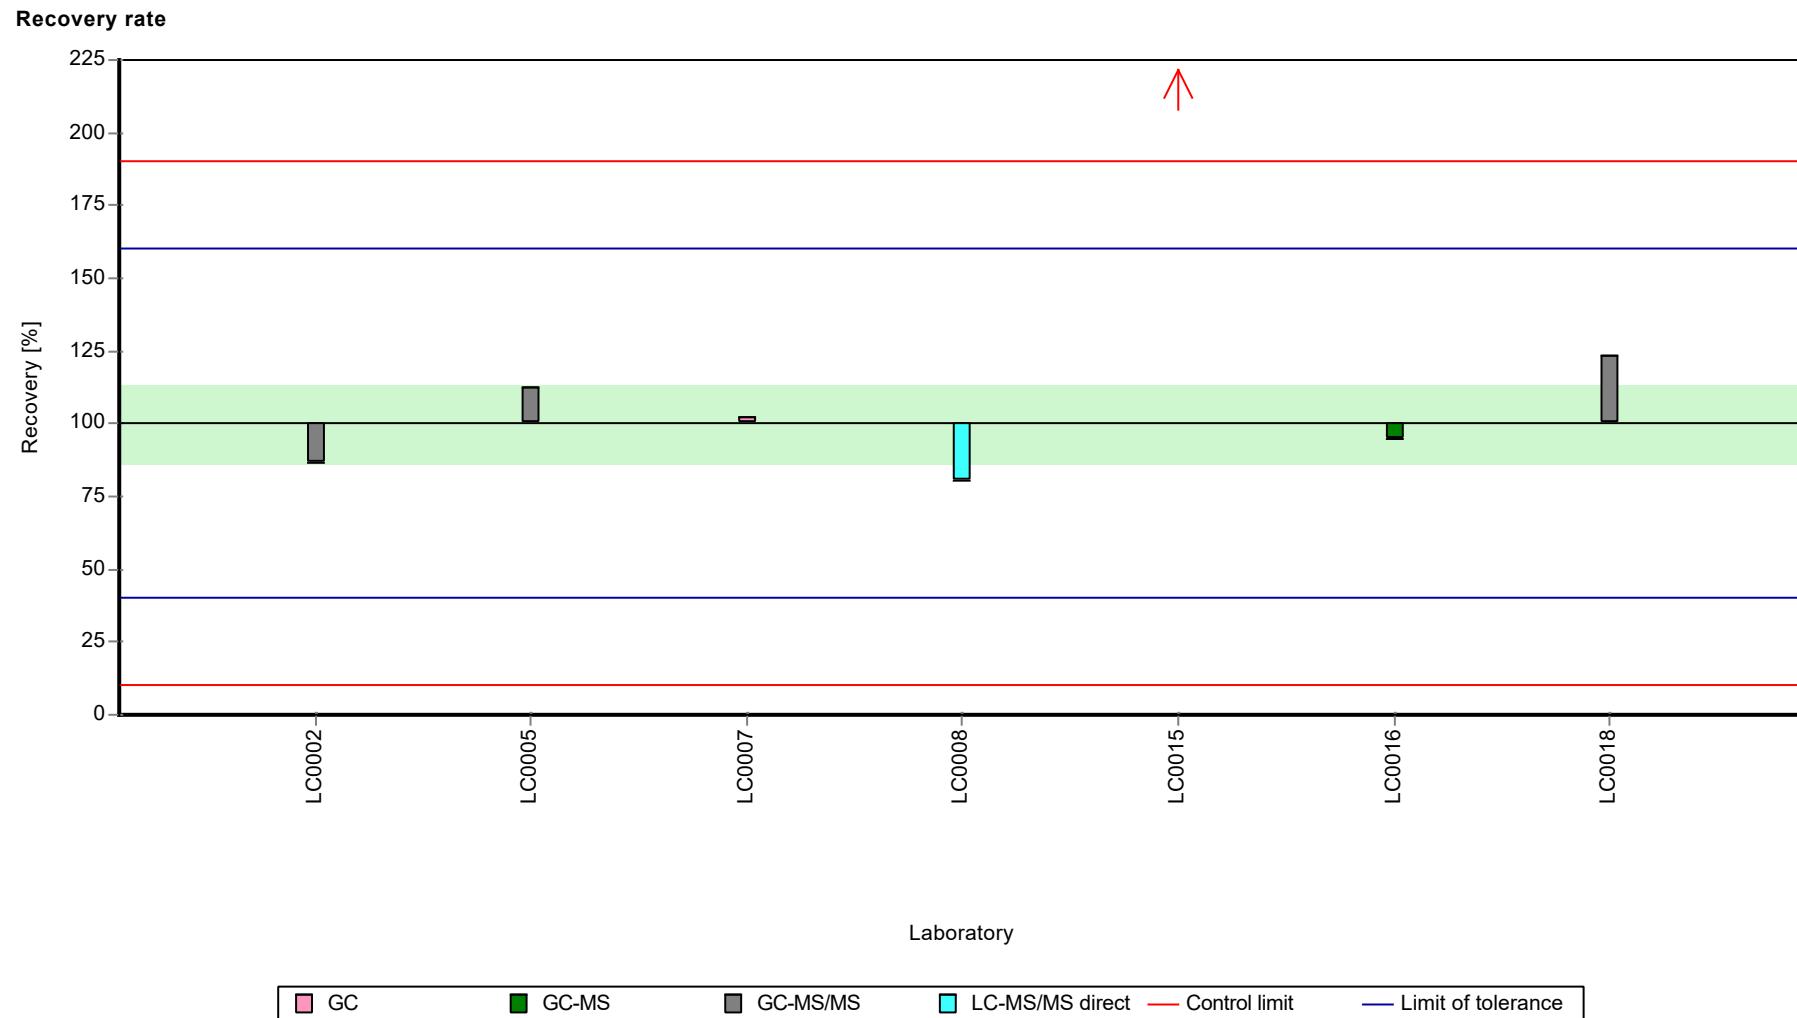

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum Chlordane

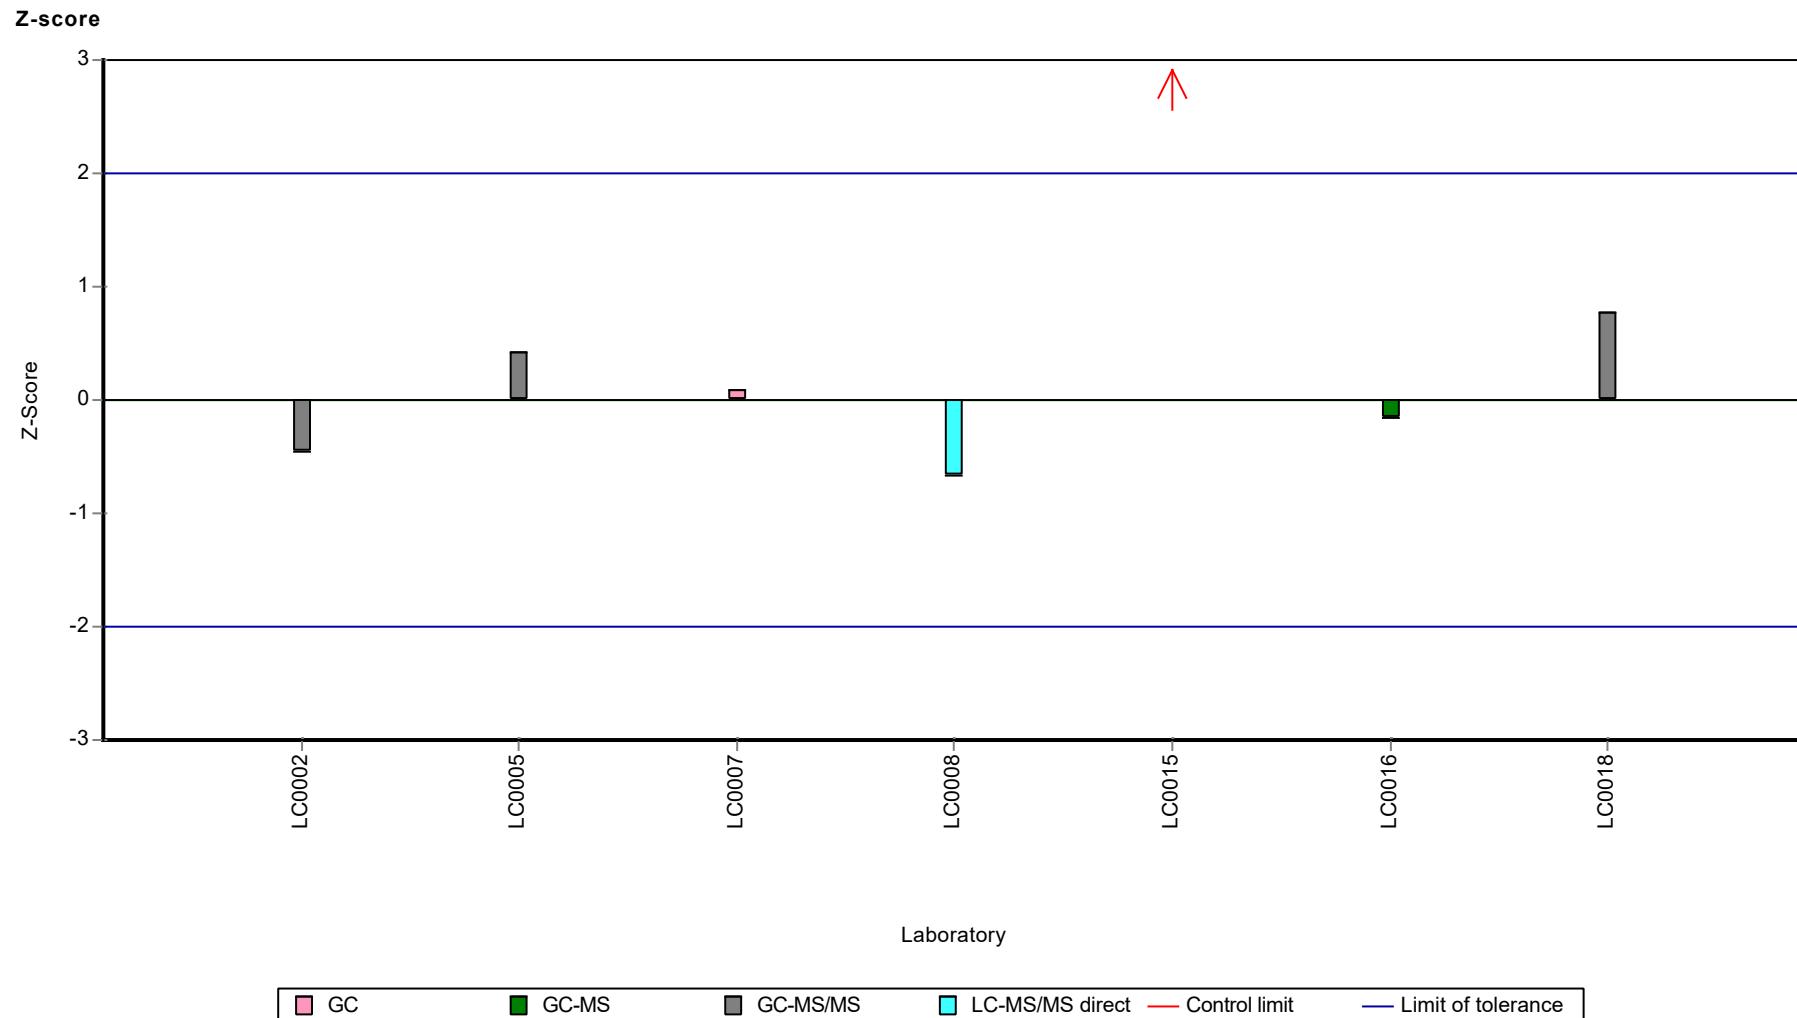

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum Chlordane

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Sum Chlordane

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.639 ± 0.136
Criterion	0.192 (30 %)
Minimum - Maximum	0.291 - 0.83
Control test value ± U (k=2)	0.753 ± 0.263

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	-
LC0002	0.6134	0.2278	96	-0.13	
LC0003	-	-	-	-	-
LC0004	-	-	-	-	-
LC0005	0.753	0.136	118	0.59	
LC0006	-	-	-	-	-
LC0007	0.703	0.141	110	0.33	
LC0008	0.291	0.073	45.5	-1.82	
LC0009	-	-	-	-	-
LC0010	-	-	-	-	-
LC0011	-	-	-	-	-
LC0012	-	-	-	-	-
LC0013	-	-	-	-	-
LC0014	-	-	-	-	-
LC0015	0.742	0.111	116	0.54	
LC0016	0.541	0.11	84.7	-0.51	
LC0017	-	-	-	-	-
LC0018	0.83	0.415	130	1	
LC0019	-	-	-	-	-

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.639 ± 0.205	0.639 ± 0.205	µg/l
Minimum	0.291	0.291	µg/l
Maximum	0.83	0.83	µg/l
Standard deviation	0.181	0.181	µg/l
rel. standard deviation	28.2	28.2	%
n	7	7	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum Chlordane


**Graphical presentation of results**

**Results**

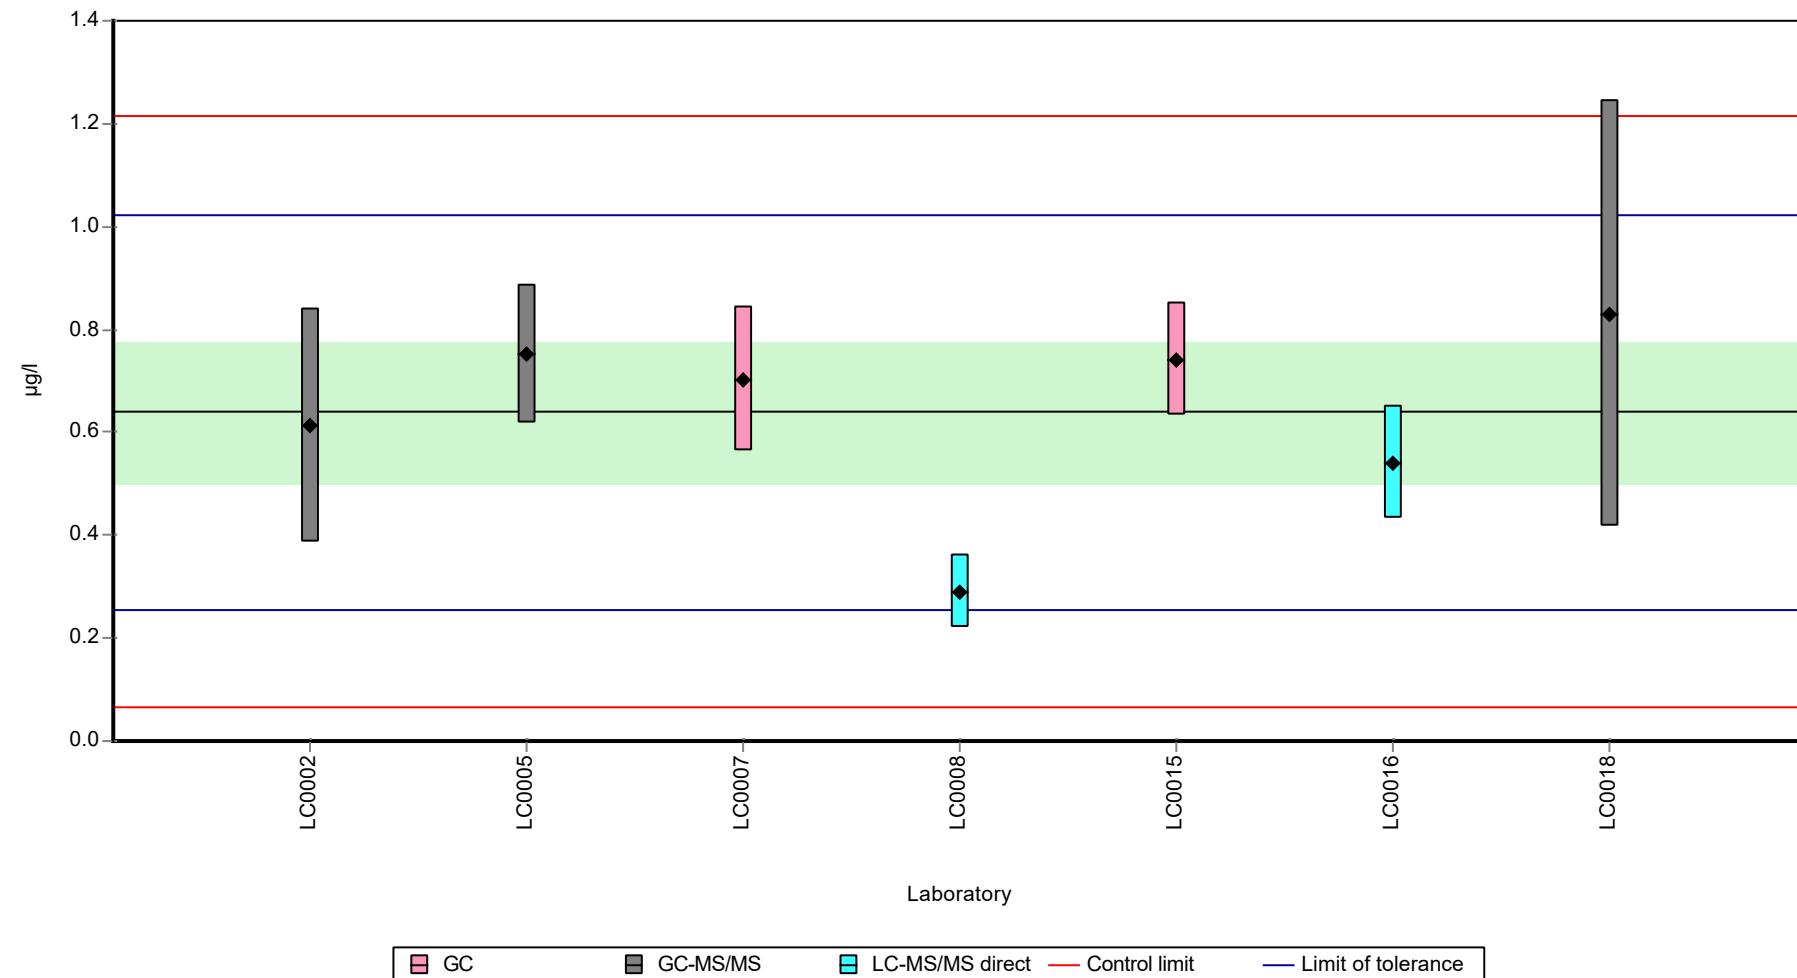


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum Chlordane

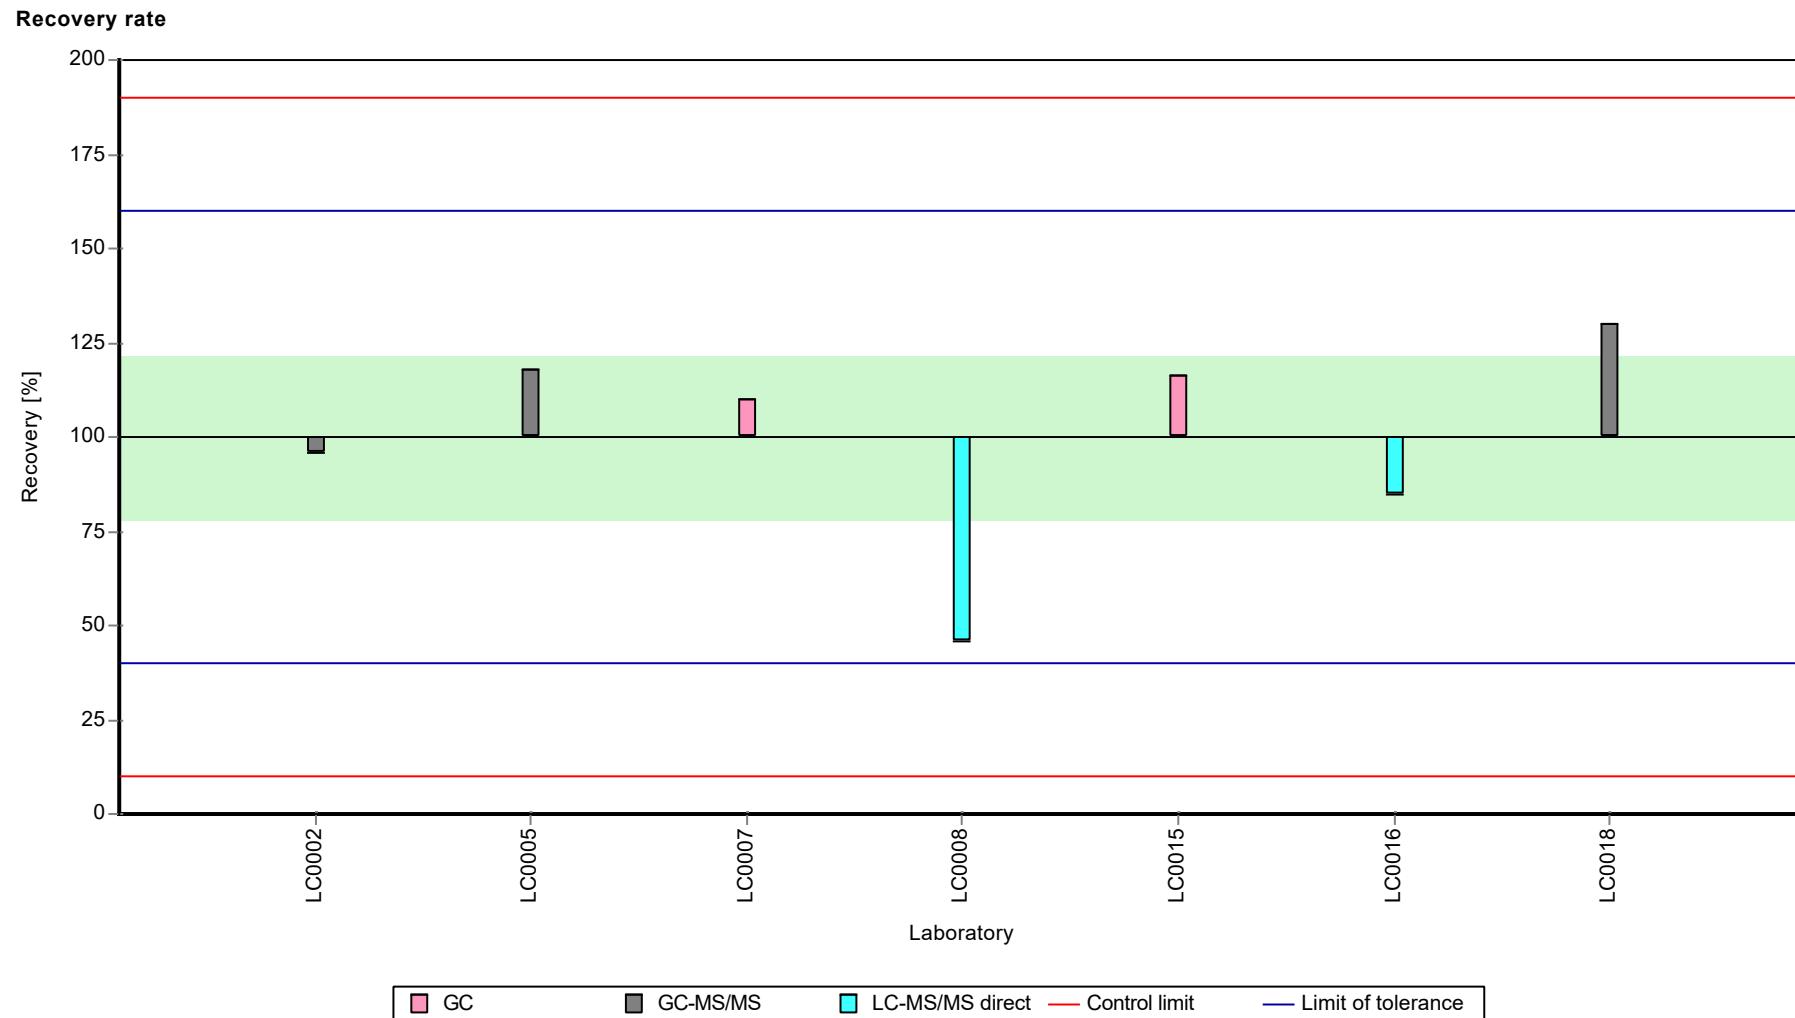

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum Chlordane

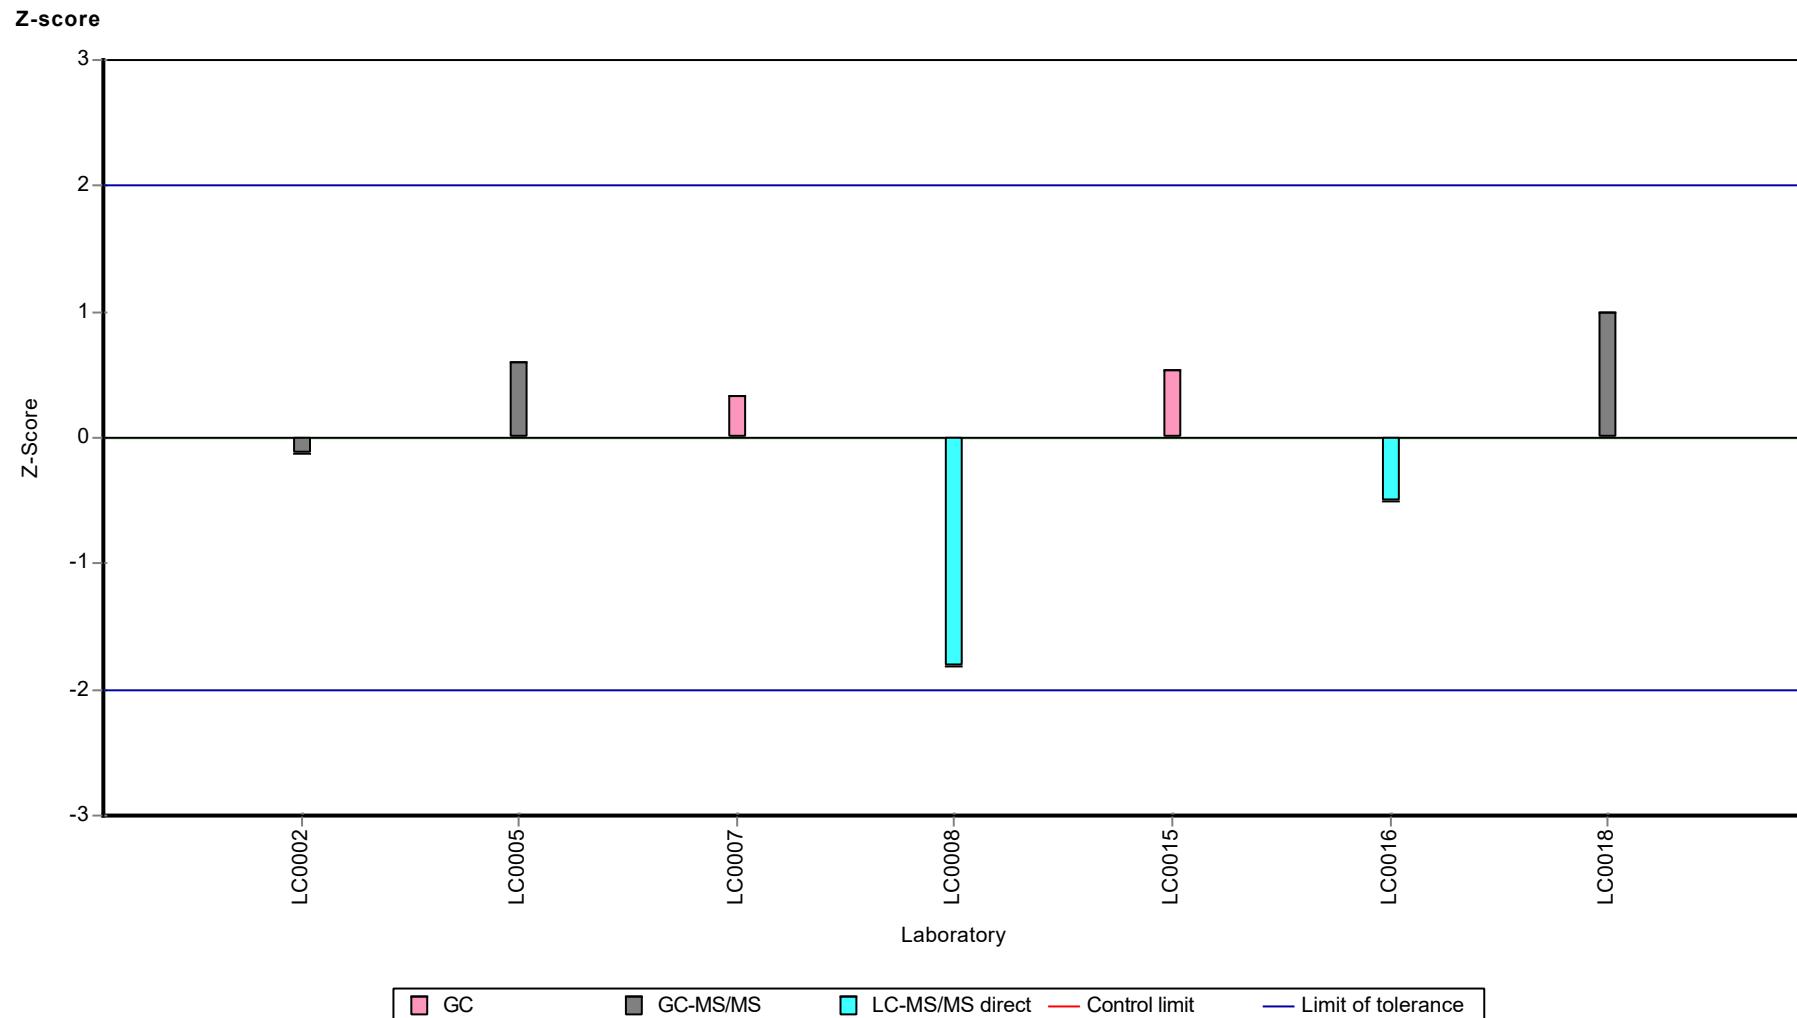

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDD

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Sum DDD

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.251 ± 0.0259
Criterion	0.0752 (30 %)
Minimum - Maximum	0.208 - 0.293
Control test value ± U (k=2)	0.2940 ± 0.0882

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.293	0.053	117	0.56	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.231	0.046	92.2	-0.26	
LC0008	0.279	0.07	111	0.38	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.219	0.11	87.4	-0.42	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	-	-	-	-	
LC0016	0.284	0.057	113	0.44	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.24	0.12	95.8	-0.14	
LC0019	0.2081	0.031	83	-0.57	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.251 ± 0.0388	0.251 ± 0.0388	µg/l
Minimum	0.208	0.208	µg/l
Maximum	0.293	0.293	µg/l
Standard deviation	0.0342	0.0342	µg/l
rel. standard deviation	13.7	13.7 %	
n	7	7	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDD


**Graphical presentation of results**

**Results**

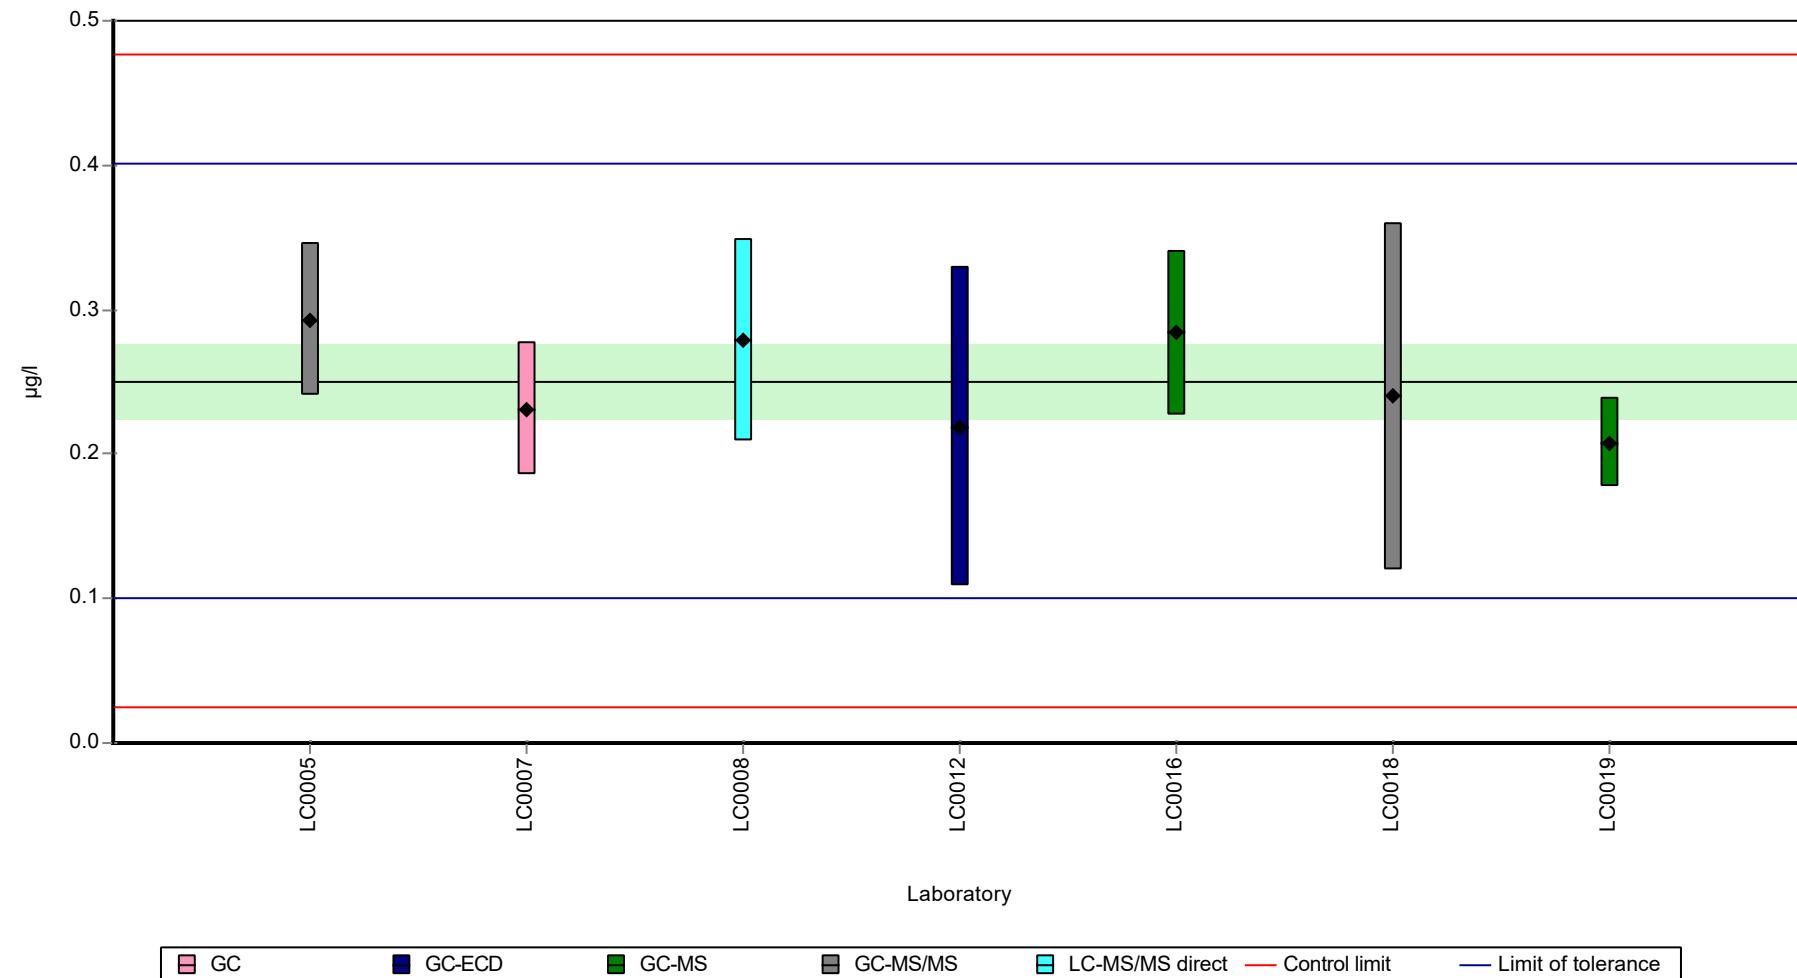


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDD

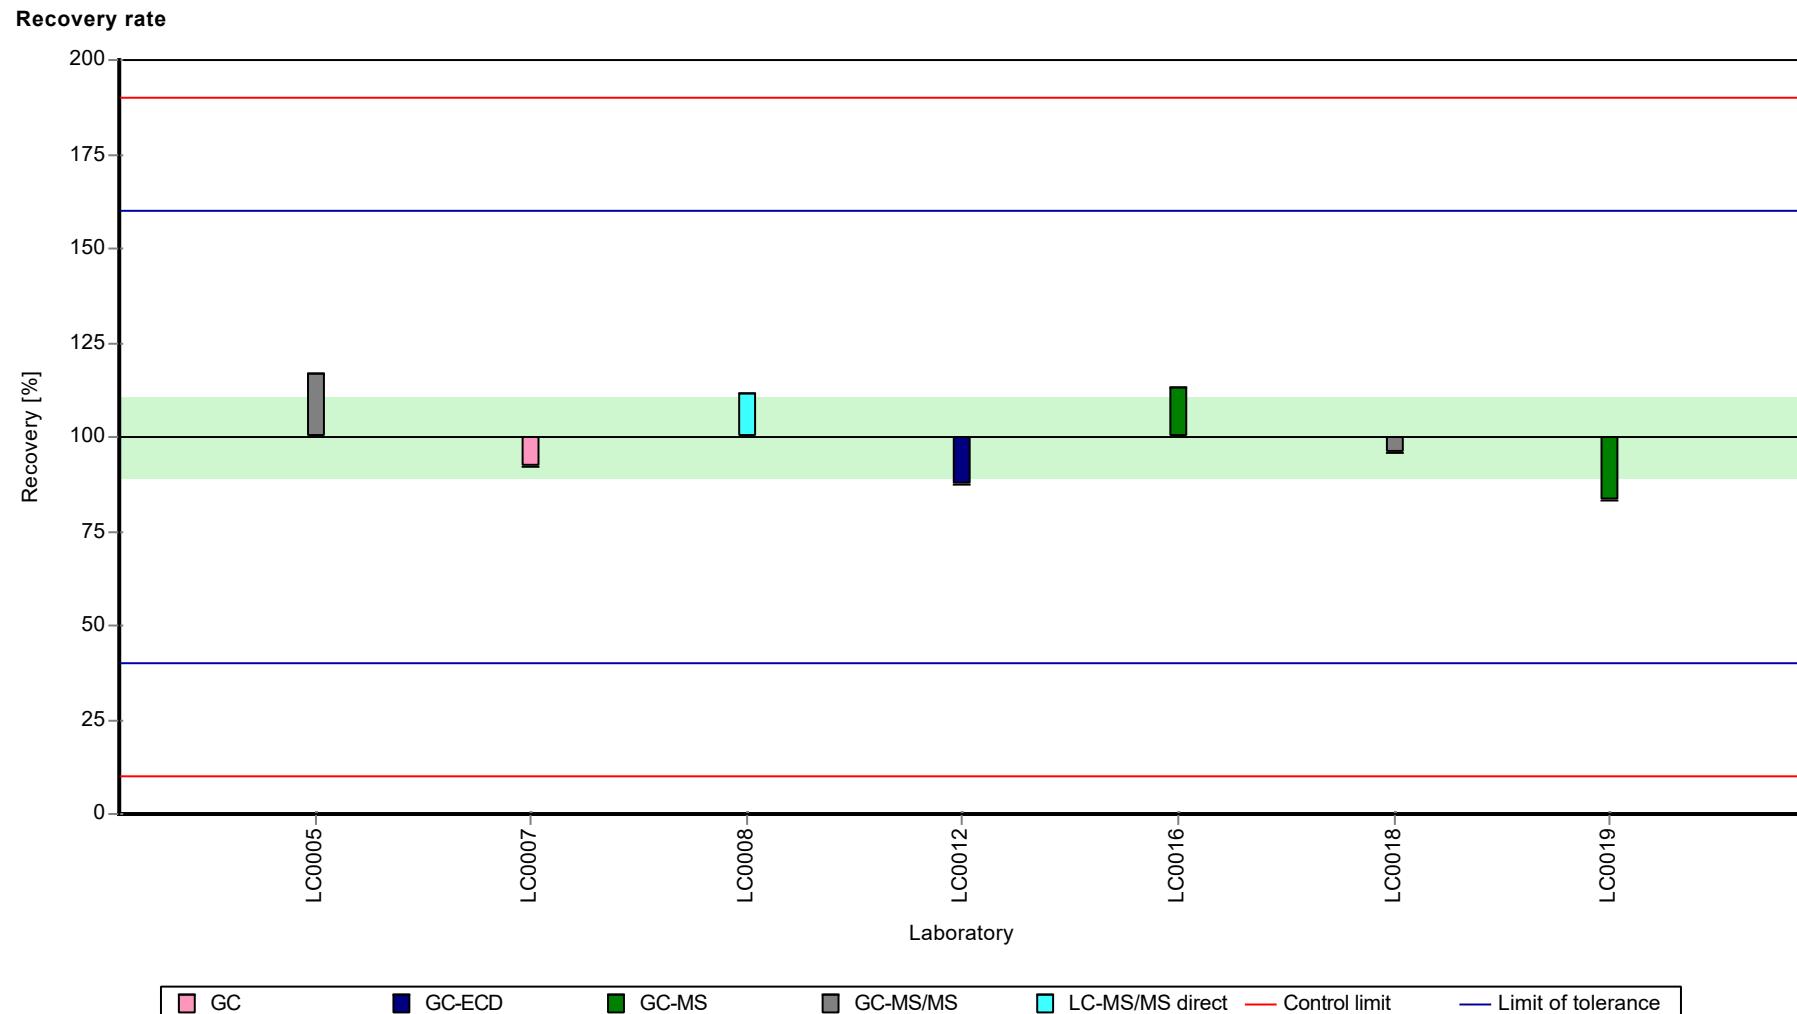

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDD

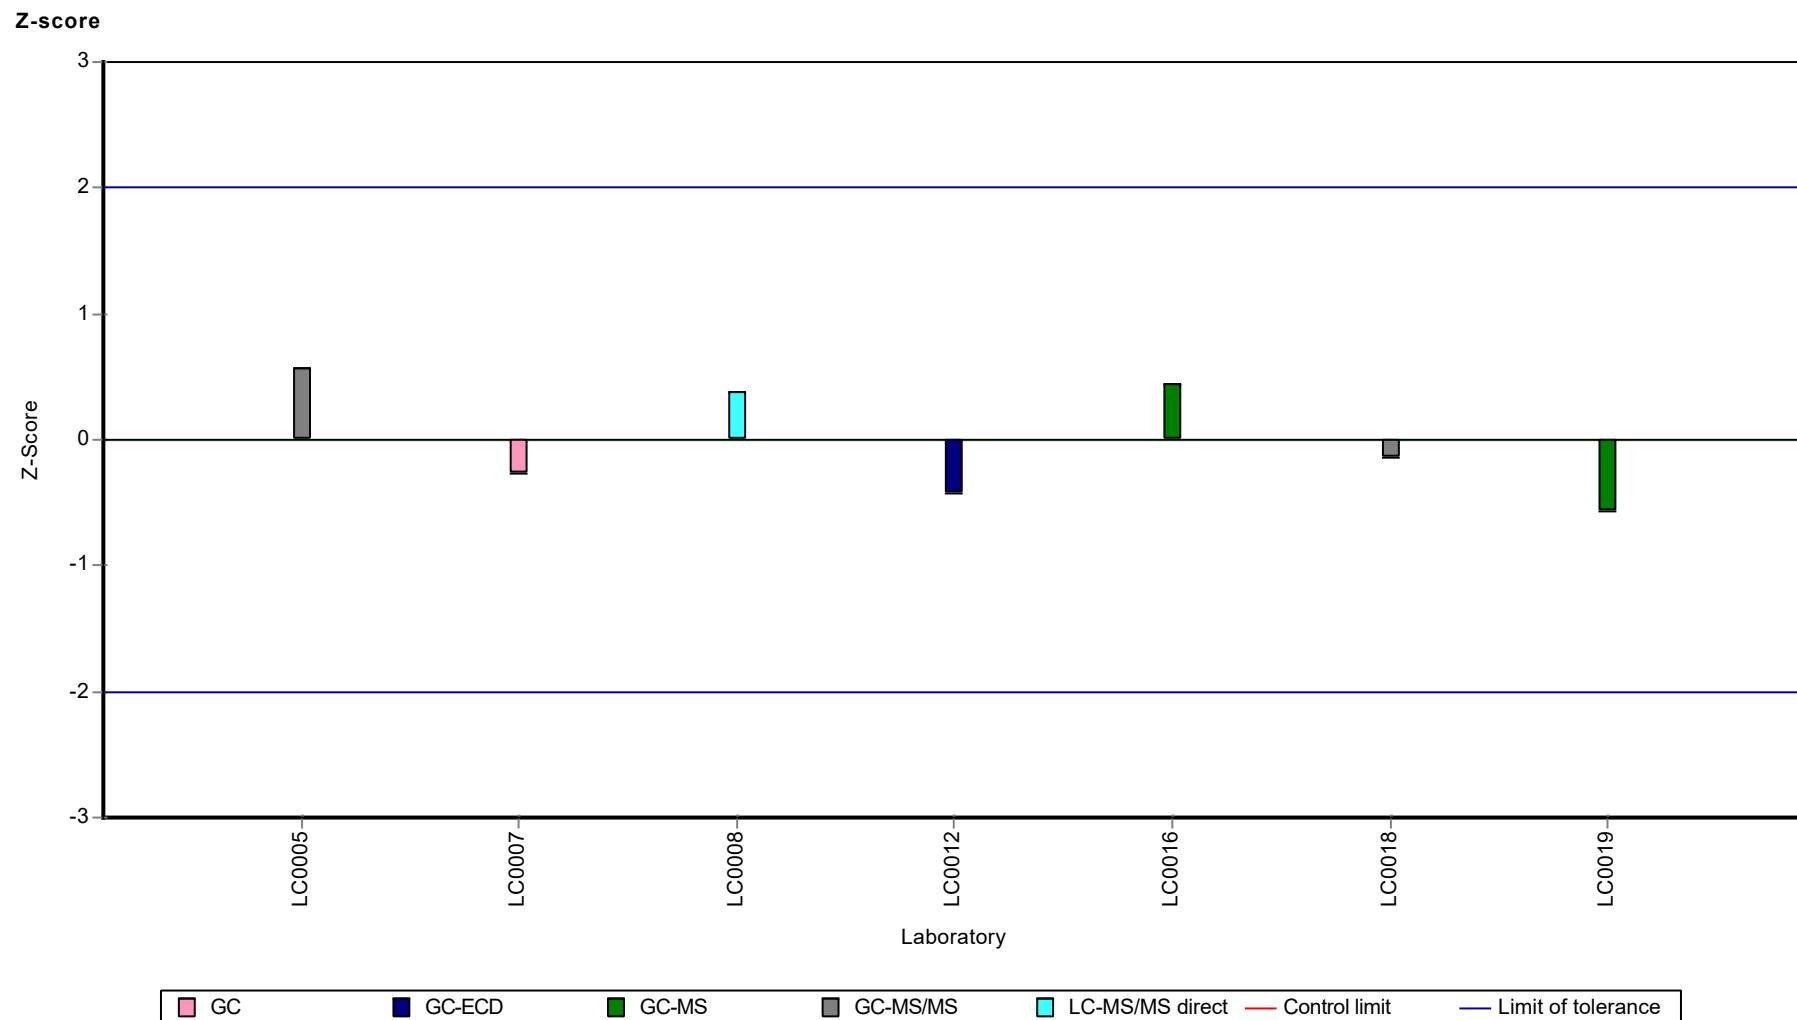

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum DDD

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Sum DDD

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.623 ± 0.105
Criterion	0.187 (30 %)
Minimum - Maximum	0.435 - 0.822
Control test value ± U (k=2)	0.813 ± 0.244

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.822	0.148	132	1.06	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.669	0.134	107	0.25	
LC0008	0.641	0.16	103	0.1	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.079	0.04	12.7	-2.91	H
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	-	-	-	-	
LC0016	0.623	0.13	100	0	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.435	0.218	69.8	-1.01	
LC0019	0.5488	0.082	88.1	-0.4	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.545 ± 0.269	0.623 ± 0.158	µg/l
Minimum	0.079	0.435	µg/l
Maximum	0.822	0.822	µg/l
Standard deviation	0.237	0.129	µg/l
rel. standard deviation	43.4	20.7 %	
n	7	6	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum DDD


**Graphical presentation of results**

**Results**

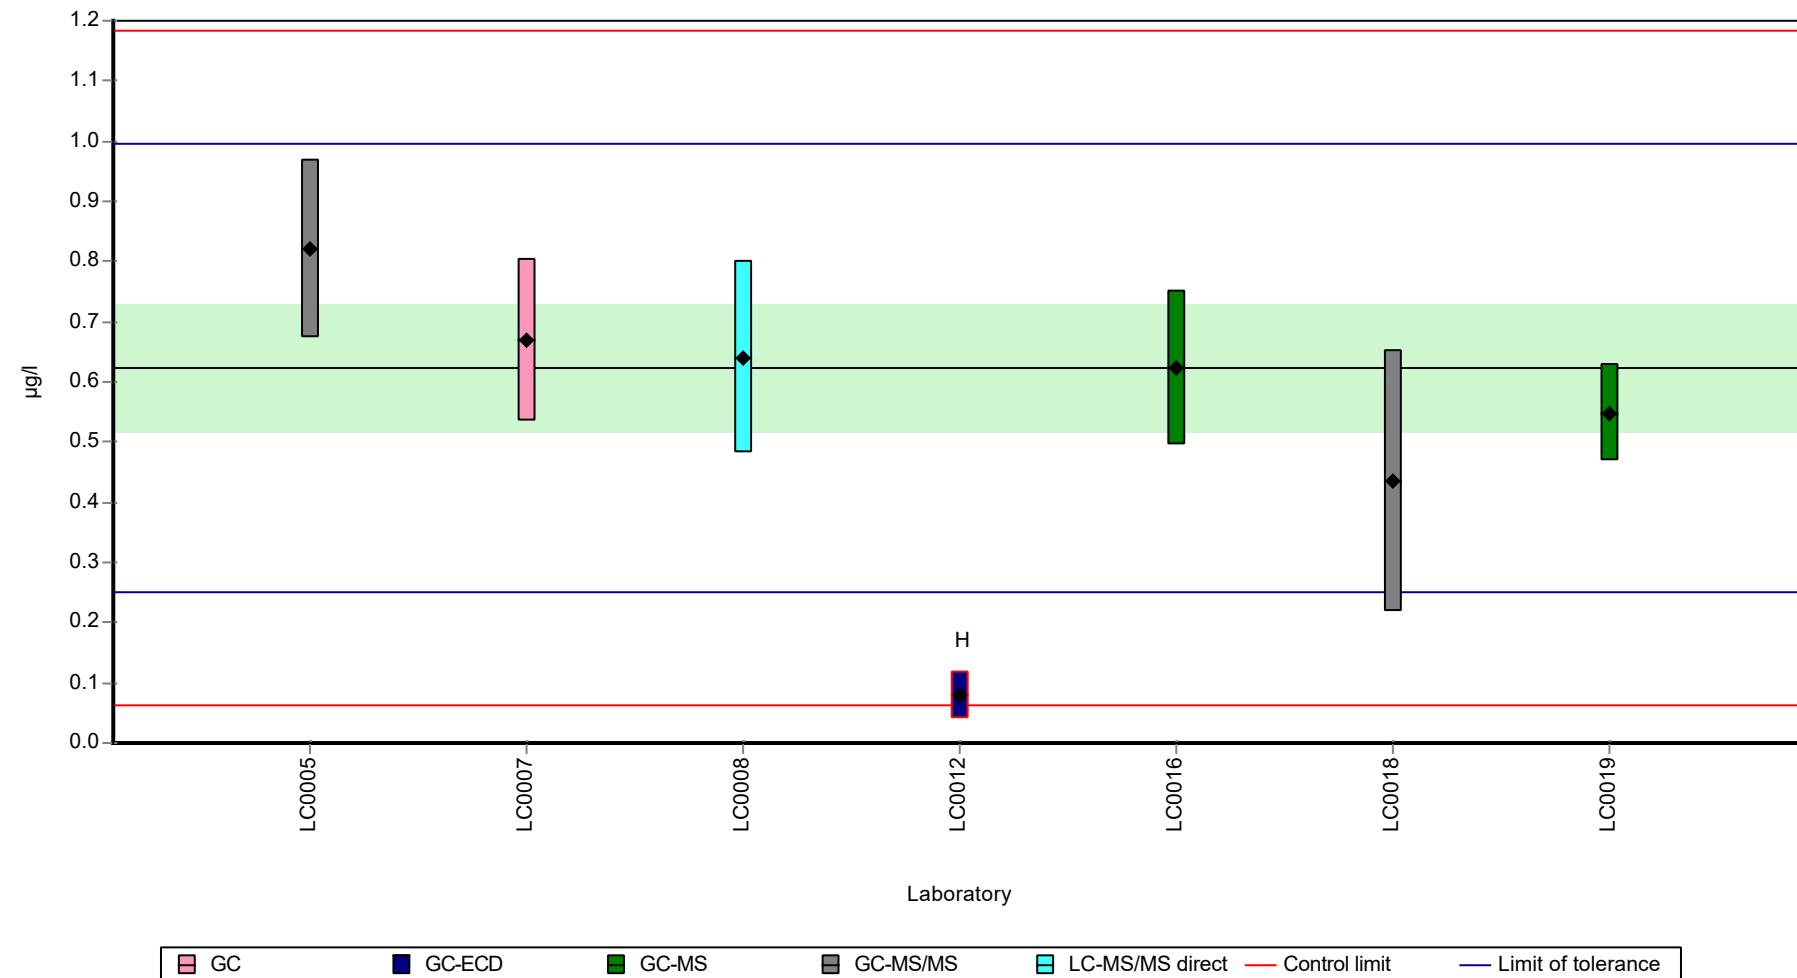


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum DDD

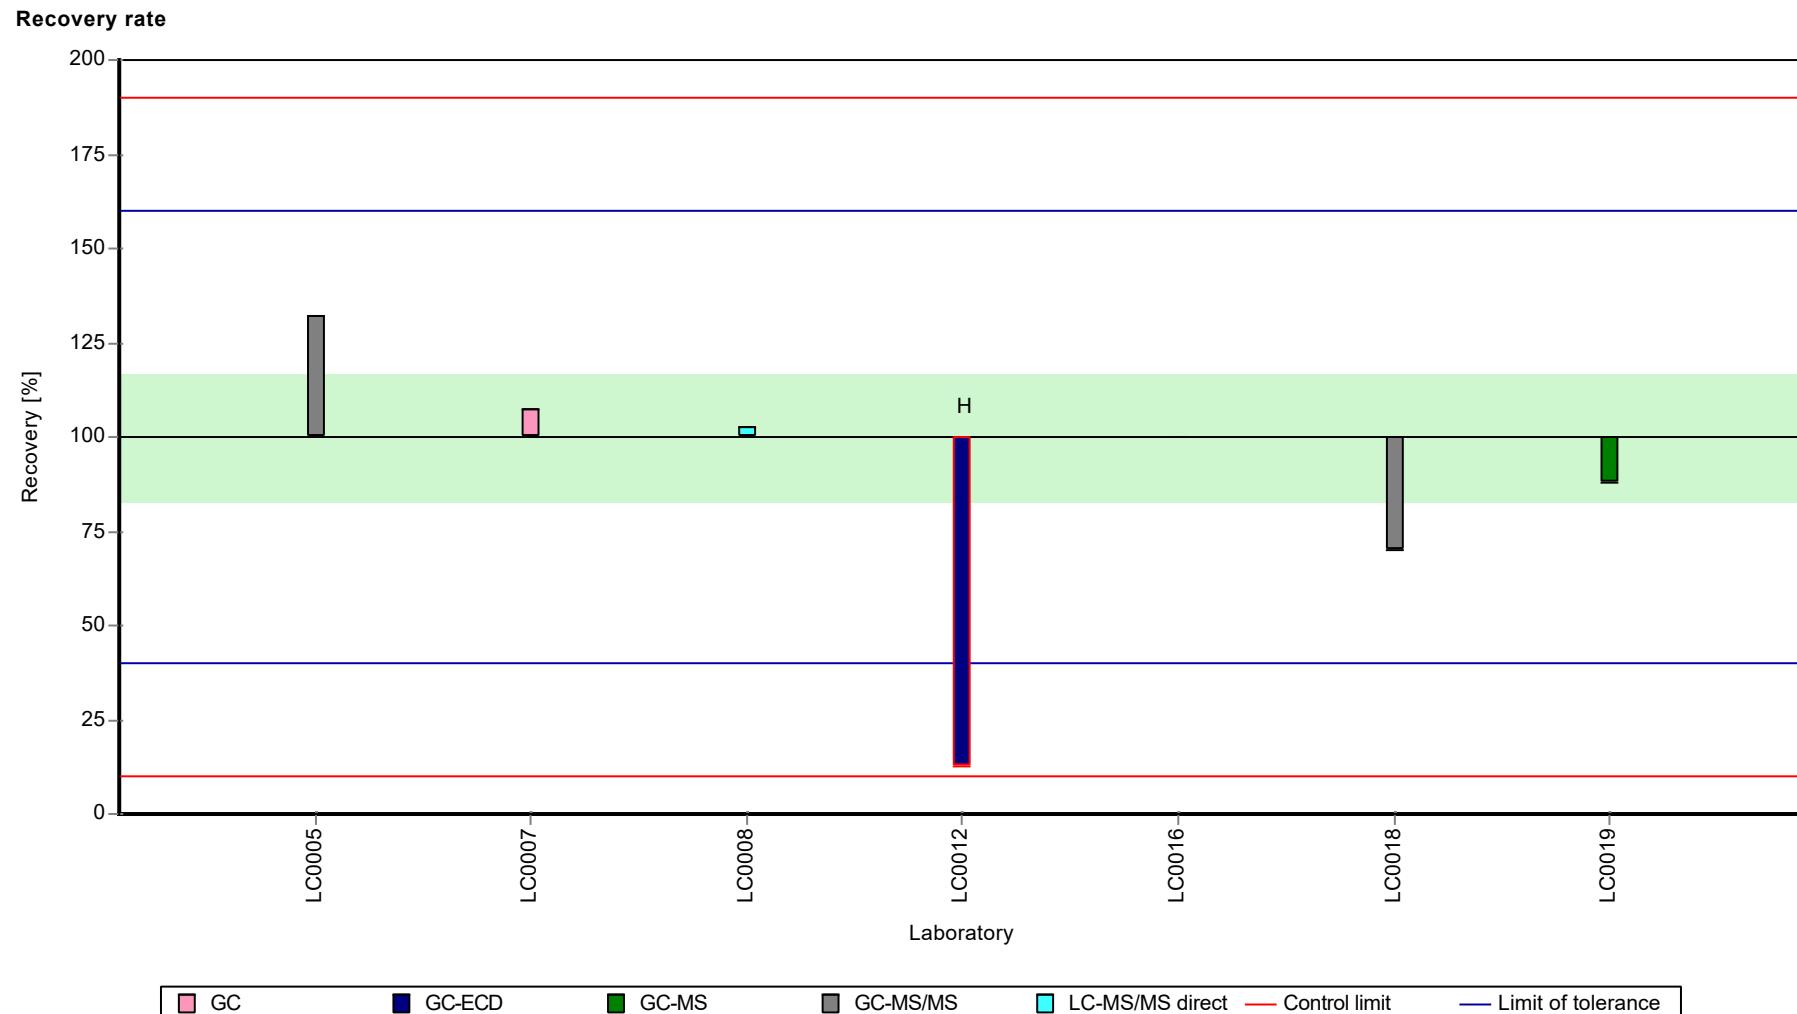

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum DDD

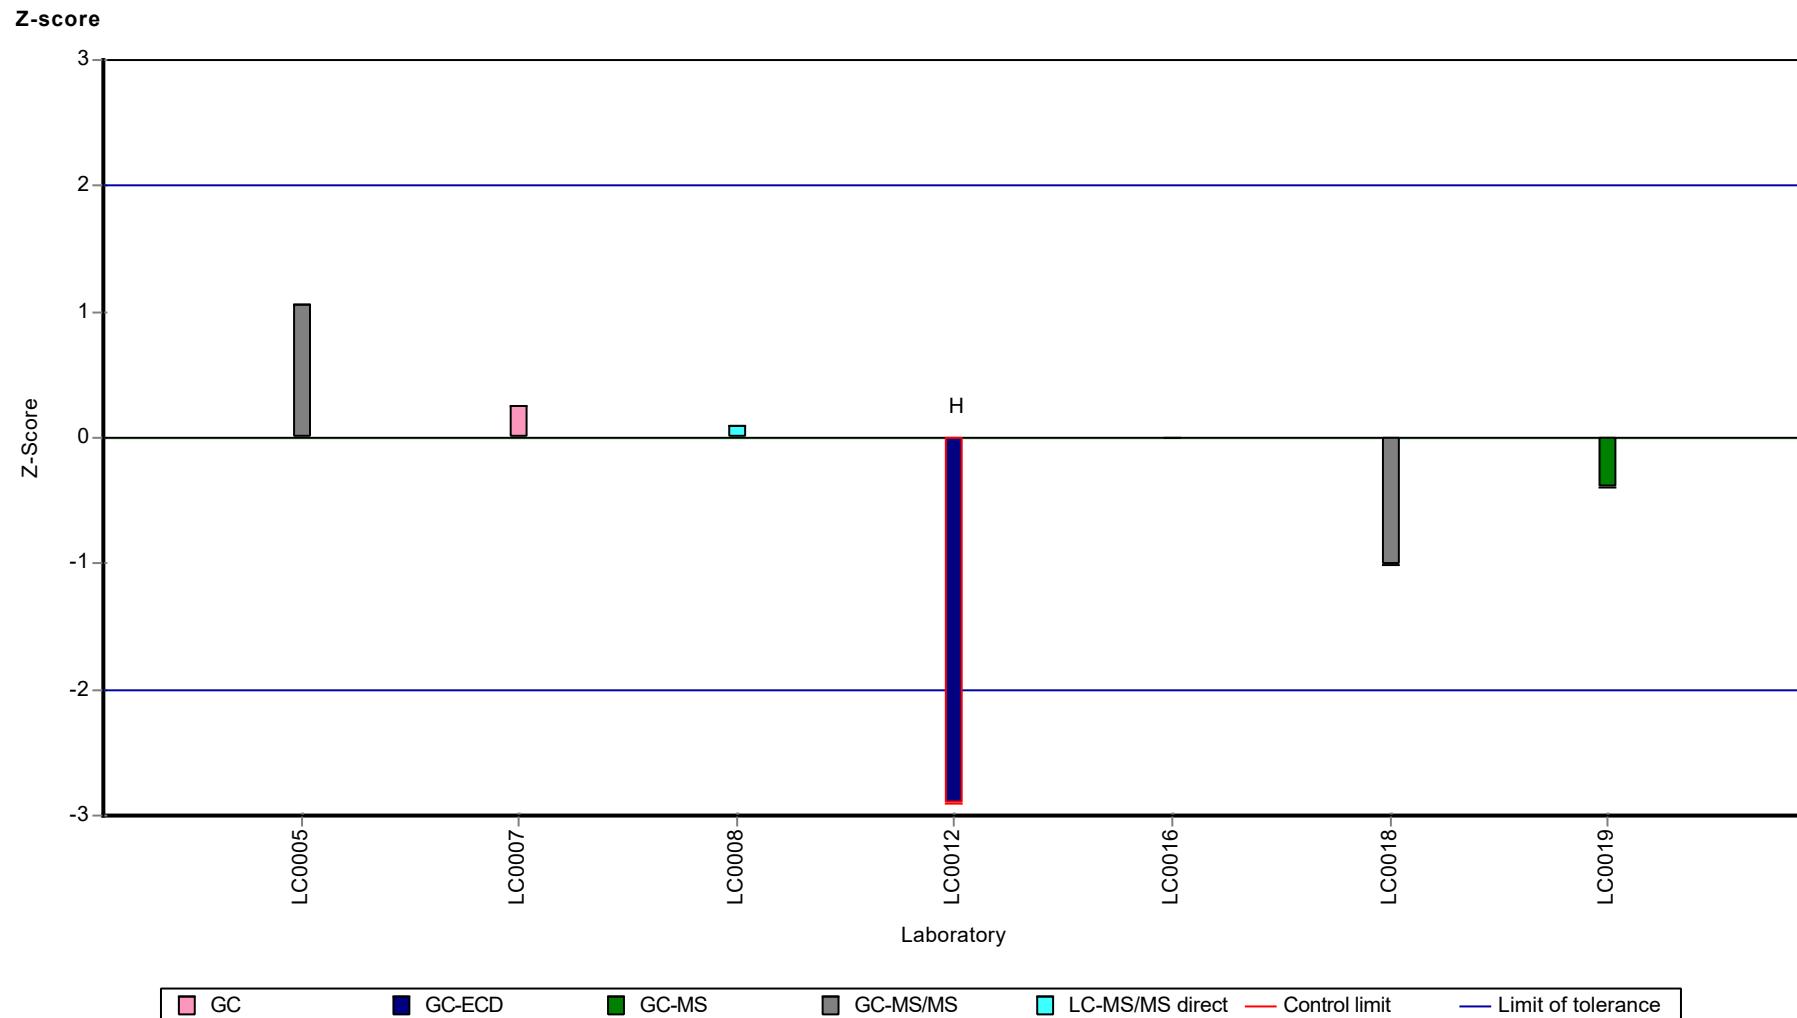

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDE

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Sum DDE

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.233 ± 0.0583
Criterion	0.0769 (33 %)
Minimum - Maximum	0.091 - 0.328
Control test value ± U (k=2)	0.3770 ± 0.113

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	0.2646	0.1002	114	0.41	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.328	0.059	141	1.24	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.273	0.055	117	0.52	
LC0008	0.183	0.046	78.6	-0.65	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.091	0.046	39.1	-1.85	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.486	0.073	209	3.29	H
LC0016	0.264	0.053	113	0.4	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.27	0.135	116	0.48	
LC0019	0.2216	0.033	95.1	-0.15	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.265 ± 0.107	0.237 ± 0.0767	µg/l
Minimum	0.091	0.091	µg/l
Maximum	0.486	0.328	µg/l
Standard deviation	0.107	0.0723	µg/l
rel. standard deviation	40.5	30.5 %	
n	9	8	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDE


**Graphical presentation of results**

**Results**

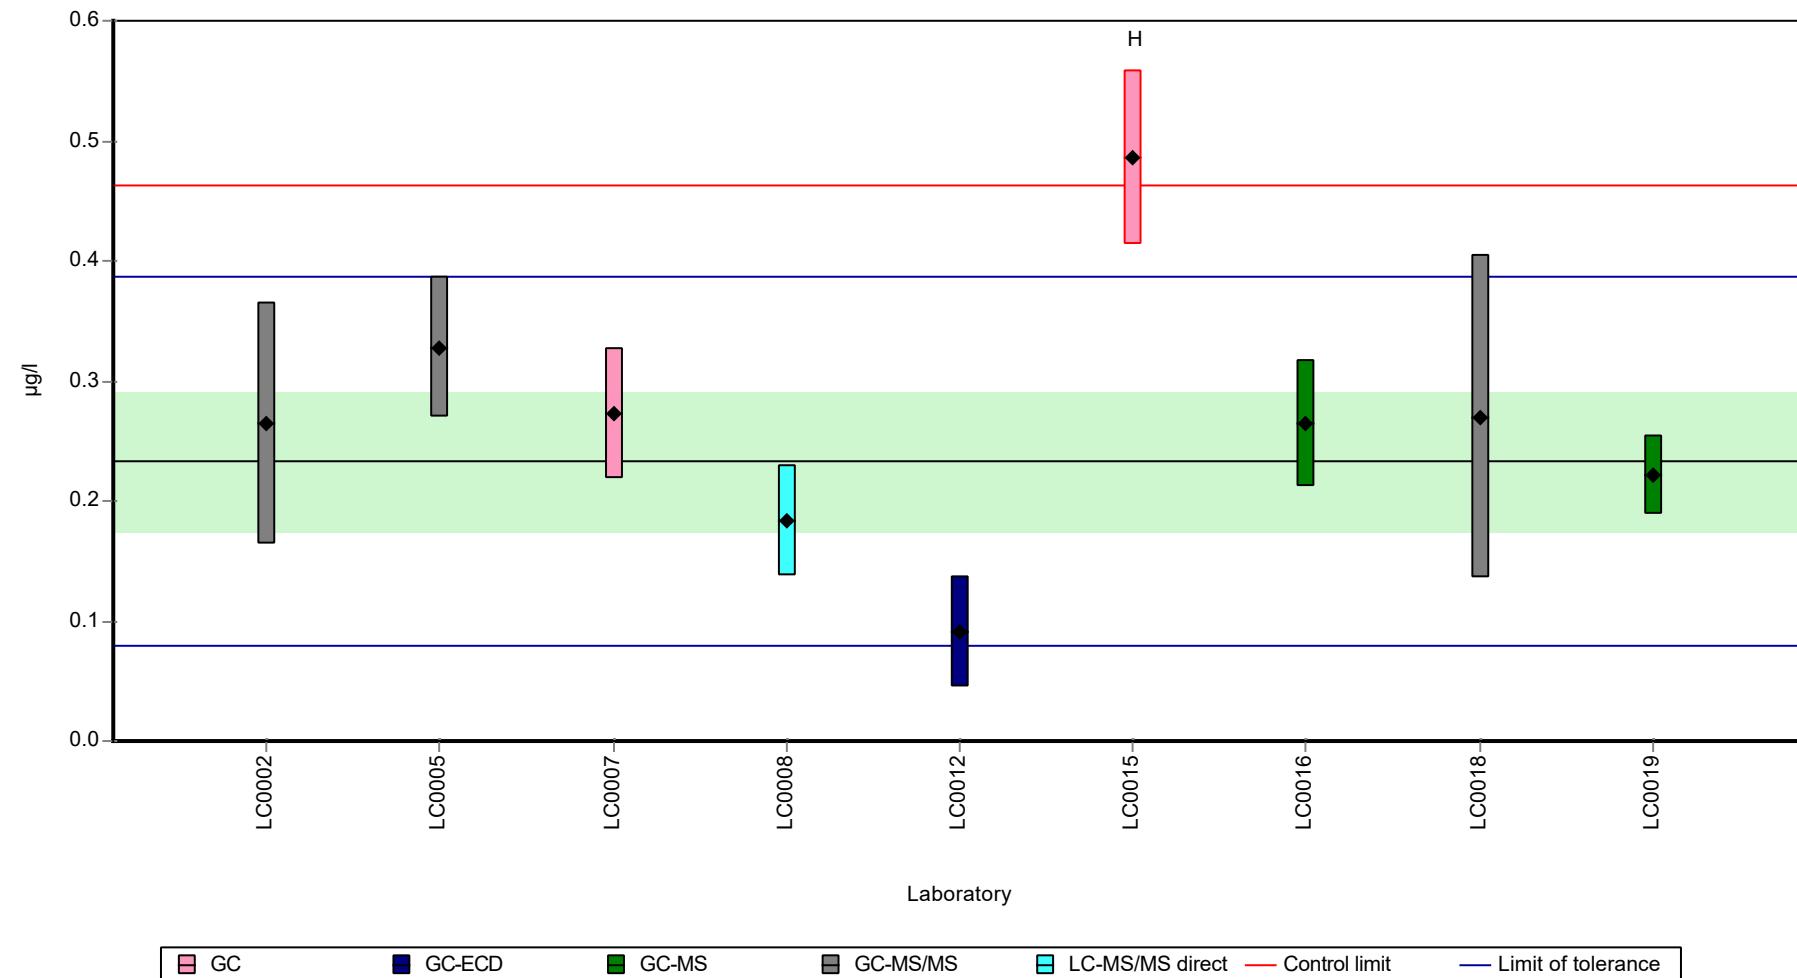


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDE

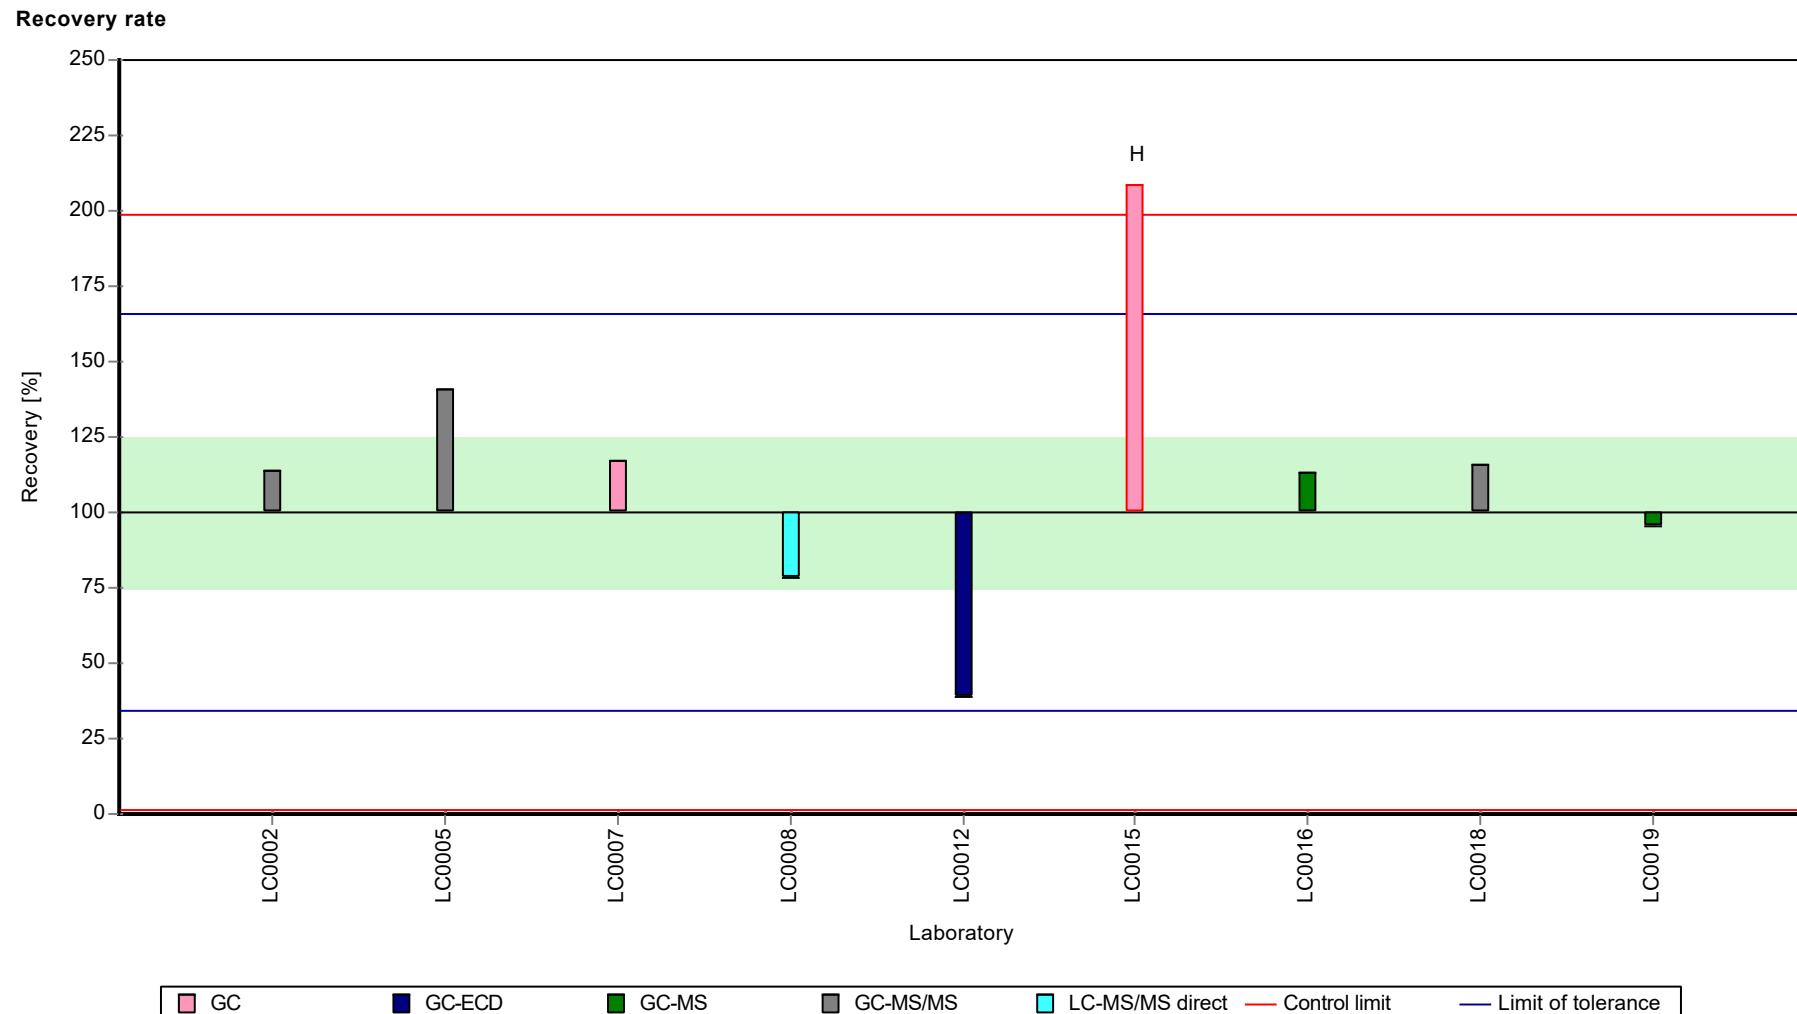

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDE

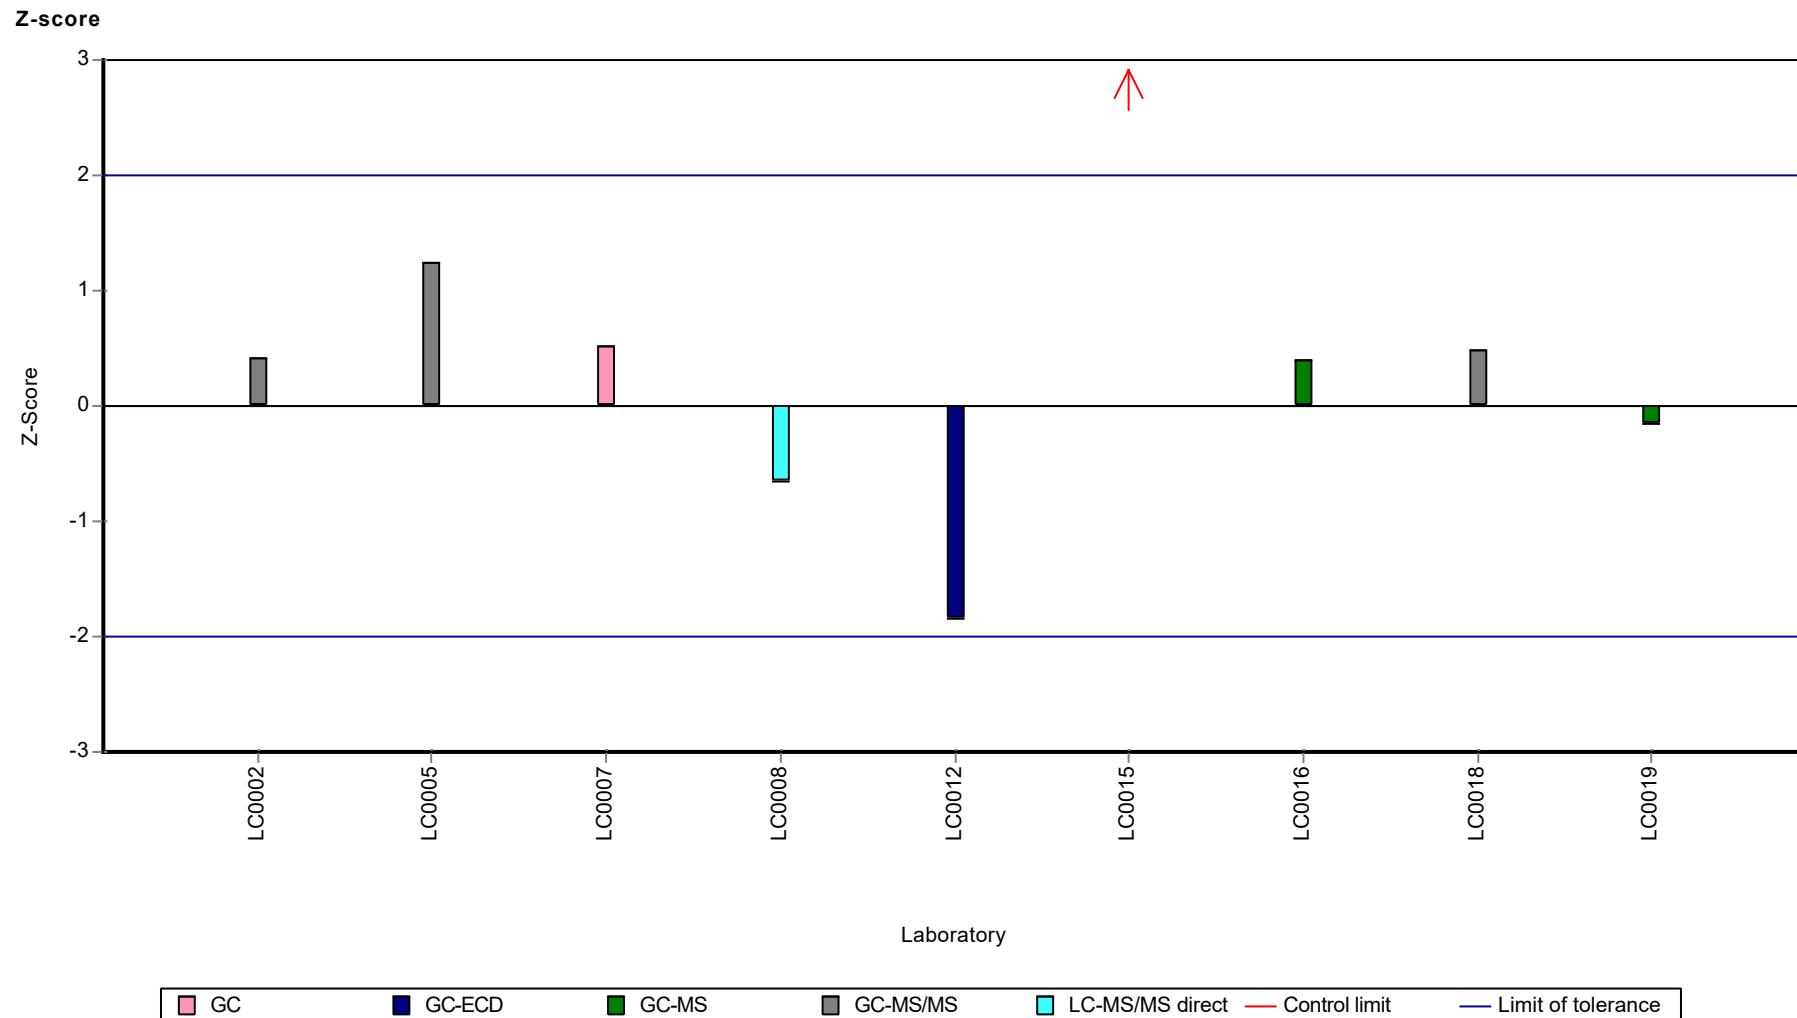

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum DDE

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Sum DDE

Unit	µg/l	Information zur Auswertung: Die Streuung der ausreißerbereinigten Messergebnisse der akkreditierten, teilnehmenden Labore lag bei >50 %. Aus diesem Grund konnte kein zugewiesener Wert festgelegt werden. Für diesen Parameter empfehlen wir einen Vergleich mit dem rein informativen Mittelwert aus der Gruppe der akkreditierten Laborergebnisse: 0.423 +/- 0.177 U(k=2) µg/l
Assigned value ± U (k=2)	-	
Criterion	-	Information for evaluation: The relative reproducibility standard deviation of the results within group of accredited participating laboratories after outlier elimination was >50 %. Therefore, no assigned value could be defined.
Minimum - Maximum	0.017 - 0.710	For this parameter, we recommend the comparison with the informative mean value from the group of accredited
Control test value ± U (k=2)	0.738 ± 0.221	participating laboratories: 0.423 +/- 0.177 U(k=2) µg/l

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	0.5654	0.2128	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.649	0.117	-	-	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.527	0.105	-	-	
LC0008	0.308	0.077	-	-	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.017	0.009	-	-	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.921	0.138	-	-	
LC0016	0.391	0.078	-	-	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.71	0.355	-	-	
LC0019	0.3595	0.054	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.494 ± 0.262	-	µg/l
Minimum	0.017	-	µg/l
Maximum	0.921	-	µg/l
Standard deviation	0.262	-	µg/l
rel. standard deviation	53.1	-	%
n	9	-	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum DDE

**Graphical presentation of results**

**Results**

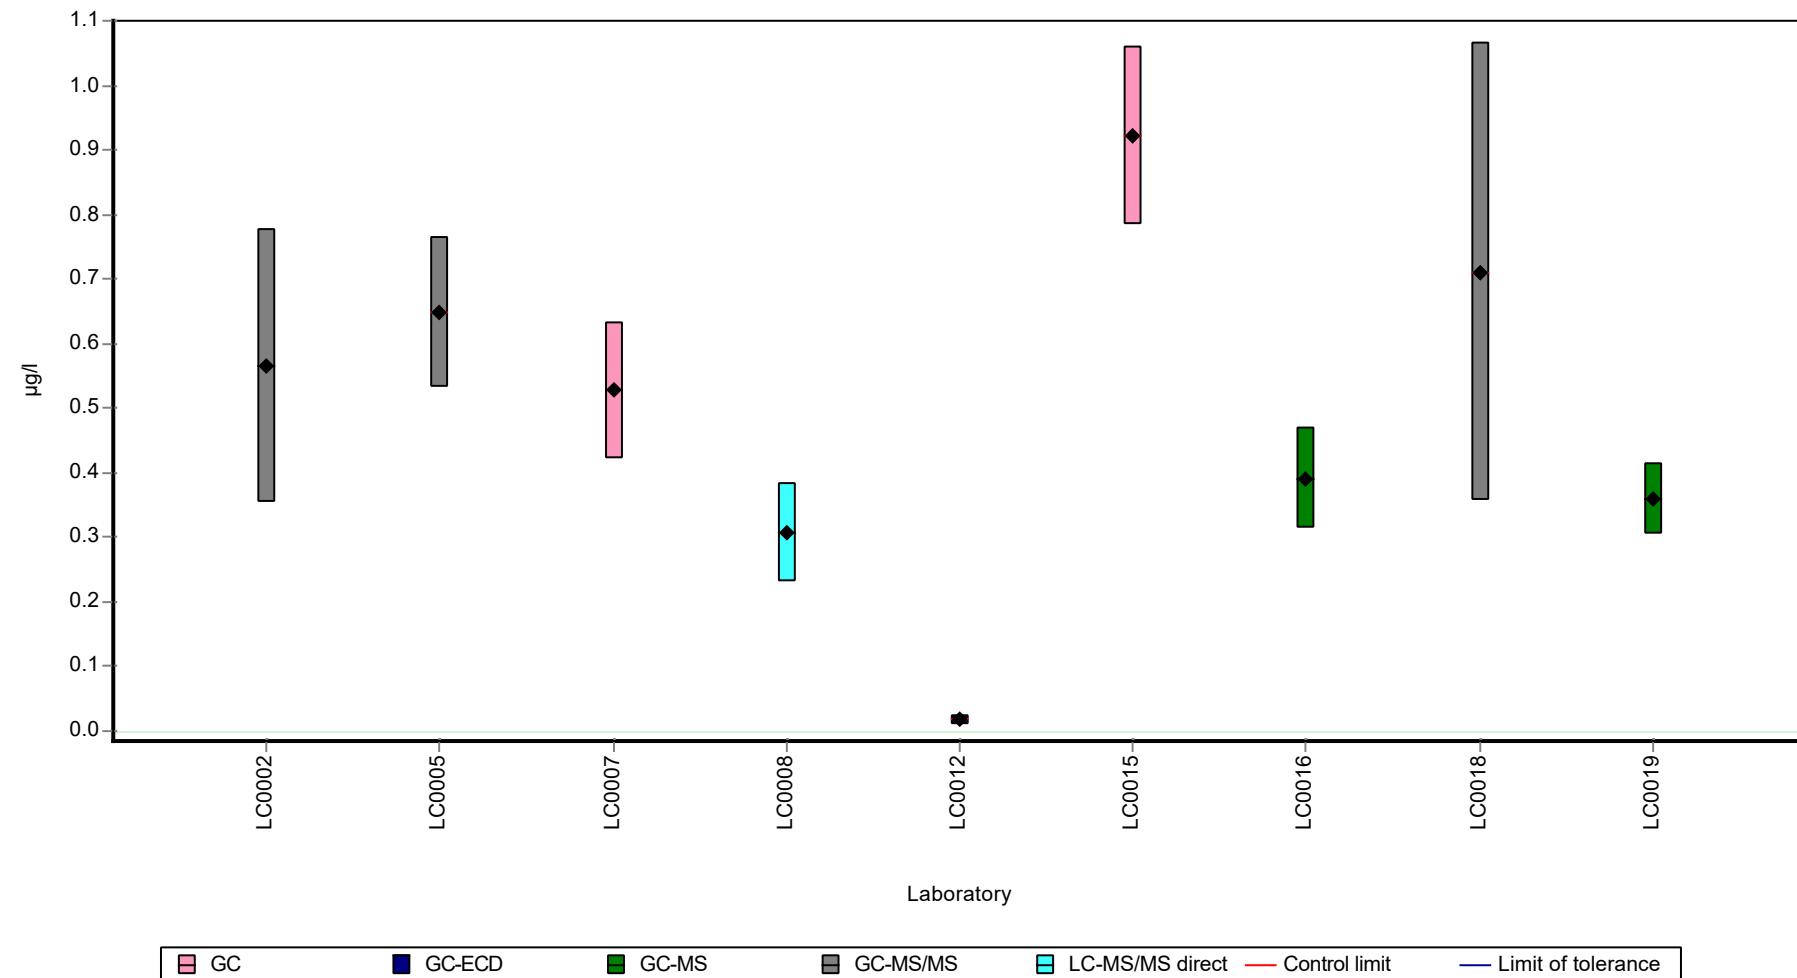

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDT

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Sum DDT

Unit  $\mu\text{g/l}$

Assigned value  $\pm U$  ( $k=2$ ) -

Criterion -

Minimum - Maximum 0.143 - 0.209

Control test value  $\pm U$  ( $k=2$ )  $0.2240 \pm 0.0894$

Information zur Auswertung: Die Streuung der ausreißerbereinigten Messergebnisse der akkreditierten, teilnehmenden Labore lag bei >50 %. Aus diesem Grund konnte kein zugewiesener Wert festgelegt werden. Für diesen Parameter empfehlen wir einen Vergleich mit dem rein informativen Mittelwert aus der Gruppe der akkreditierten Laborergebnisse ohne Ausreißer (H95):  $0.184 \pm 0.0285 \text{ } U(k=2) \mu\text{g/l}$

Information for evaluation: The relative reproducibility standard deviation of the results within group of accredited participating laboratories after outlier elimination was >50 %. Therefore, no assigned value could be defined.

For this parameter, we recommend the comparison with the informative mean value from the group of accredited

Labcode	Result	$\pm U$	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.209	0.038	-	-	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.143	0.029	-	-	
LC0008	0.064	0.016	-	-	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	< 0.01 (LOQ)	-	-	-	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.605	0.091	-	-	H
LC0016	0.194	0.039	-	-	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.19	0.095	-	-	
LC0019	0.3995	0.06	-	-	H

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean $\pm CI$ (99%)	$0.258 \pm 0.208$	-	$\mu\text{g/l}$
Minimum	0.064	-	$\mu\text{g/l}$
Maximum	0.605	-	$\mu\text{g/l}$
Standard deviation	0.184	-	$\mu\text{g/l}$
rel. standard deviation	71.2	-	%
n	7	-	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum DDT

**Graphical presentation of results**

**Results**

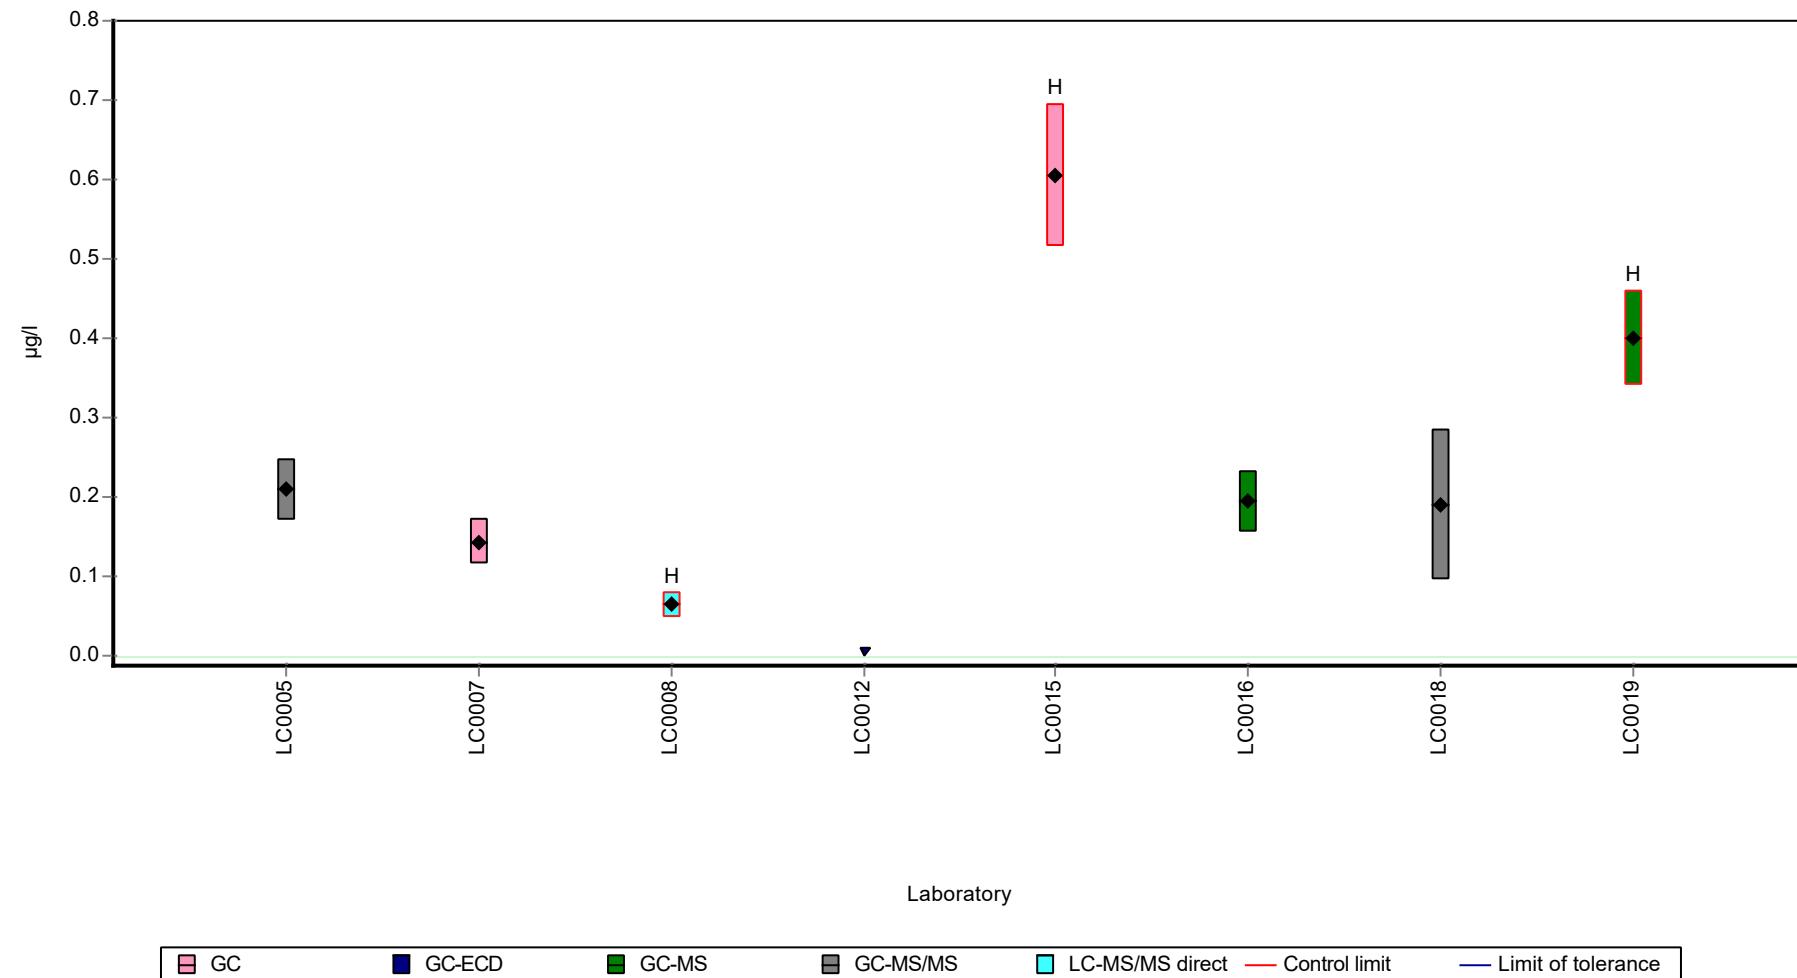

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum DDT

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Sum DDT

Unit  $\mu\text{g/l}$

Assigned value  $\pm U$  ( $k=2$ ) -

Criterion -

Minimum - Maximum 0.413 - 0.518

Control test value  $\pm U$  ( $k=2$ )  $0.682 \pm 0.273$  participating laboratories without outliers (H95):  $0.469 \pm 0.0440 \text{ U}(k=2) \mu\text{g/l}$

Information zur Auswertung: Die Streuung der ausreißerbereinigten Messergebnisse der akkreditierten, teilnehmenden Labore lag bei >50 %. Aus diesem Grund konnte kein zugewiesener Wert festgelegt werden. Für diesen Parameter empfehlen wir einen Vergleich mit dem rein informativen Mittelwert aus der Gruppe der akkreditierten Laborergebnisse ohne Ausreißer (H95):  $0.469 \pm 0.0440 \text{ U}(k=2) \mu\text{g/l}$

Information for evaluation: The relative reproducibility standard deviation of the results within group of accredited participating laboratories after outlier elimination was >50 %. Therefore, no assigned value could be defined.

For this parameter, we recommend the comparison with the informative mean value from the group of accredited

Labcode	Result	$\pm U$	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	-	-	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.668	0.12	-	-	H
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.462	0.092	-	-	
LC0008	0.128	0.032	-	-	H
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.029	0.015	-	-	H
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.89	0.133	-	-	
LC0016	0.413	0.083	-	-	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.485	0.243	-	-	
LC0019	0.5176	0.078	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean $\pm CI$ (99%)	$0.449 \pm 0.292$	-	$\mu\text{g/l}$
Minimum	0.029	-	$\mu\text{g/l}$
Maximum	0.89	-	$\mu\text{g/l}$
Standard deviation	0.275	-	$\mu\text{g/l}$
rel. standard deviation	61.2	-	%
n	8	-	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum DDT

**Graphical presentation of results**

**Results**

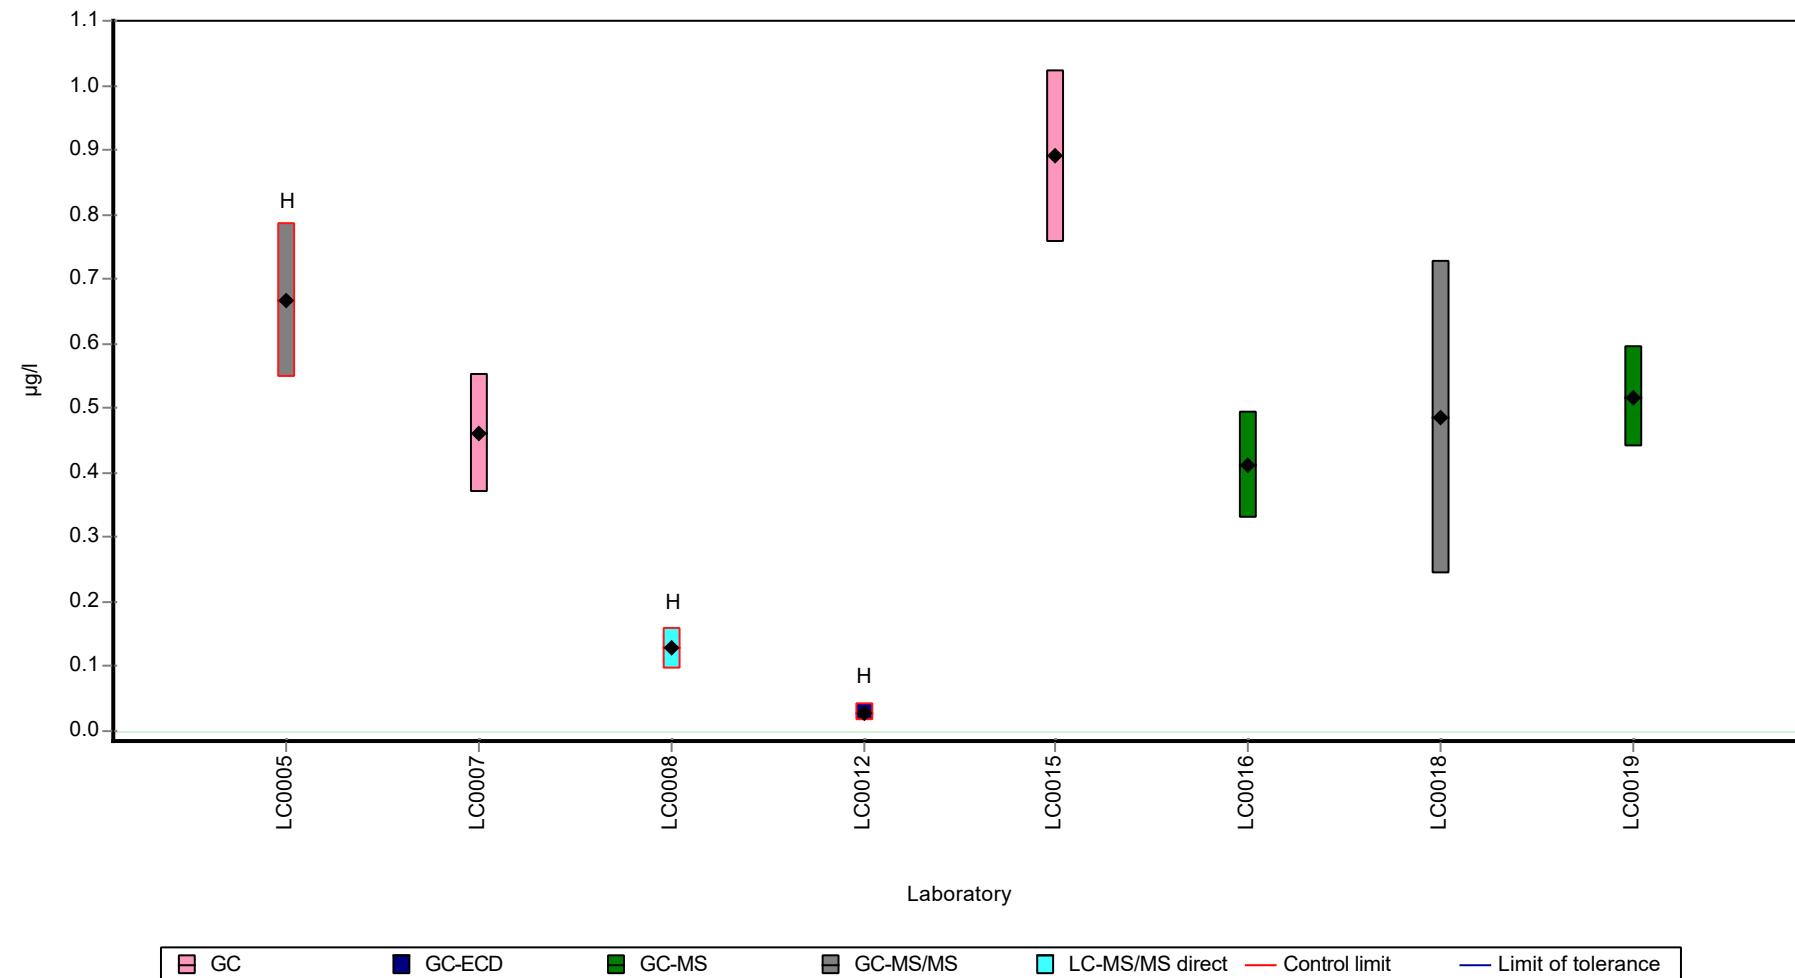

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum Endosulfan

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Sum Endosulfan

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.228 ± 0.0326
Criterion	0.0933 (41 %)
Minimum - Maximum	0.15 - 0.306
Control test value ± U (k=2)	0.2550 ± 0.115

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	0.2913	0.0728	128	0.68	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.243	0.044	107	0.17	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.231	0.046	102	0.04	
LC0008	0.15	0.038	65.9	-0.83	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.044	0.022	19.3	-1.97	H
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	0.19	0.076	83.5	-0.4	
LC0015	0.306	0.046	134	0.84	
LC0016	0.229	0.046	101	0.02	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.196	0.098	86.1	-0.34	
LC0019	0.2117	0.032	93	-0.17	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.209 ± 0.0703	0.228 ± 0.0489	µg/l
Minimum	0.044	0.15	µg/l
Maximum	0.306	0.306	µg/l
Standard deviation	0.0741	0.0489	µg/l
rel. standard deviation	35.4	21.5 %	
n	10	9	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum Endosulfan


#### Graphical presentation of results

##### Results

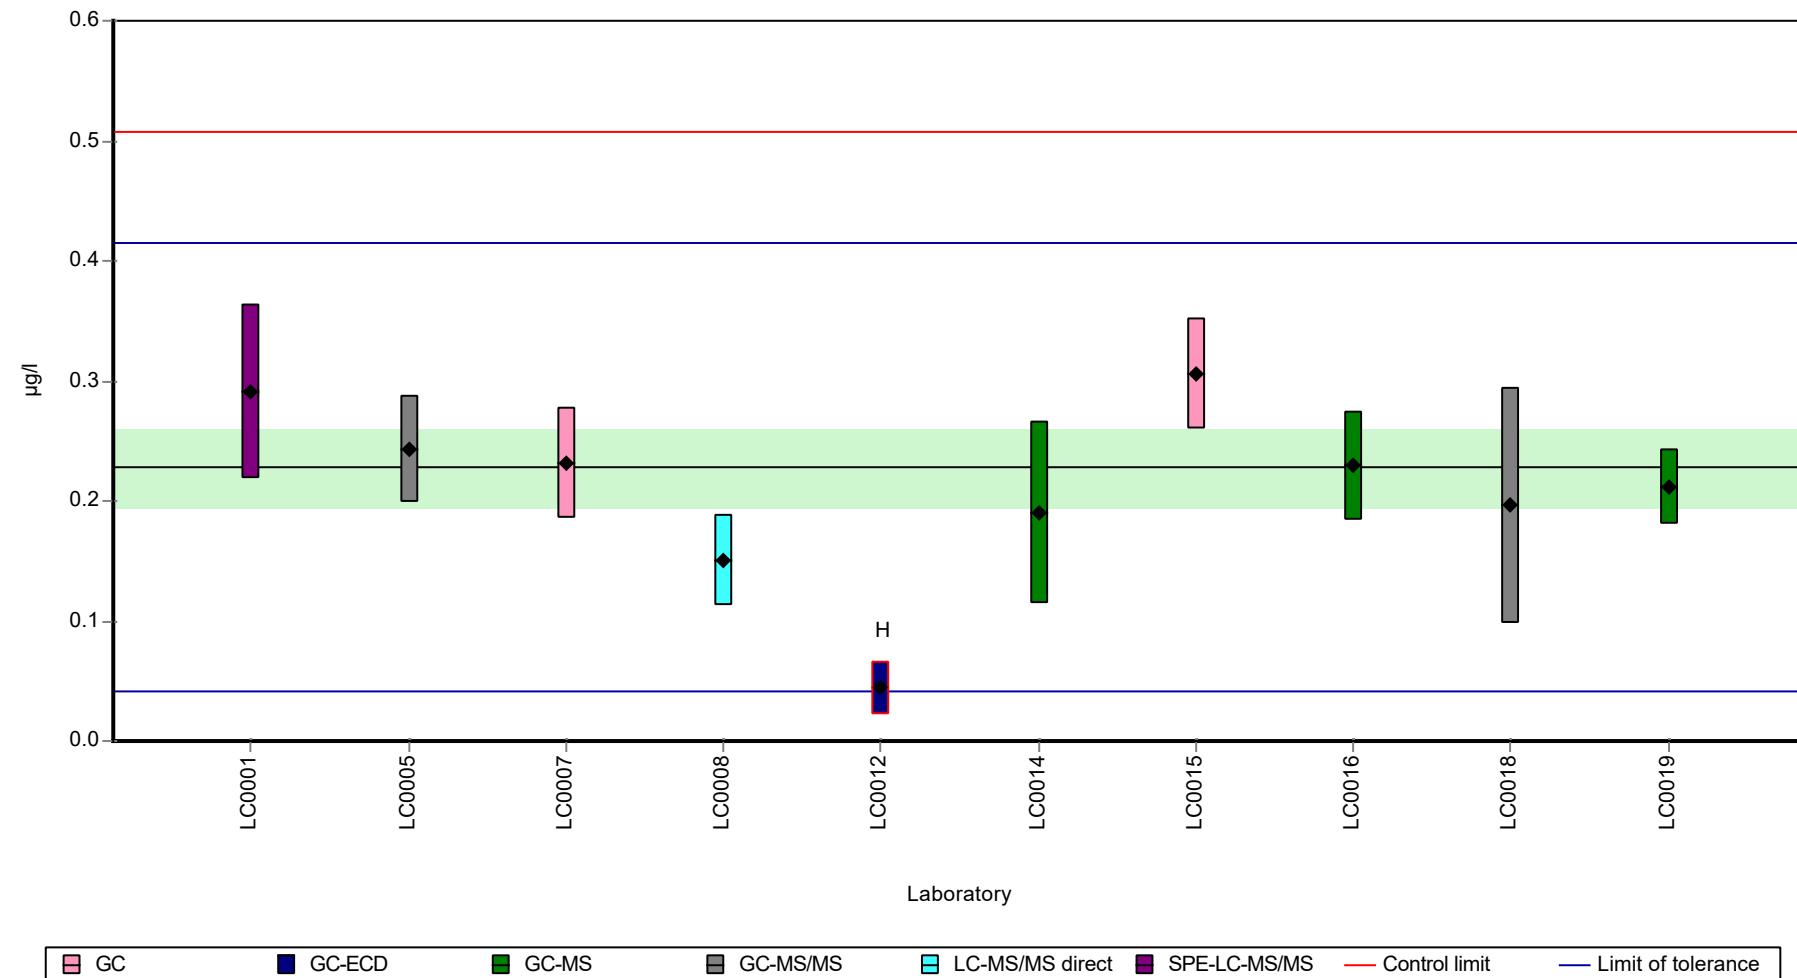


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum Endosulfan

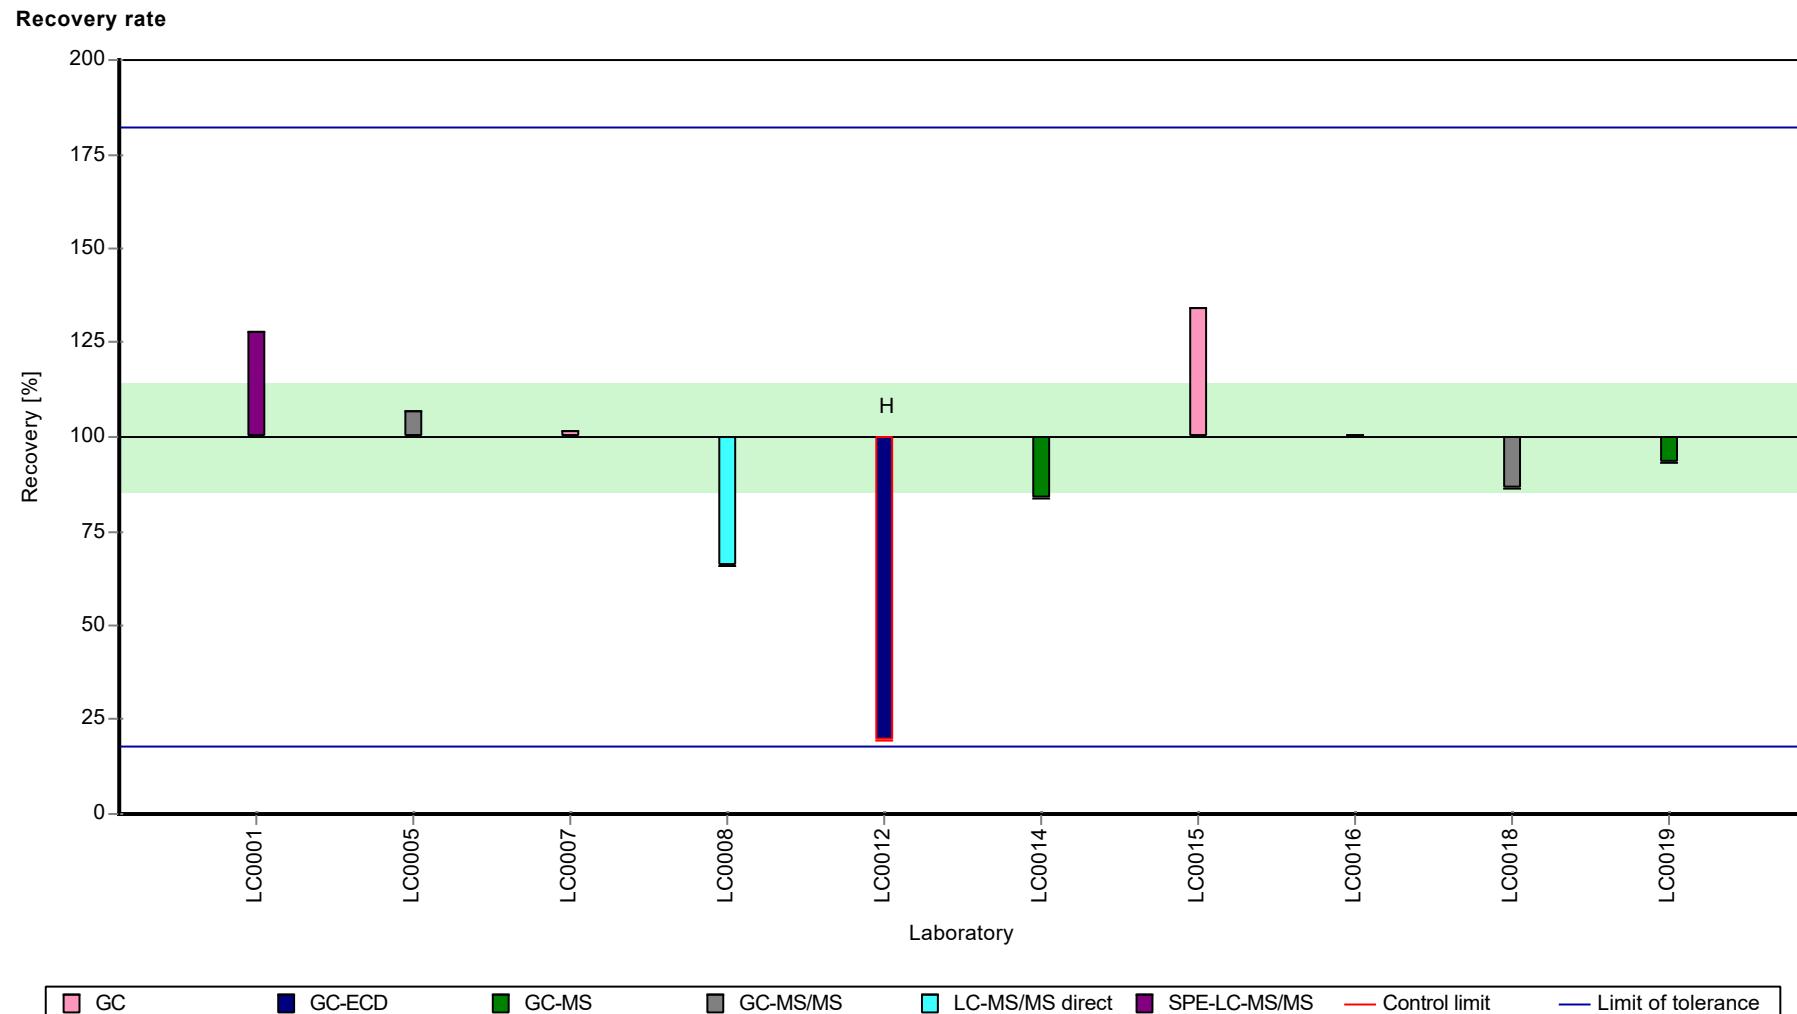

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Sum Endosulfan

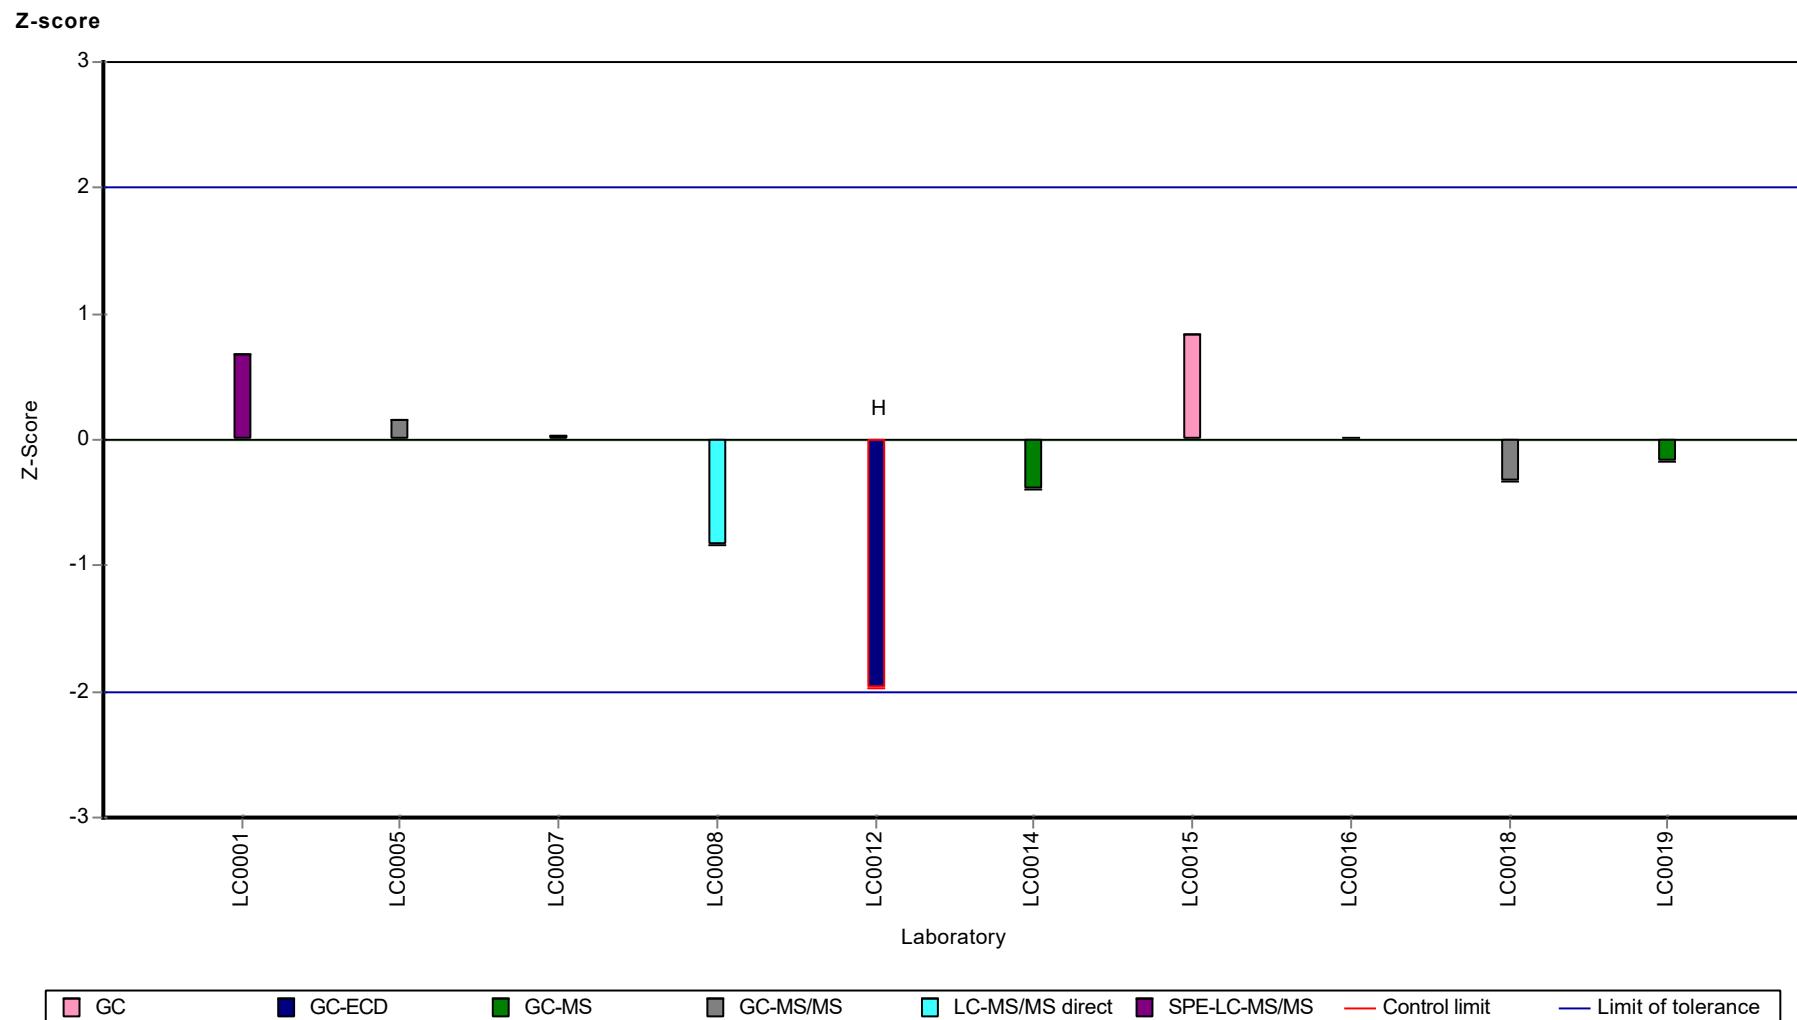

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum Endosulfan

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Sum Endosulfan

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.666 ± 0.14
Criterion	0.273 (41 %)
Minimum - Maximum	0.206 - 0.915
Control test value ± U (k=2)	0.901 ± 0.406

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.34	0.085	-	-	
LC0002	-	-	-	-	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	-	-	-	-	
LC0005	0.817	0.147	123	0.56	
LC0006	-	-	-	-	
LC0007	0.758	0.152	114	0.34	
LC0008	0.518	0.13	77.8	-0.54	
LC0009	-	-	-	-	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	-	-	-	-	
LC0012	0.206	0.103	31	-1.68	
LC0013	-	-	-	-	
LC0014	0.79	0.32	119	0.46	
LC0015	0.915	0.137	137	0.91	
LC0016	0.633	0.13	95.1	-0.12	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.745	0.373	112	0.29	
LC0019	0.6078	0.091	91.3	-0.21	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.666 ± 0.21	0.666 ± 0.21	µg/l
Minimum	0.206	0.206	µg/l
Maximum	0.915	0.915	µg/l
Standard deviation	0.21	0.21	µg/l
rel. standard deviation	31.6	31.6	%
n	9	9	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum Endosulfan


**Graphical presentation of results**

**Results**

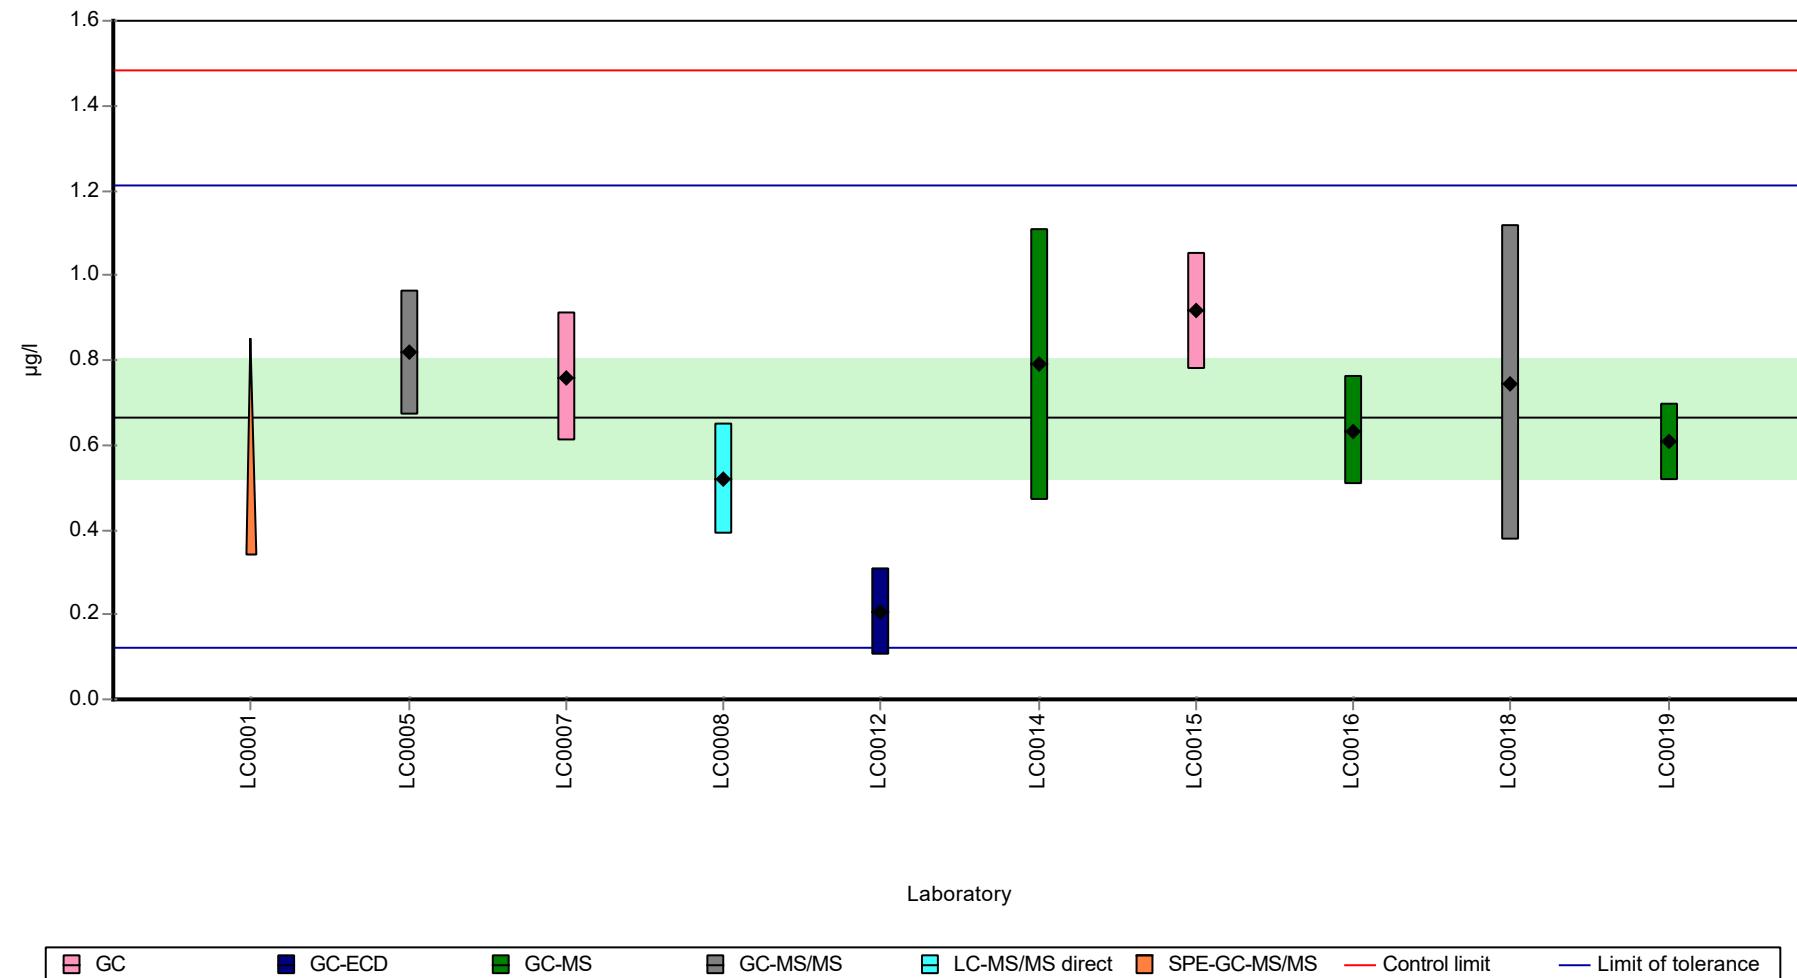


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum Endosulfan

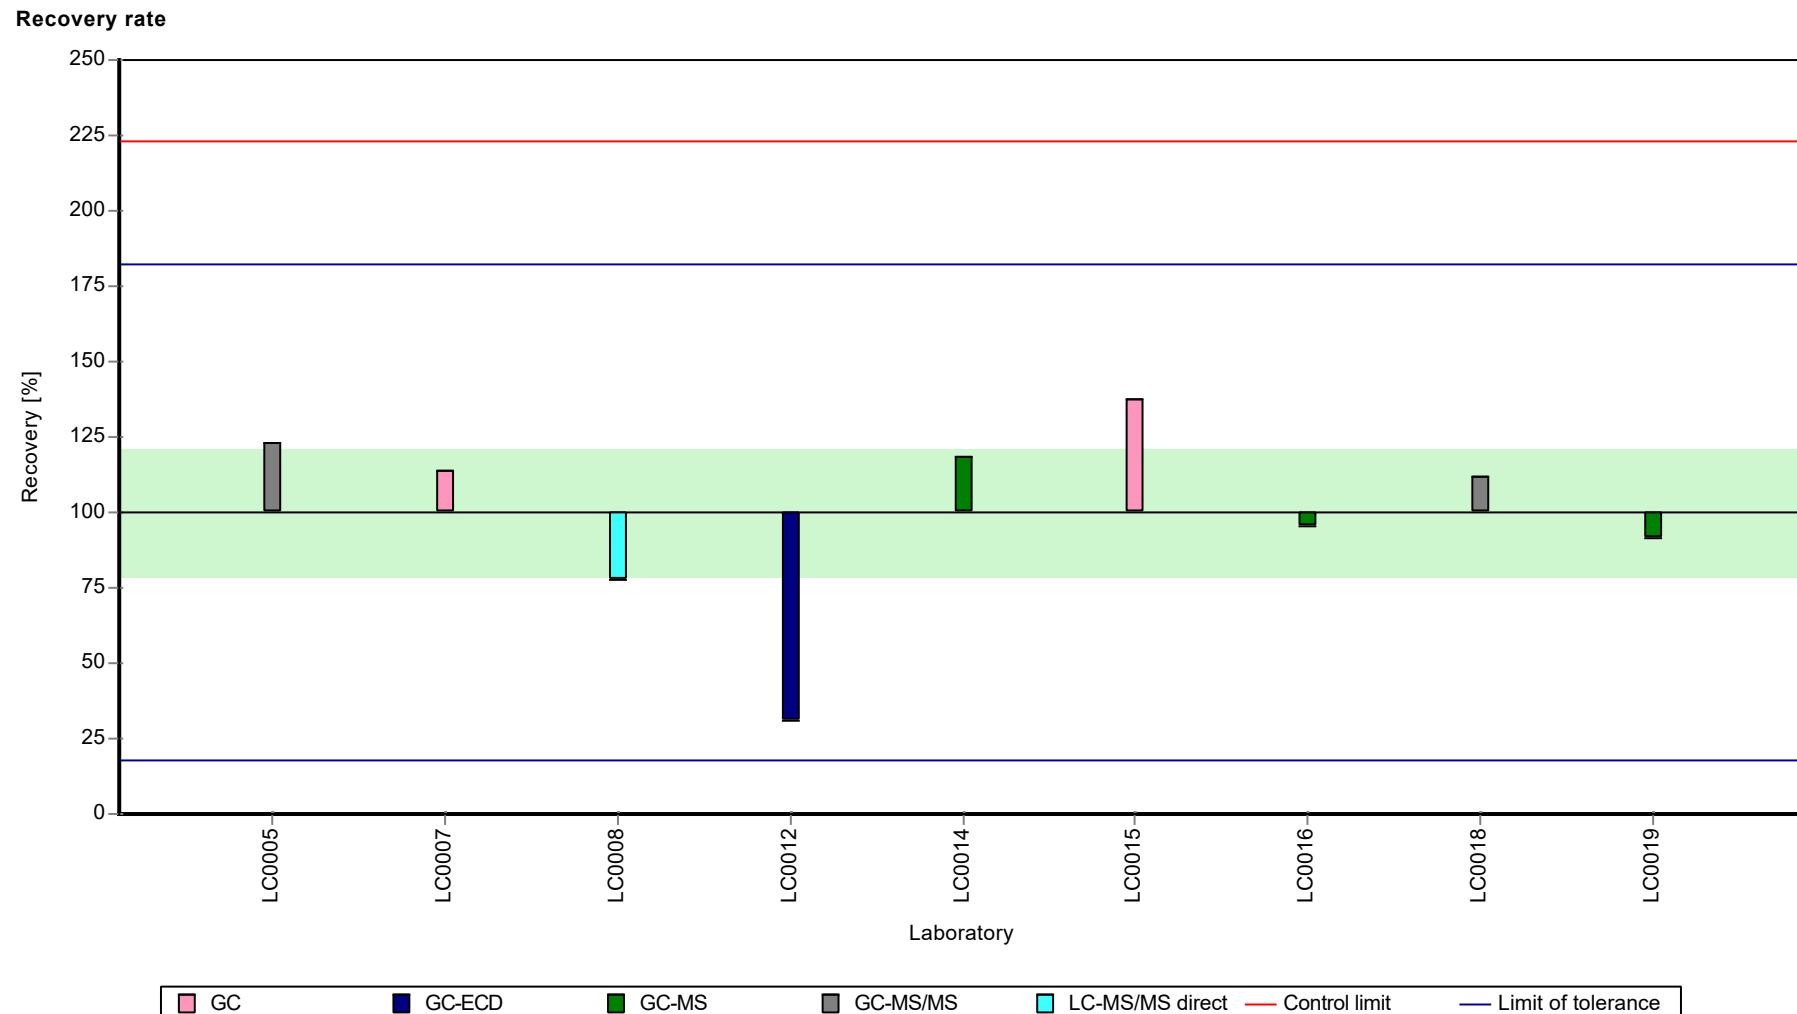

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Sum Endosulfan

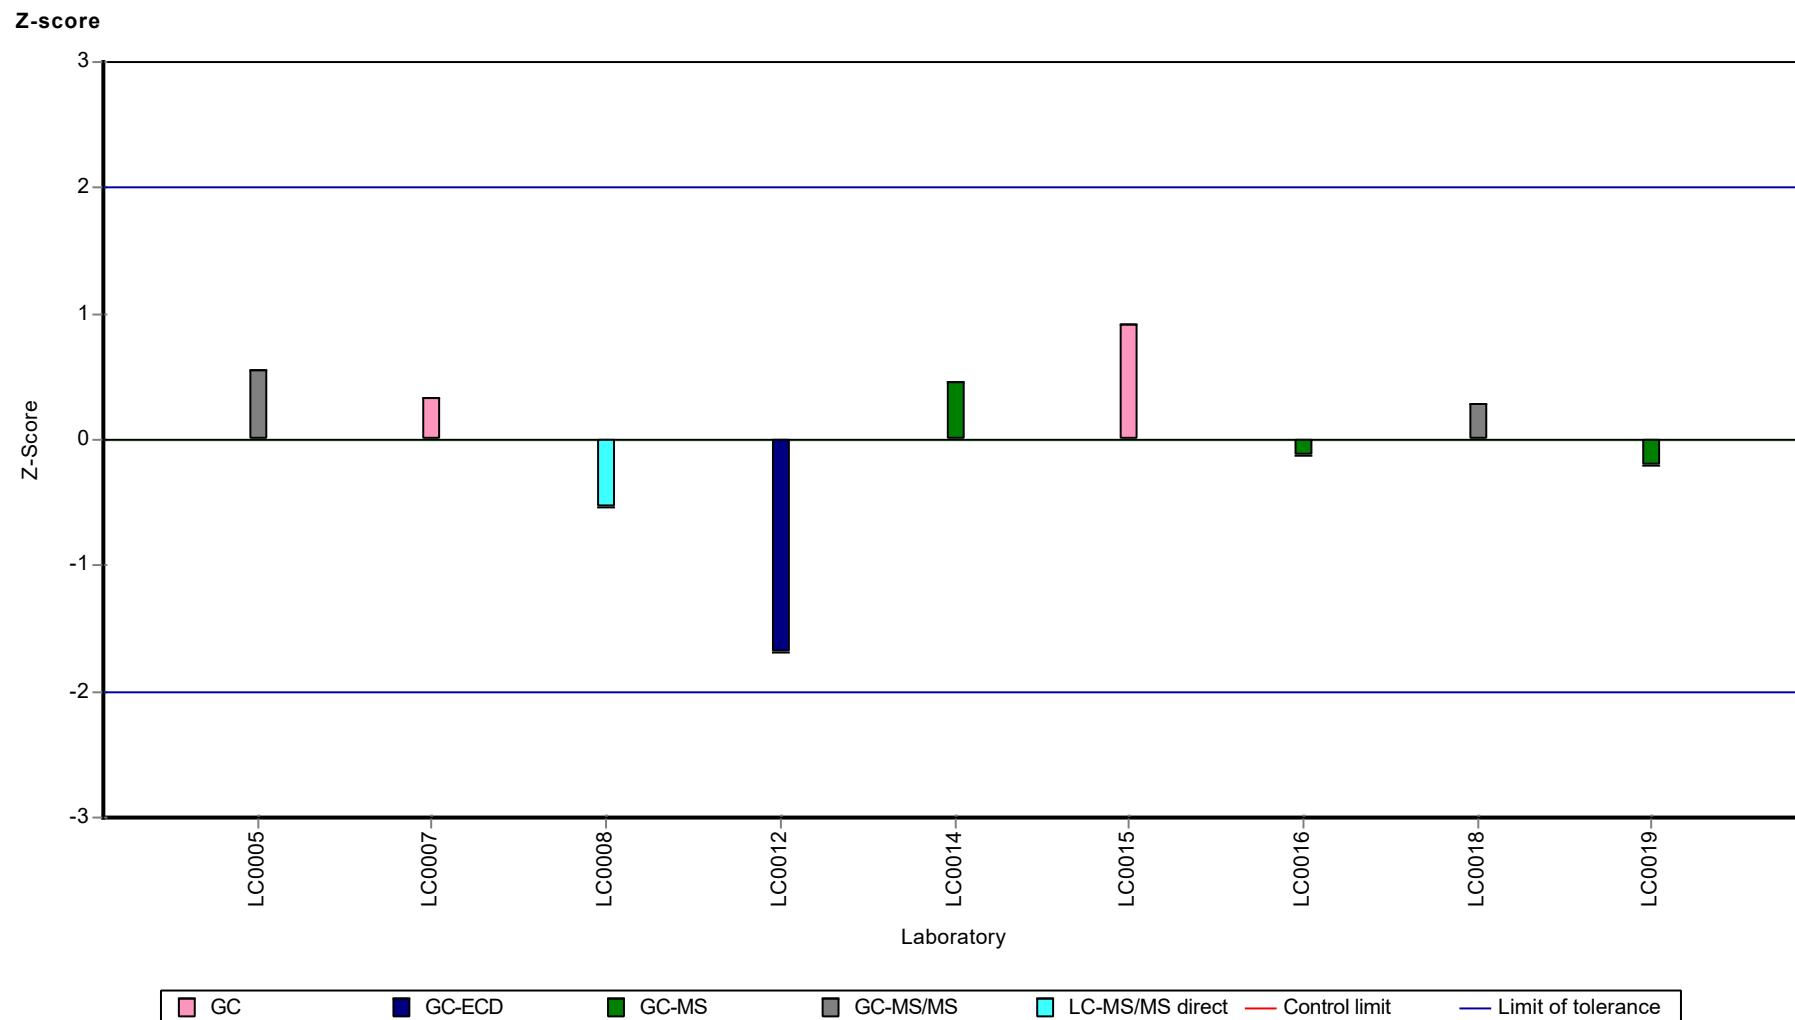

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Thiacloprid

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Thiacloprid

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.102 ± 0.0048
Criterion	0.0142 (14 %)
Minimum - Maximum	0.0852 - 0.118
Control test value ± U (k=2)	0.0838 ± 0.0209

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	0.117	0.0292	115	1.08	
LC0002	0.0952	0.0206	93.7	-0.45	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	0.106	0.036	104	0.31	
LC0005	0.103	0.0185	101	0.1	
LC0006	0.094	0.007	92.5	-0.54	
LC0007	0.107	0.016	105	0.38	
LC0008	0.118	0.03	116	1.15	
LC0009	0.103	0.021	101	0.1	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	0.093	0.041	91.5	-0.61	
LC0012	0.0852	0.0426	83.8	-1.15	
LC0013	0.111	0.001	109	0.66	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.101	0.015	99.4	-0.04	
LC0016	0.103	0.016	101	0.1	
LC0017	0.09303	0.02047	91.5	-0.6	
LC0018	0.095	0.048	93.5	-0.47	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.102 ± 0.0072	0.102 ± 0.0072	µg/l
Minimum	0.0852	0.0852	µg/l
Maximum	0.118	0.118	µg/l
Standard deviation	0.00929	0.00929	µg/l
rel. standard deviation	9.14	9.14 %	
n	15	15	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Thiacloprid


#### Graphical presentation of results

##### Results

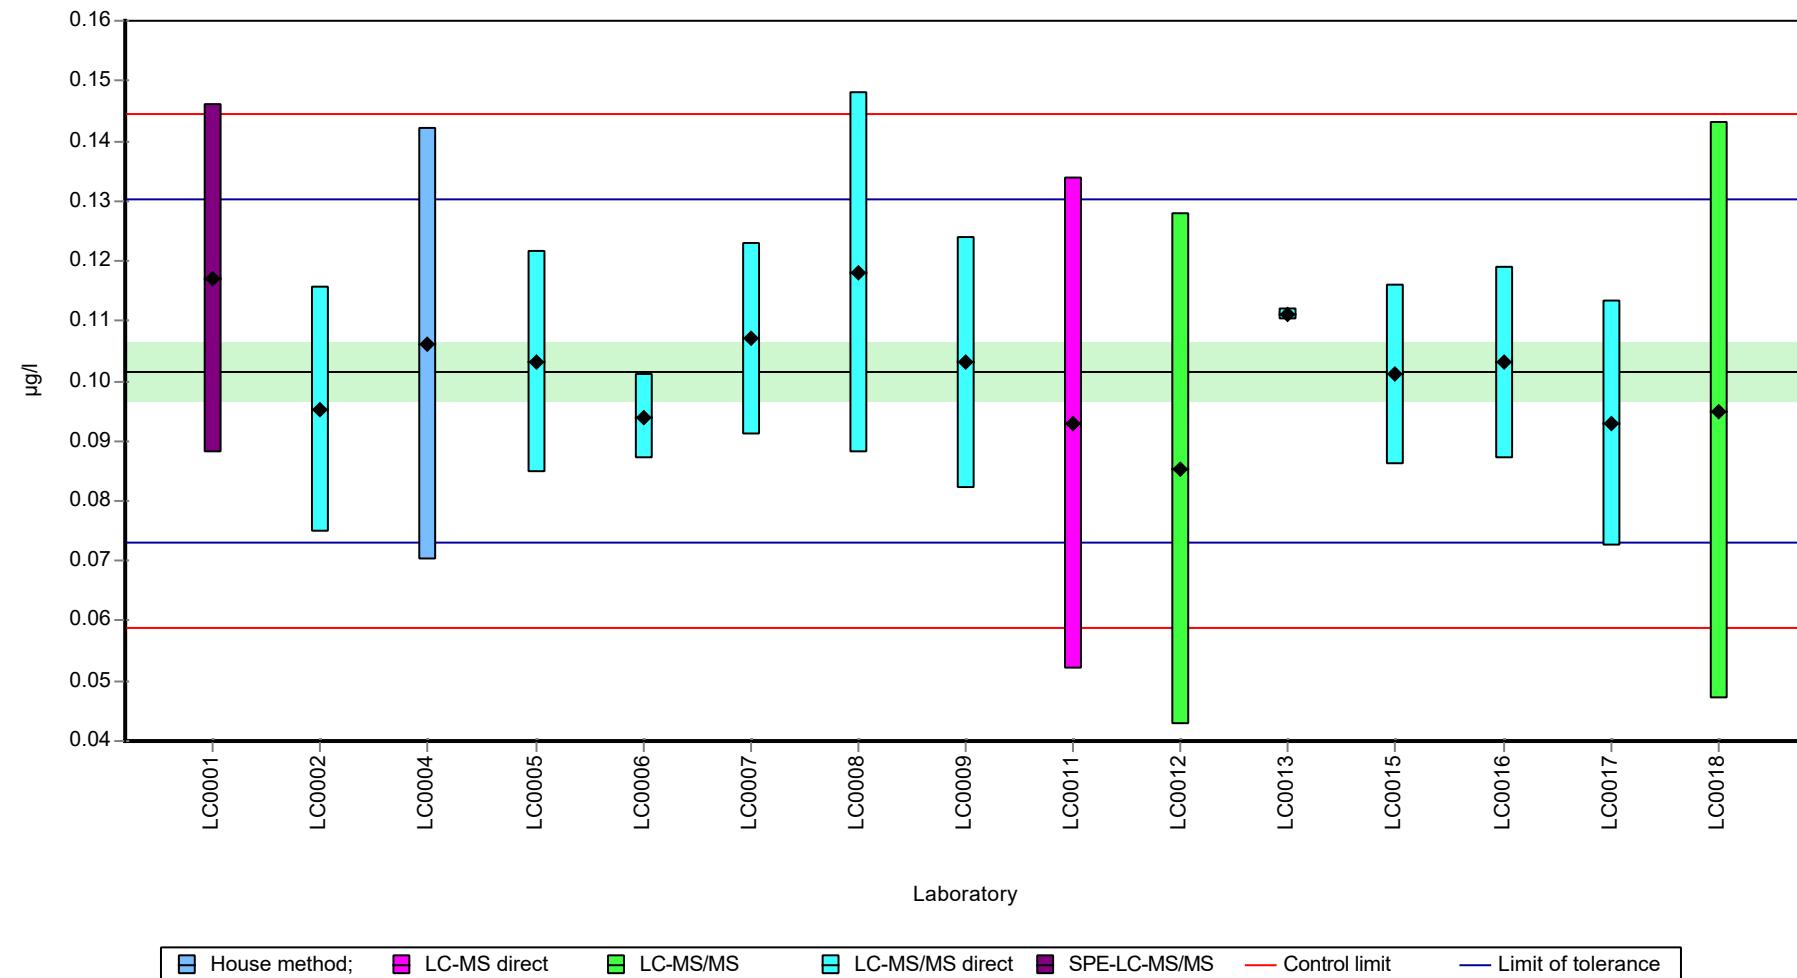


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Thiacloprid

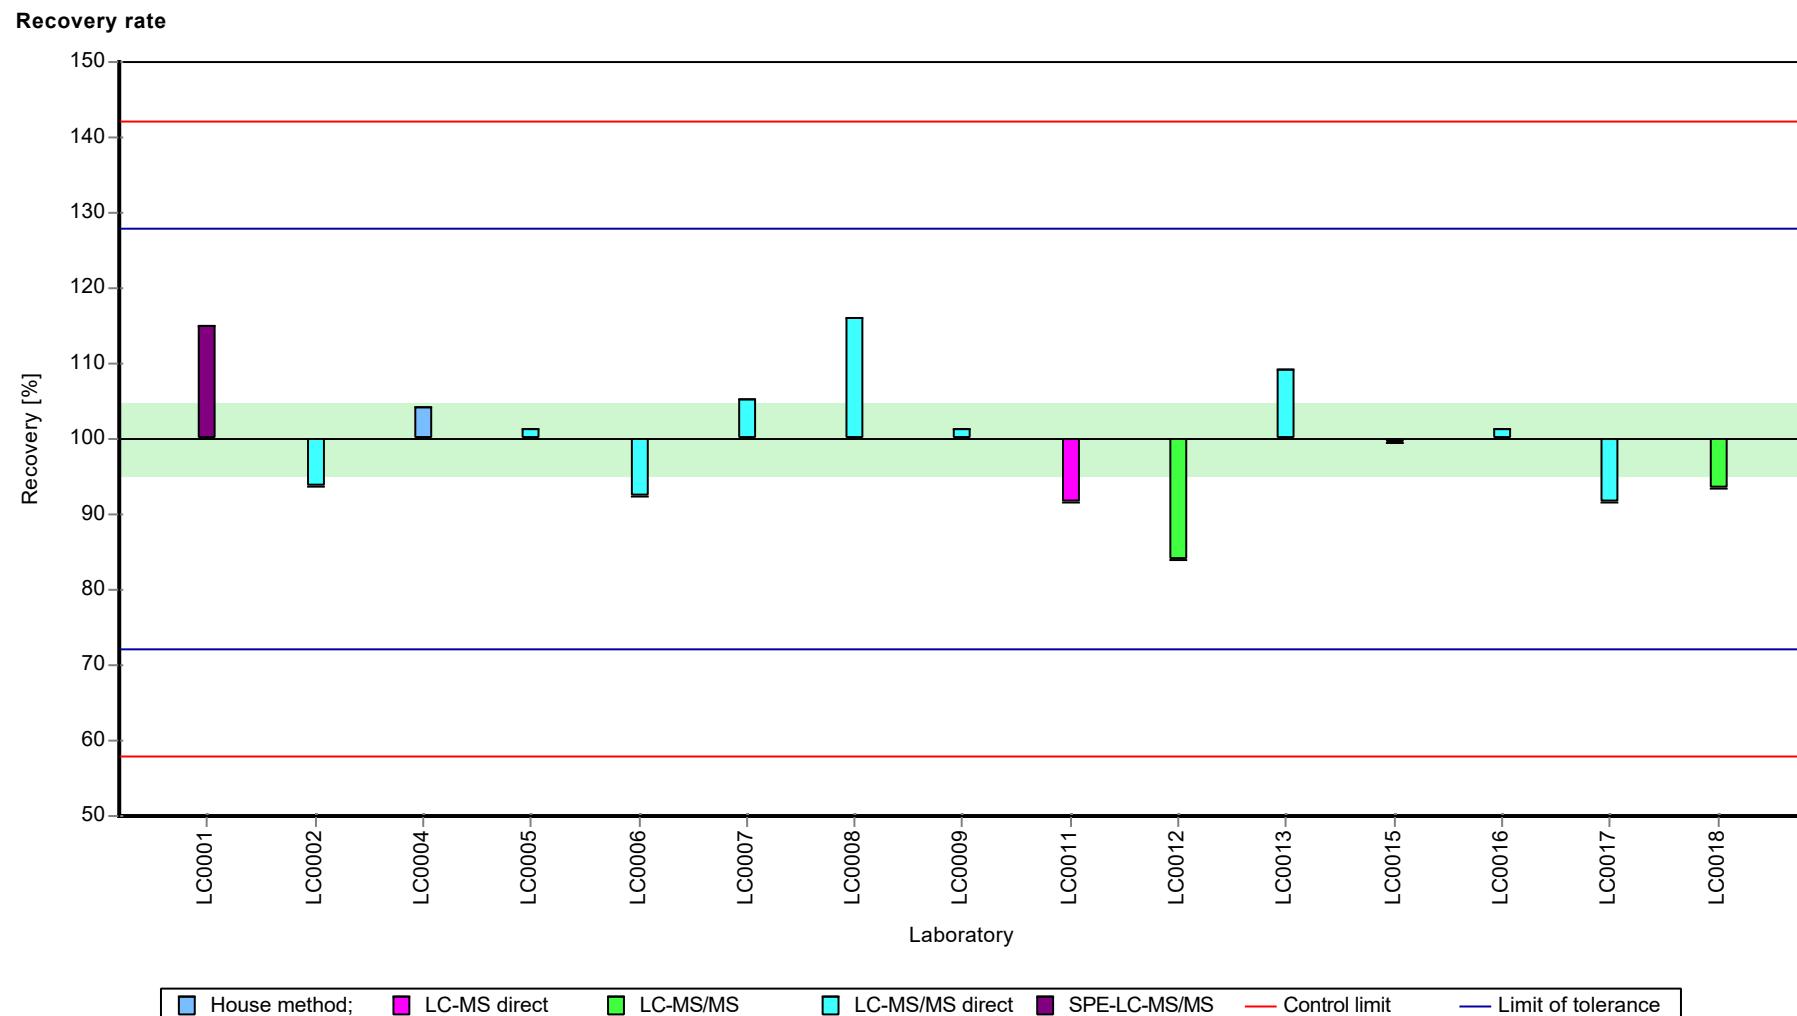

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Thiacloprid

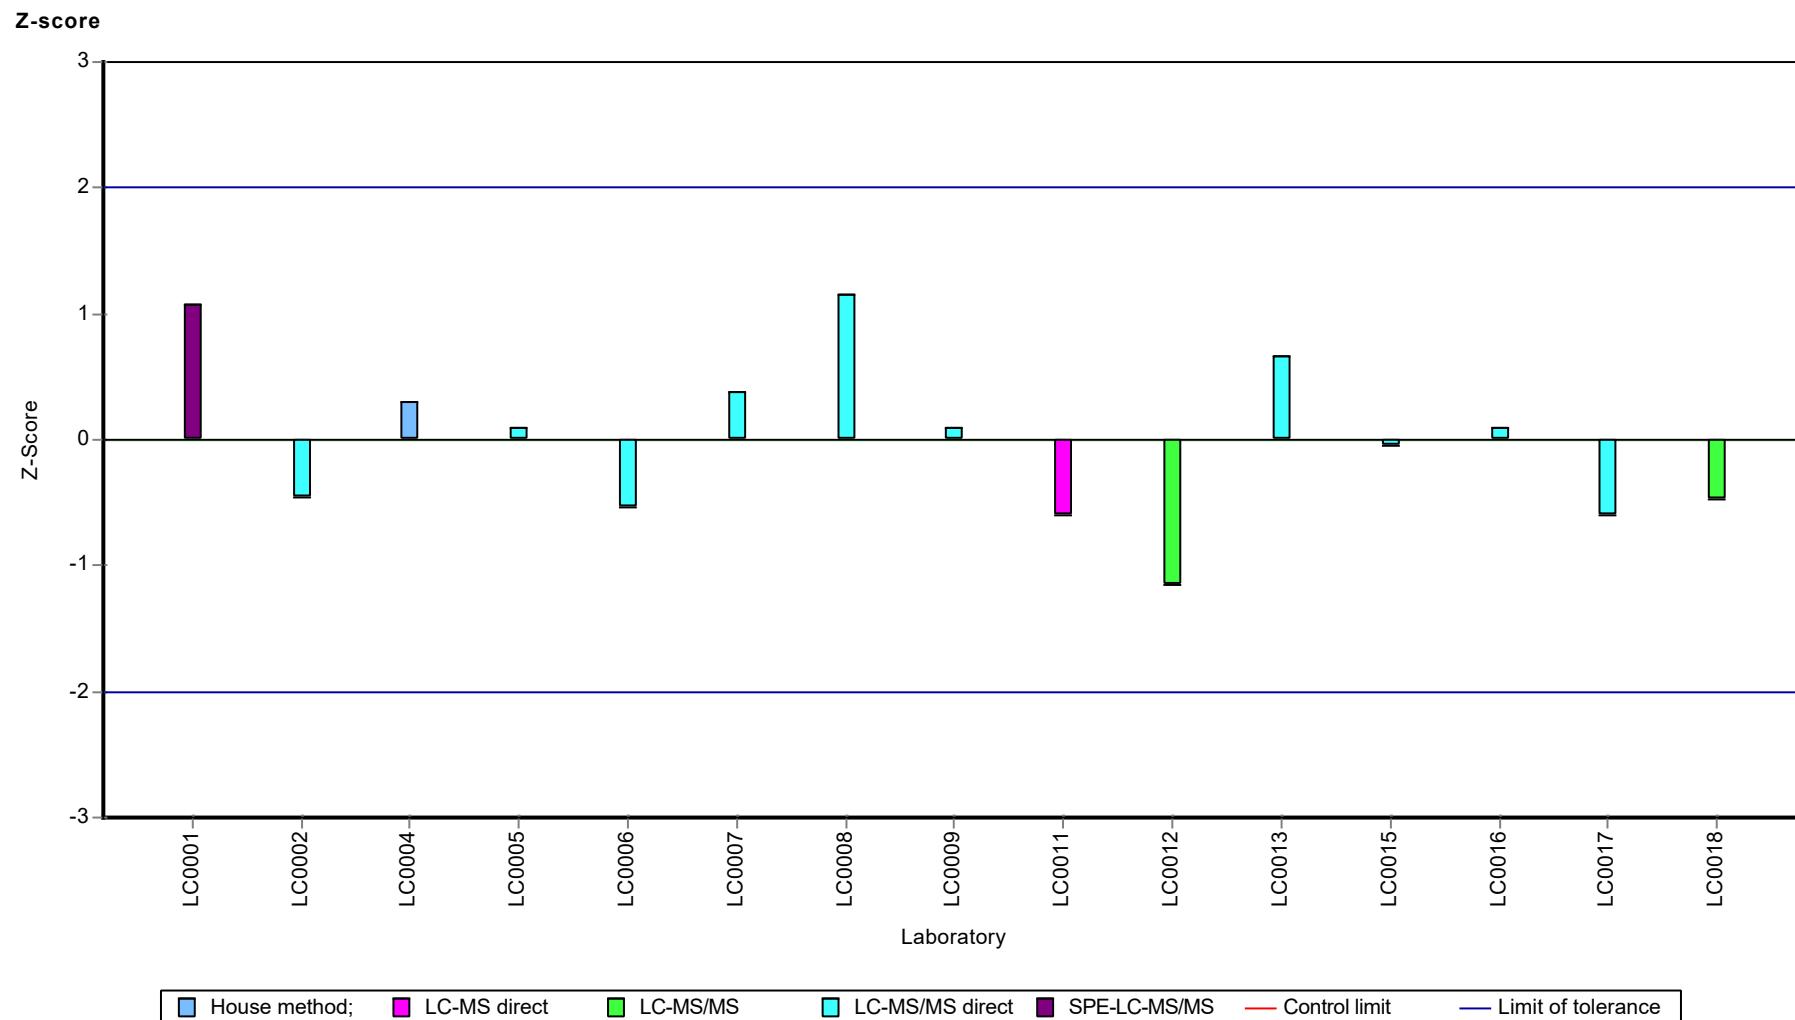

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Thiacloprid

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Thiacloprid

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	2.39 ± 0.113
Criterion	0.334 (14 %)
Minimum - Maximum	1.94 - 2.6
Control test value ± U (k=2)	1.950 ± 0.488

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.4	0.1	-	-	
LC0002	2.326	0.5022	97.5	-0.18	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	2.57	0.87	108	0.55	
LC0005	2.386	0.43	100	0.00	
LC0006	1.94	0.037	81.3	-1.34	
LC0007	2.56	0.384	107	0.52	
LC0008	2.566	0.642	108	0.54	
LC0009	2.601	0.52	109	0.64	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	2.06	0.7	86.3	-0.98	
LC0012	1.1531	0.5766	48.3	-3.69	H
LC0013	2.5	0.012	105	0.34	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	2.337	0.35	97.9	-0.15	
LC0016	2.48	0.4	104	0.28	
LC0017	2.251	0.49522	94.3	-0.41	
LC0018	2.45	1.23	103	0.19	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	2.3 ± 0.307	2.39 ± 0.17	µg/l
Minimum	1.15	1.94	µg/l
Maximum	2.6	2.6	µg/l
Standard deviation	0.383	0.204	µg/l
rel. standard deviation	16.7	8.54	%
n	14	13	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Thiacloprid


#### Graphical presentation of results

##### Results

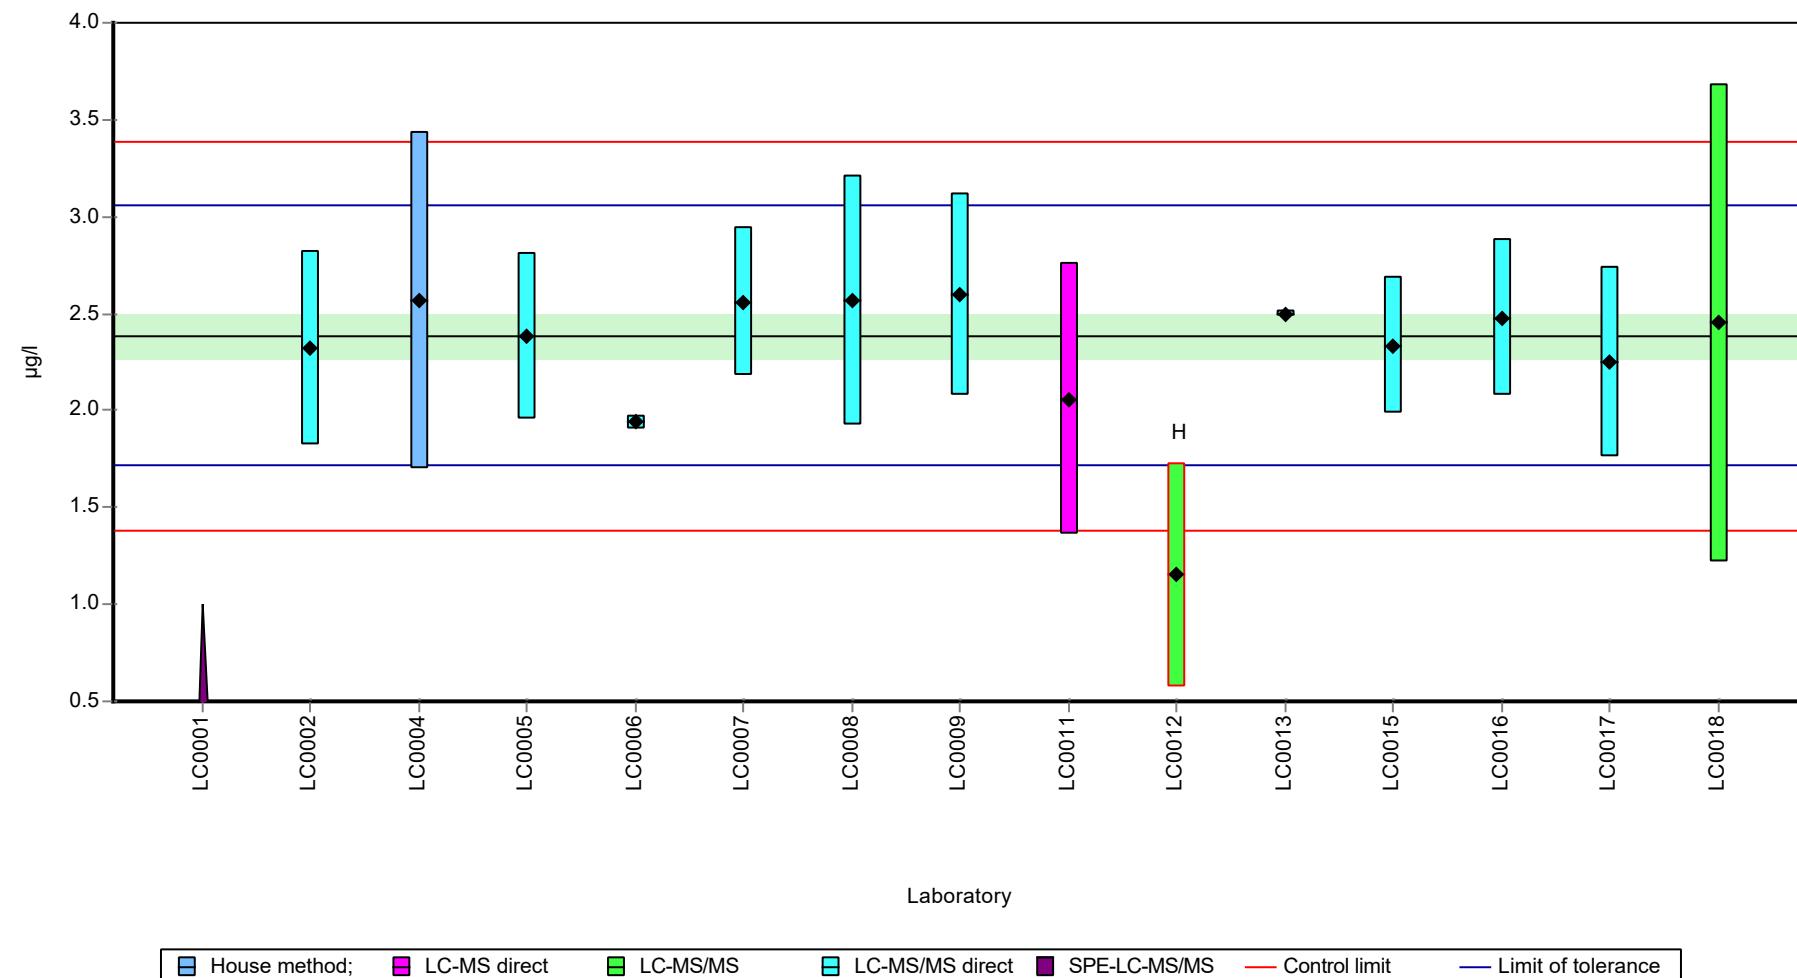


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Thiacloprid

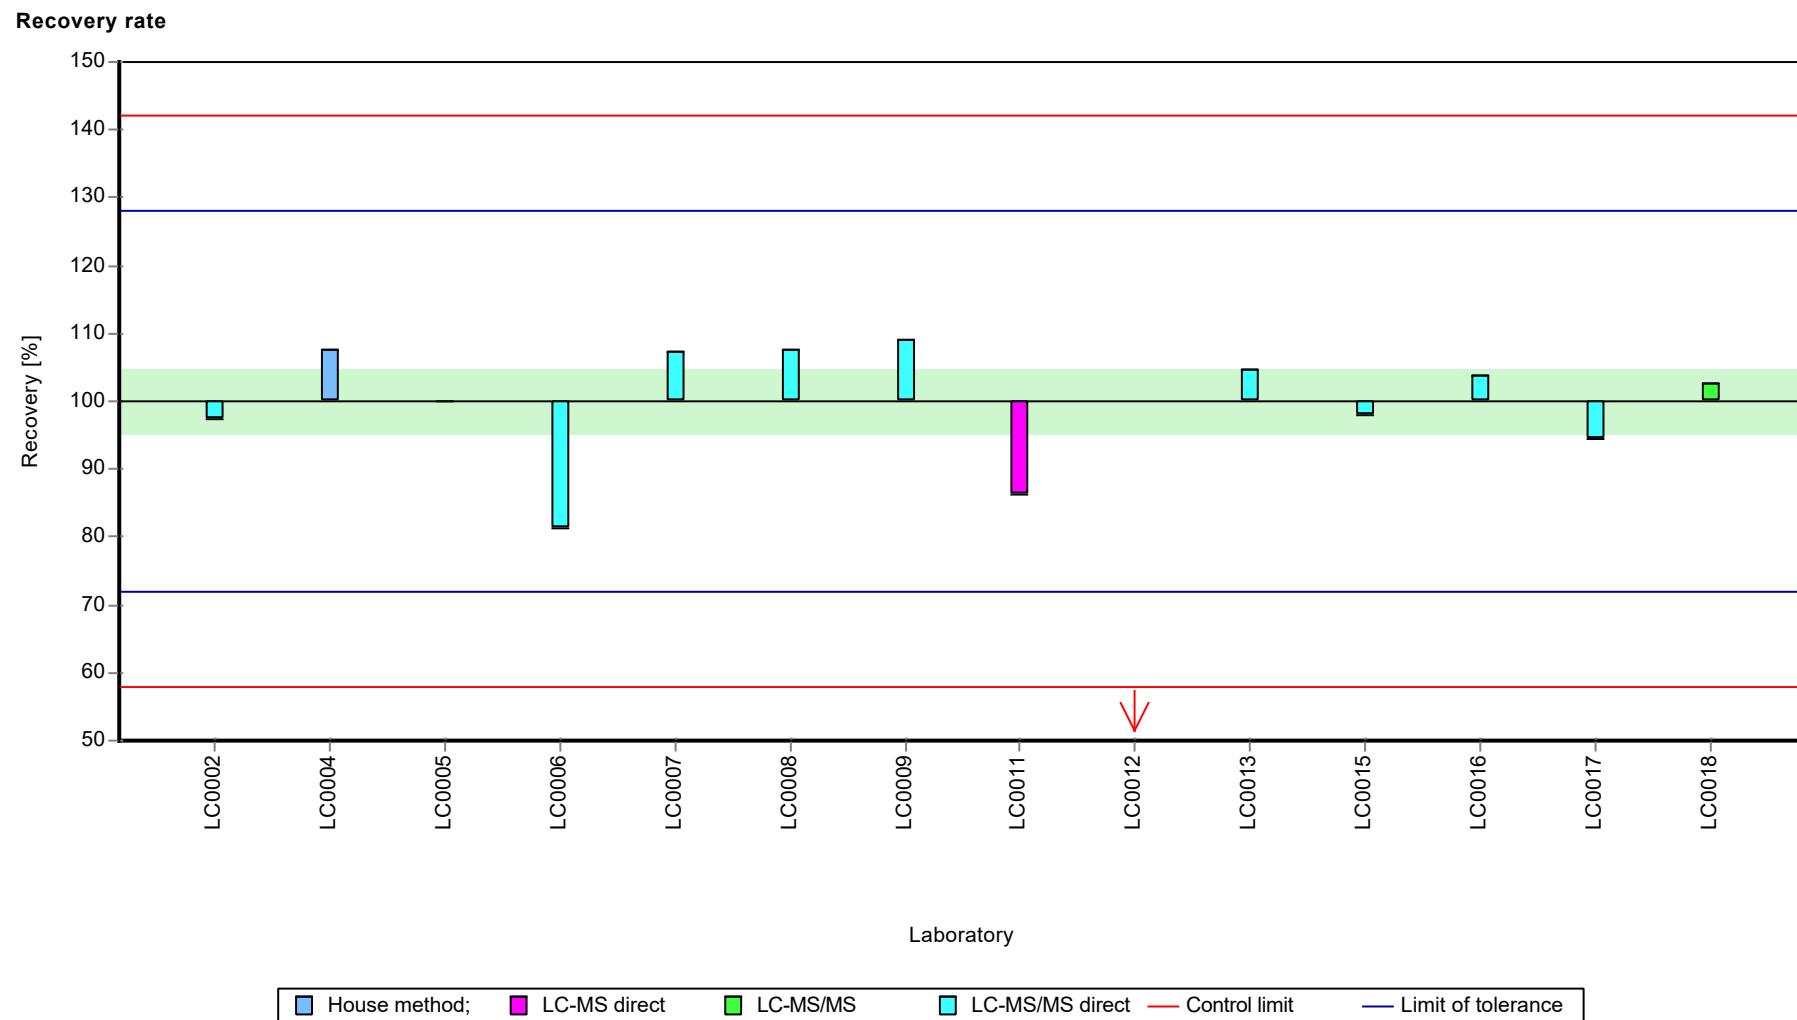

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Thiacloprid

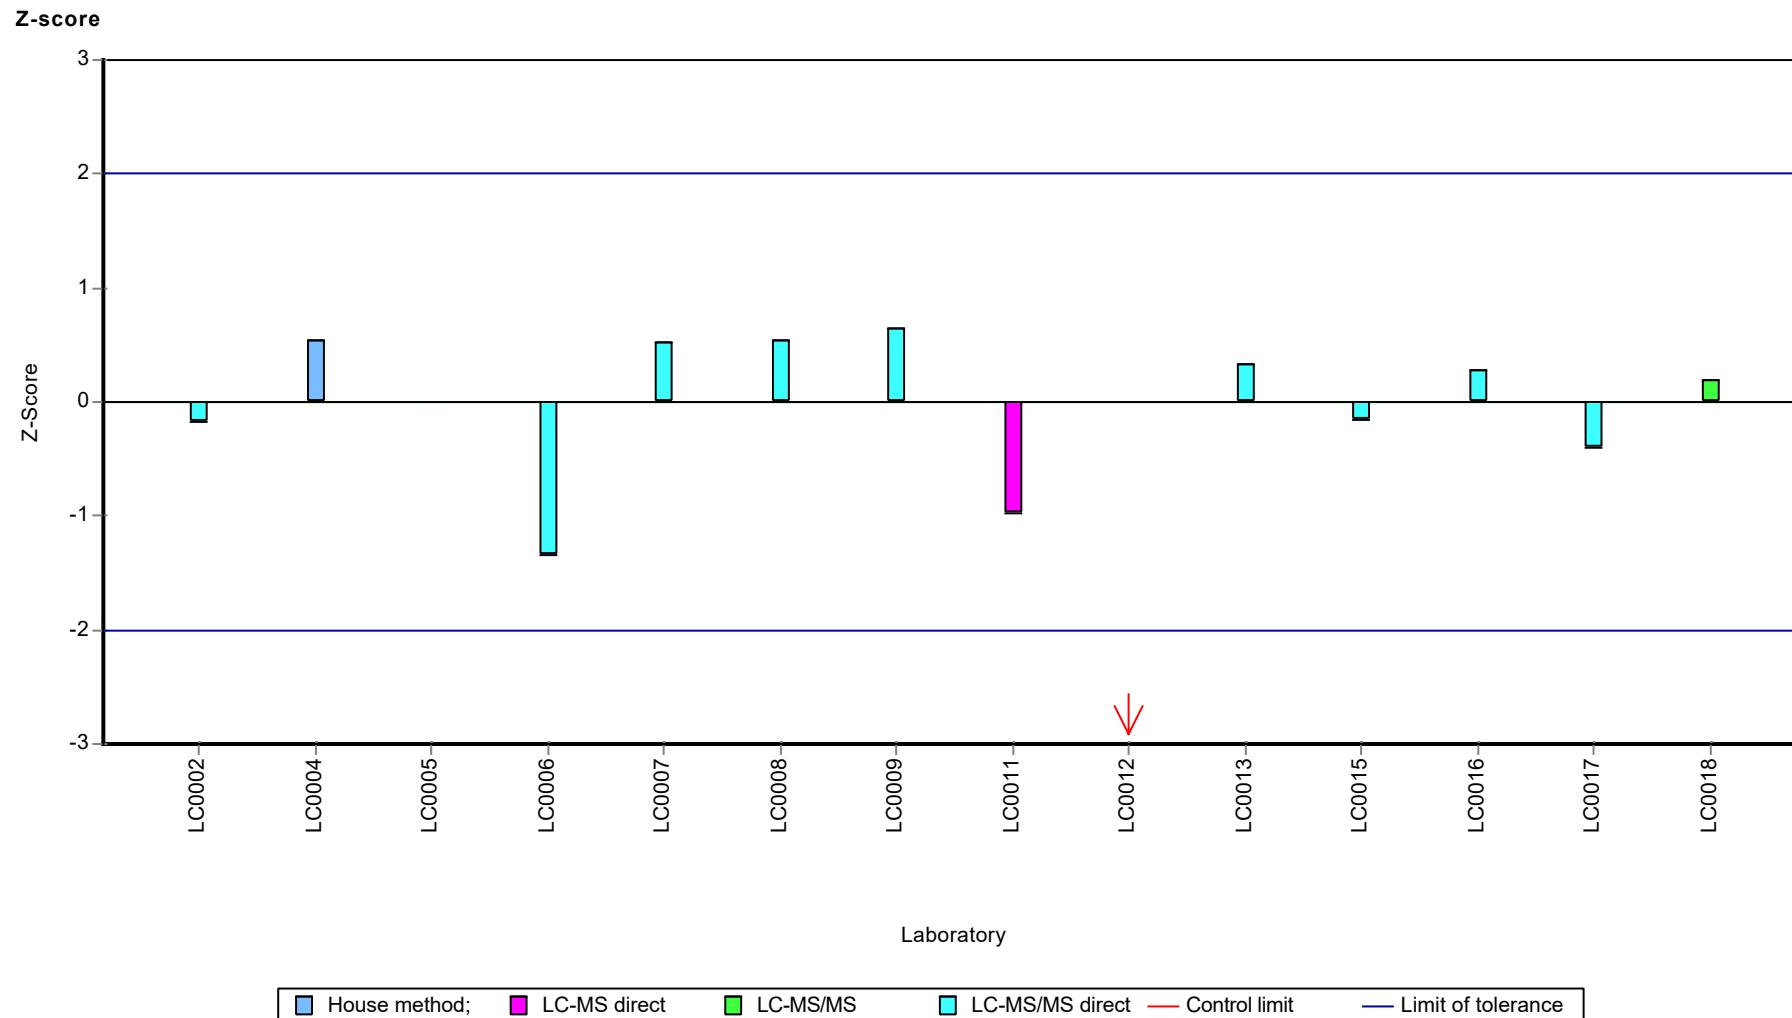

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Thiamethoxam

## Parameter oriented report

### H114 A

#### Thiamethoxam

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	0.122 ± 0.0083
Criterion	0.0208 (17 %)
Minimum - Maximum	0.0854 - 0.14
Control test value ± U (k=2)	0.1050 ± 0.0157

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	0.0854	0.0214	69.8	-1.77	
LC0002	0.1098	0.0245	89.8	-0.6	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	0.121	0.053	99	-0.06	
LC0005	0.13	0.0234	106	0.37	
LC0006	0.134	0.003	110	0.56	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	0.119	0.03	97.3	-0.16	
LC0009	0.117	0.023	95.7	-0.25	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	0.132	0.06	108	0.47	
LC0012	0.0151	0.0076	12.4	-5.16	H
LC0013	0.129	0.001	106	0.32	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	0.12	0.018	98.1	-0.11	
LC0016	0.13	0.013	106	0.37	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	0.14	0.07	115	0.85	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	0.114 ± 0.0273	0.122 ± 0.0124	µg/l
Minimum	0.0151	0.0854	µg/l
Maximum	0.14	0.14	µg/l
Standard deviation	0.0328	0.0144	µg/l
rel. standard deviation	28.7	11.8	%
n	13	12	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Thiamethoxam


#### Graphical presentation of results

##### Results

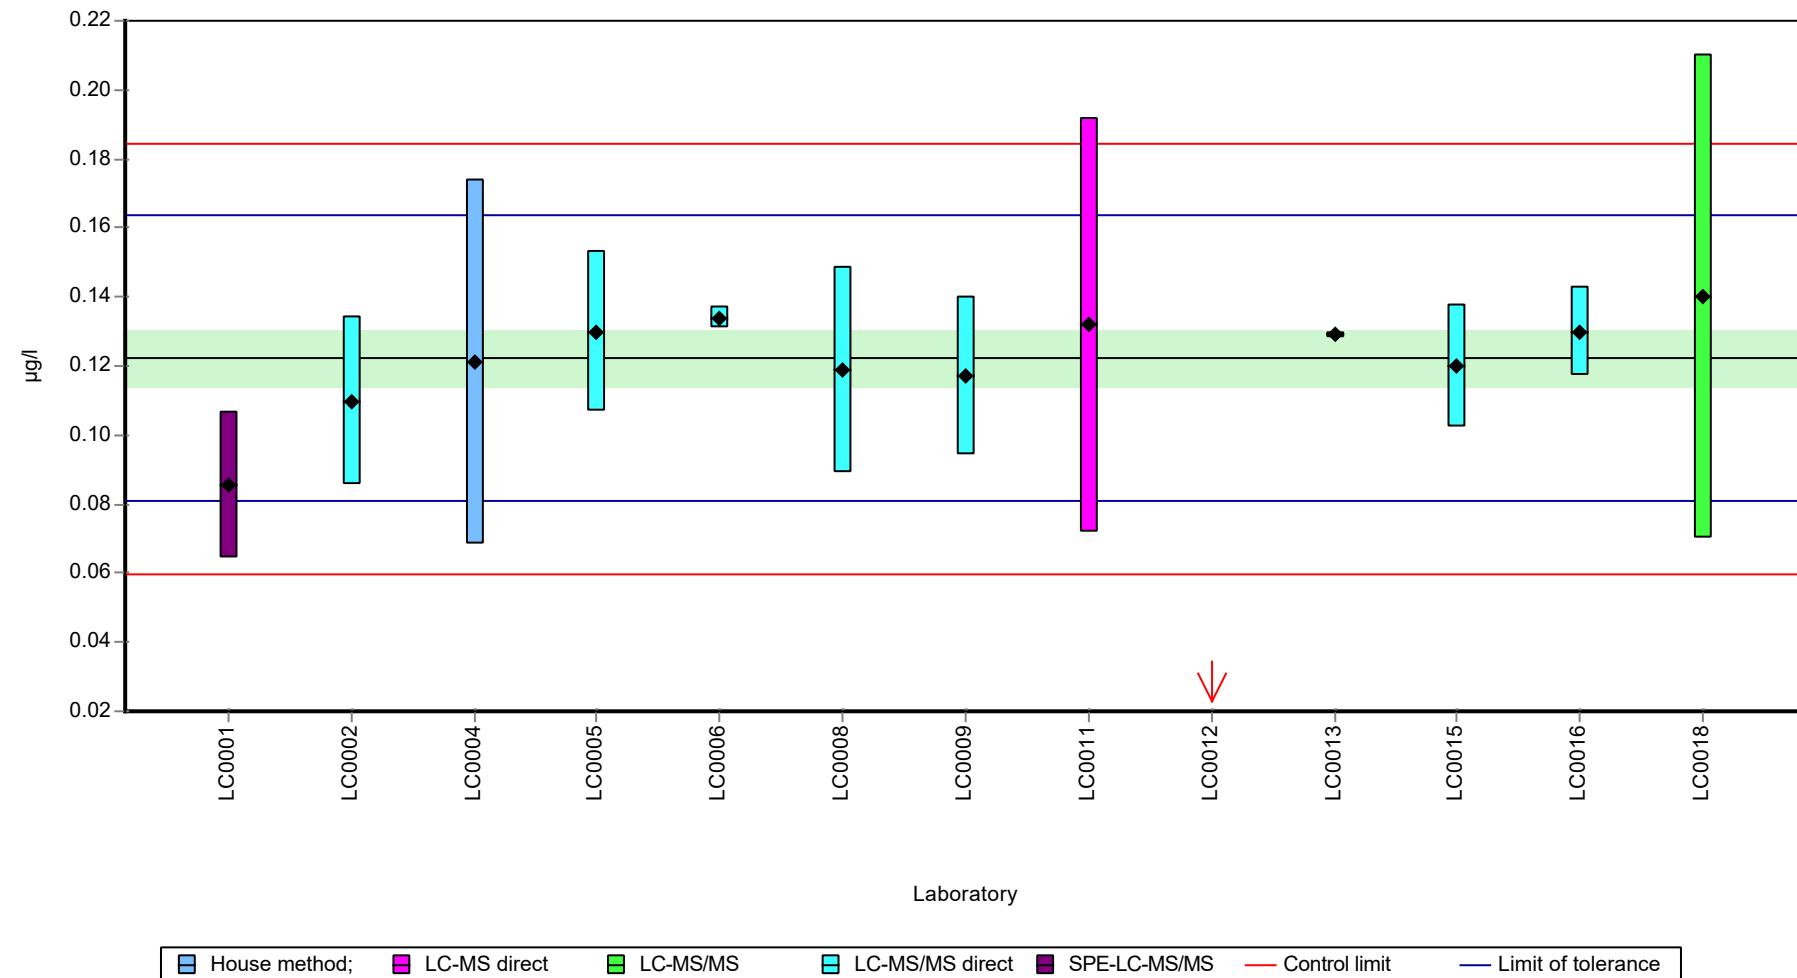


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Thiamethoxam

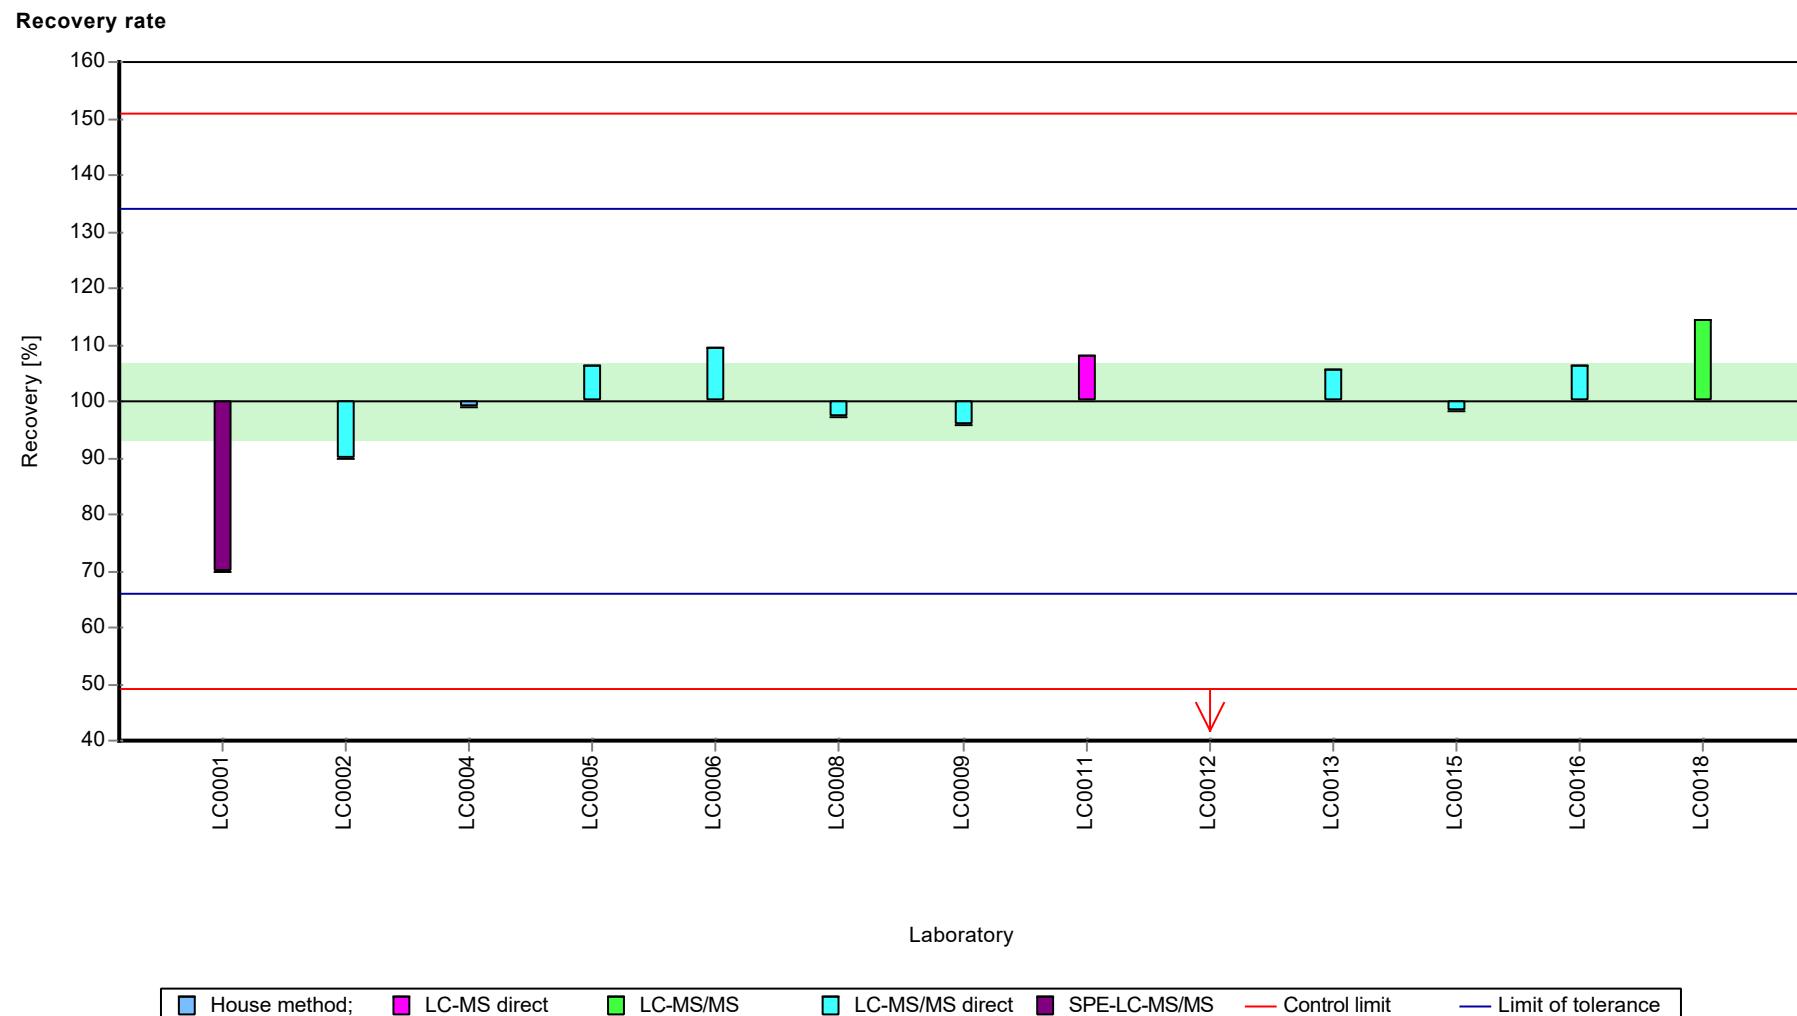

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114A, Parameter: Thiamethoxam

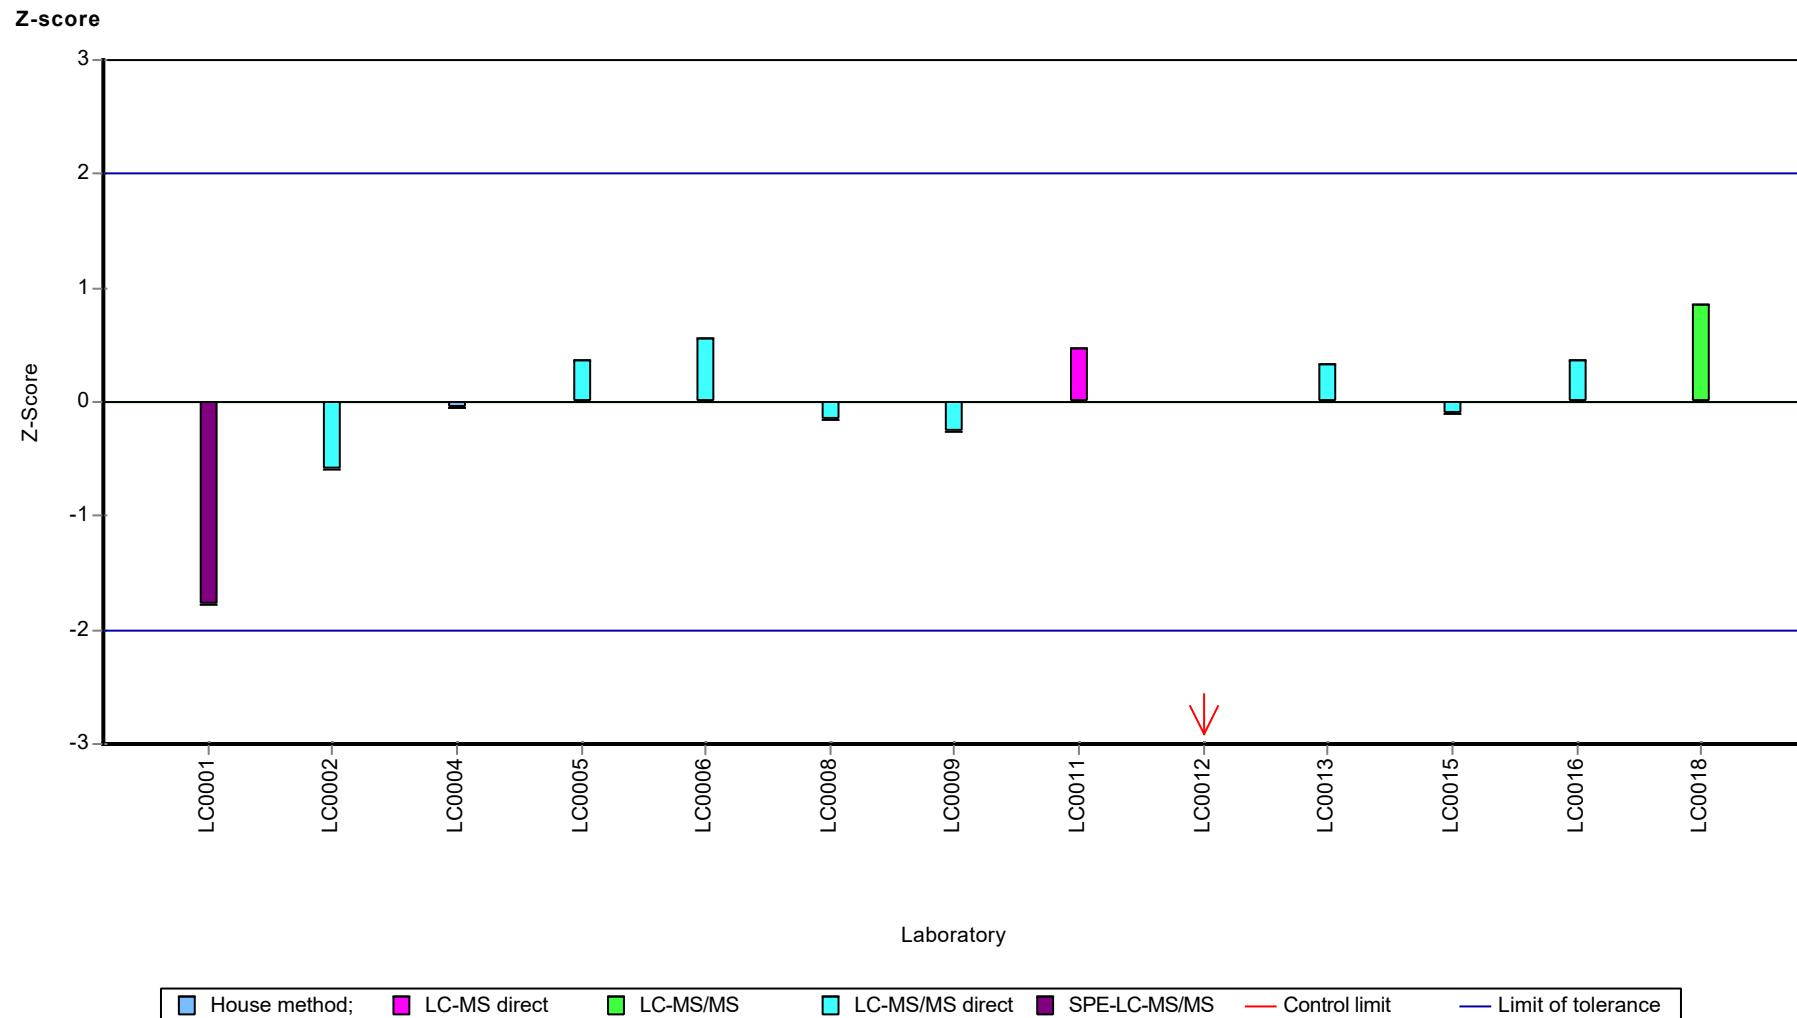

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Thiamethoxam

## Parameter oriented report

### H114 B

#### Thiamethoxam

Unit	µg/l
Assigned value ± U (k=2)	2.07 ± 0.102
Criterion	0.352 (17 %)
Minimum - Maximum	1.8 - 2.35
Control test value ± U (k=2)	1.830 ± 0.275

Labcode	Result	± U	Recovery [%]	z-score	Comments
LC0001	>0.4	0.1	-	-	
LC0002	1.8489	0.4128	89.2	-0.64	
LC0003	-	-	-	-	
LC0004	2.1	0.92	101	0.08	
LC0005	2.35	0.423	113	0.79	
LC0006	2.03	0.014	97.9	-0.12	
LC0007	-	-	-	-	
LC0008	1.243	0.311	60	-2.36	H
LC0009	2.084	0.417	101	0.03	
LC0010	-	-	-	-	
LC0011	1.795	0.6	86.6	-0.79	
LC0012	0.4513	0.2257	21.8	-4.6	H
LC0013	2.18	0.012	105	0.3	
LC0014	-	-	-	-	
LC0015	2.074	0.311	100	0.00	
LC0016	2.07	0.2	99.8	-0.01	
LC0017	-	-	-	-	
LC0018	2.2	1.1	106	0.36	
LC0019	-	-	-	-	

#### Characteristics of parameter


	all results	without outliers	Unit
Mean ± CI (99%)	1.87 ± 0.456	2.07 ± 0.153	µg/l
Minimum	0.451	1.8	µg/l
Maximum	2.35	2.35	µg/l
Standard deviation	0.527	0.161	µg/l
rel. standard deviation	28.2	7.79	%
n	12	10	-

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Thiamethoxam


**Graphical presentation of results**

**Results**

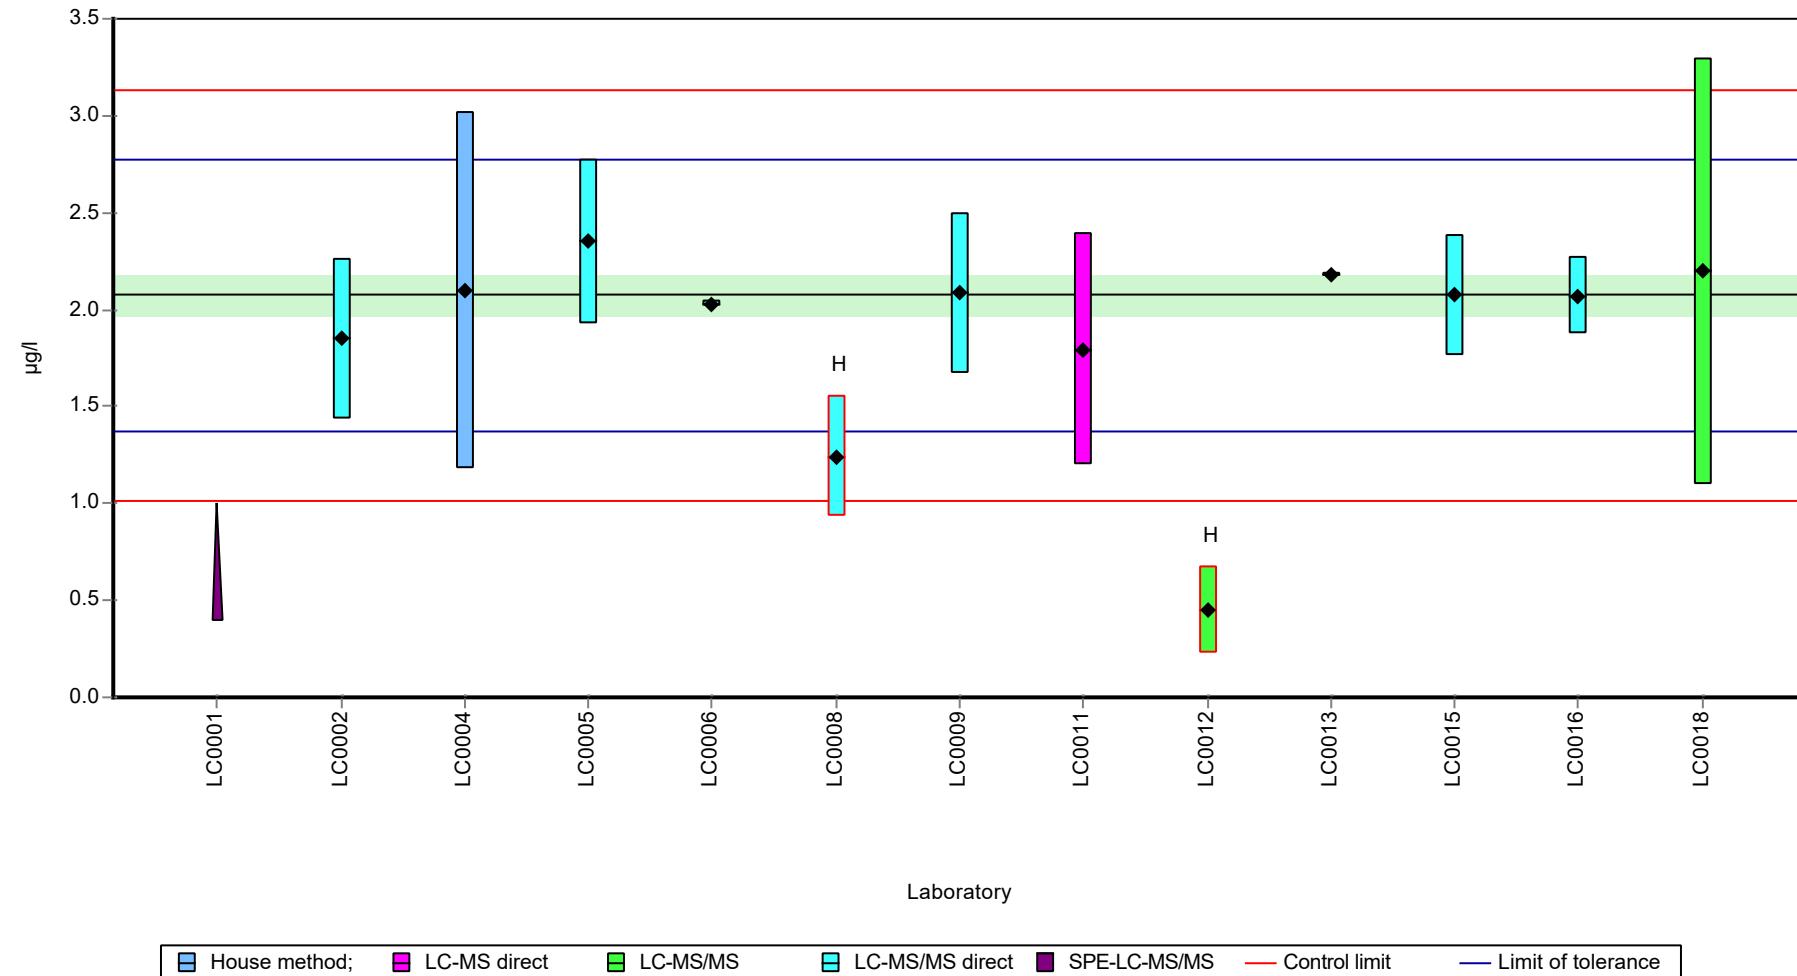


Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Thiamethoxam

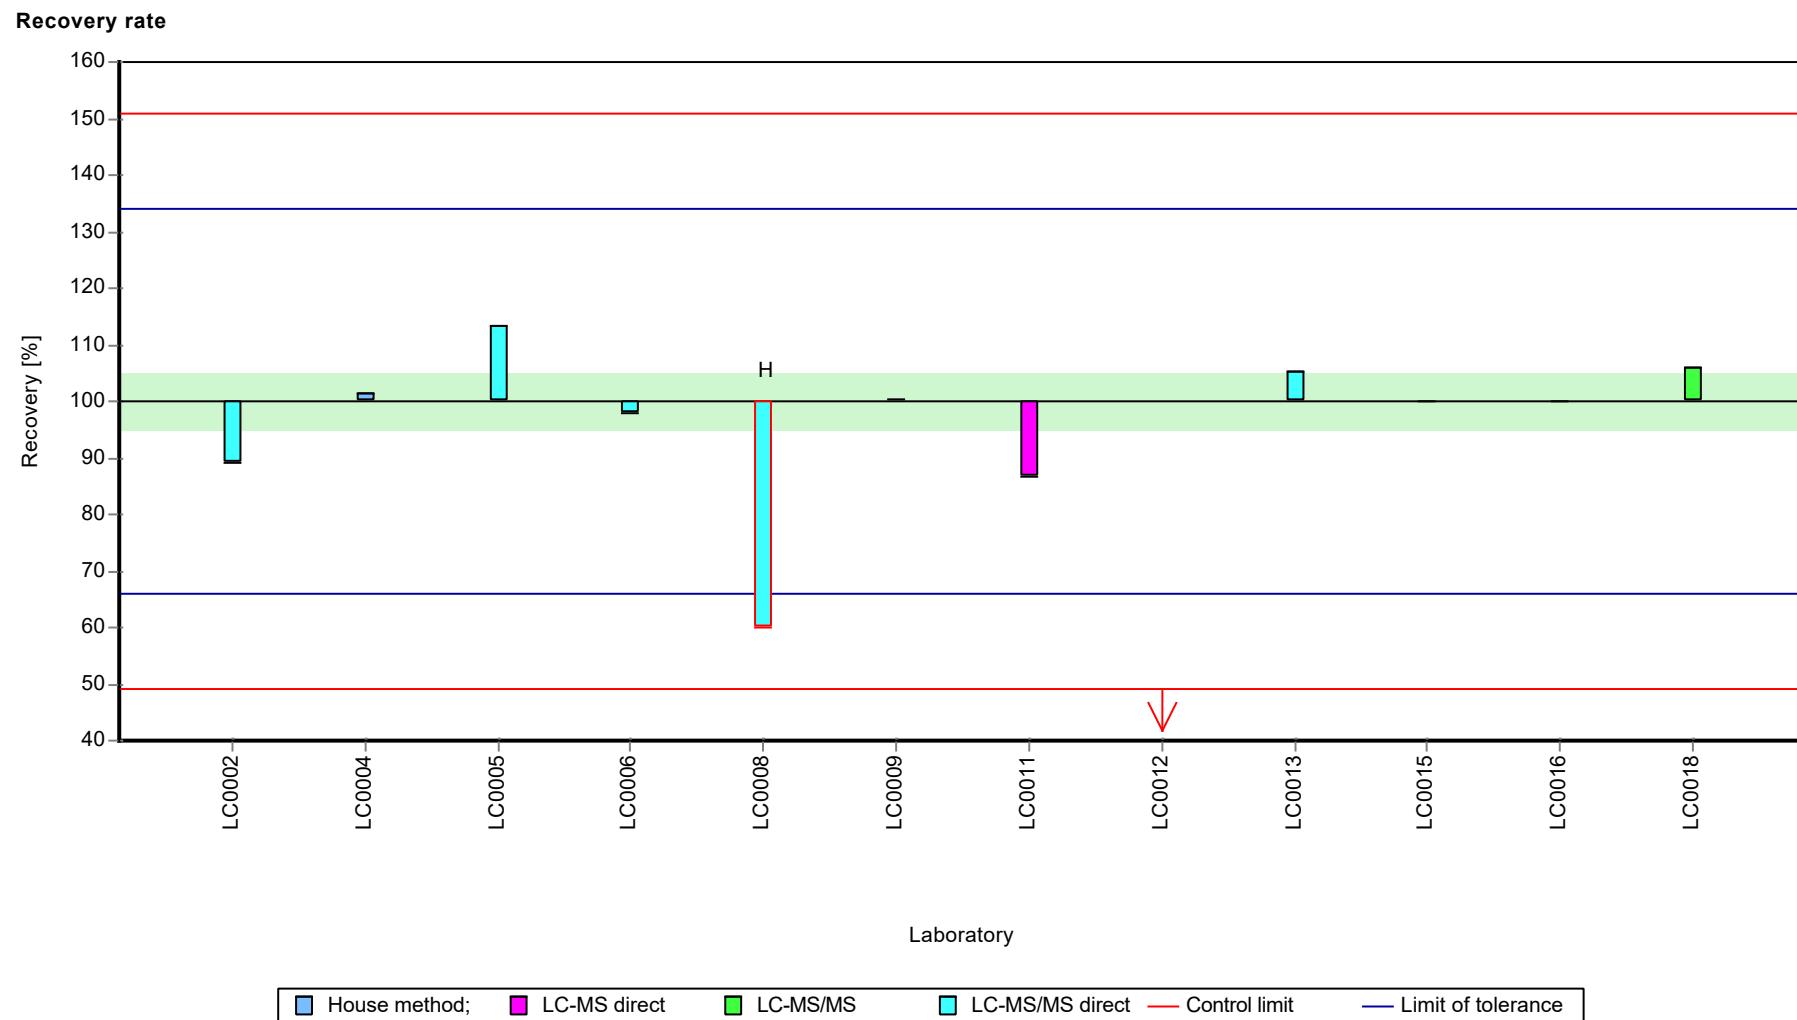

Parameter oriented report Pesticides H114

Sample: H114B, Parameter: Thiamethoxam

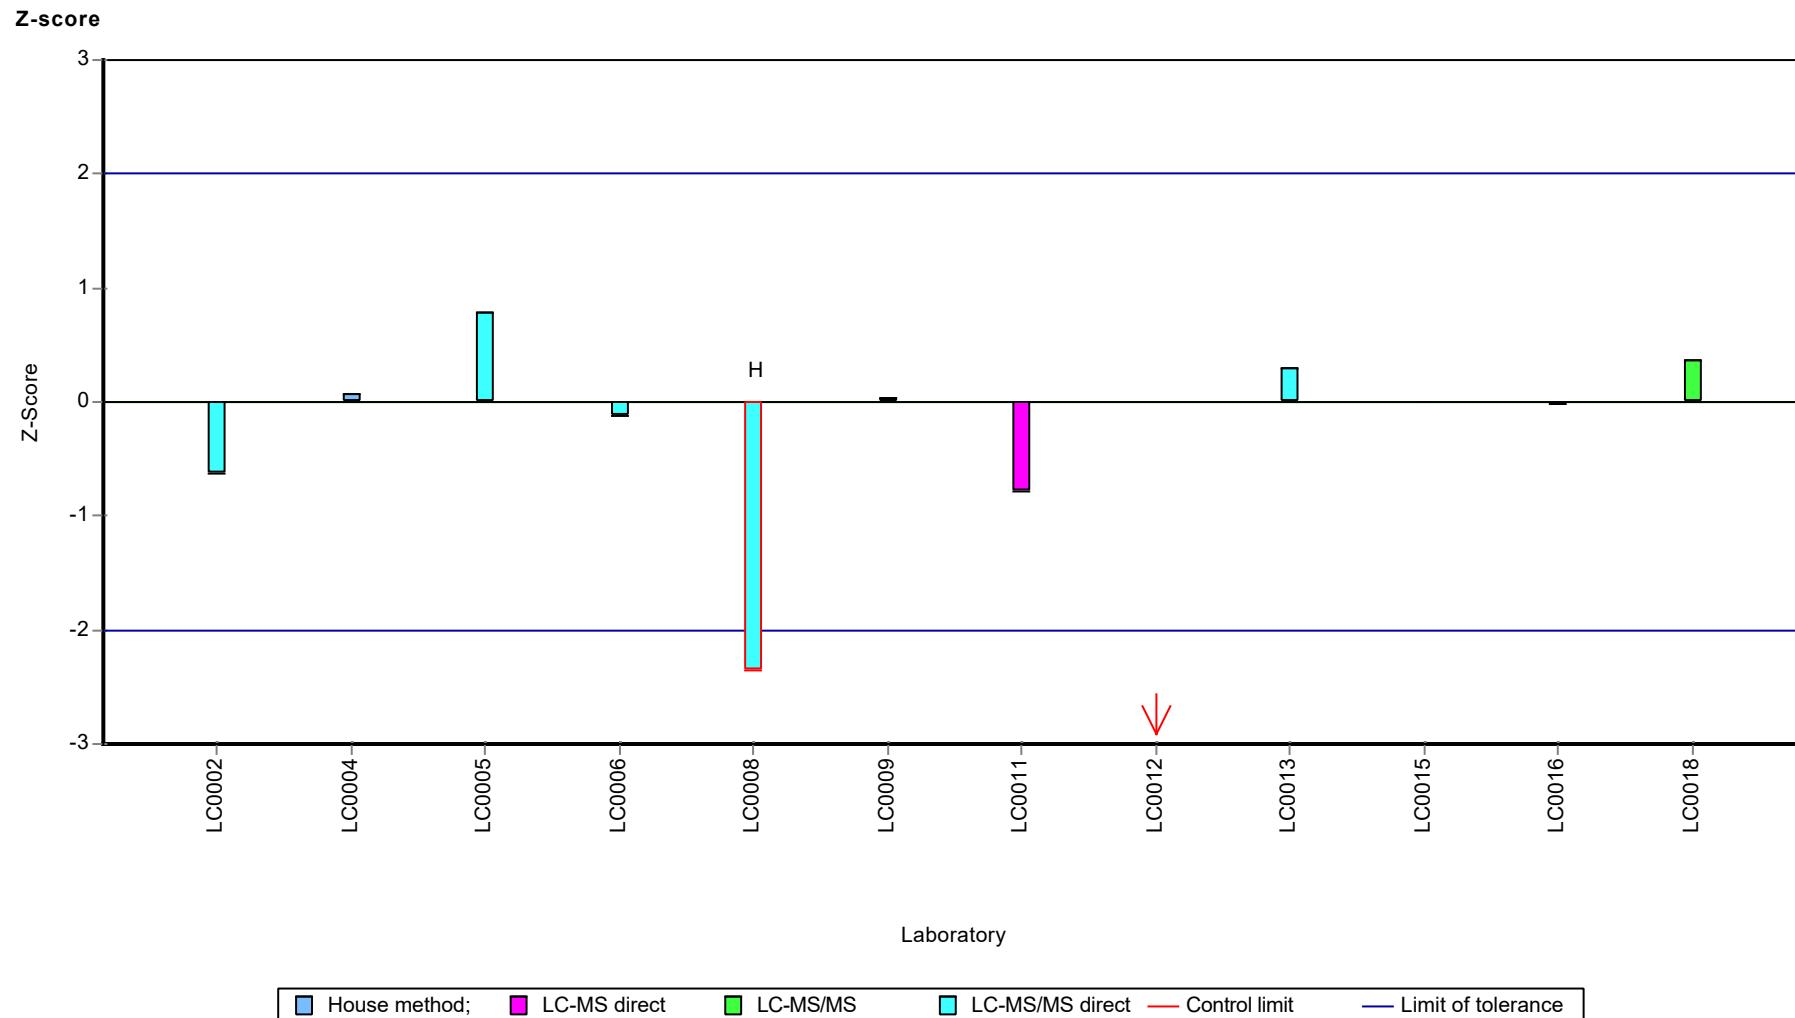

## **E8. Labororientierte Auswertung / Laboratory oriented report**

Die Labororientierte Auswertung ist nach dem Laborcode sortiert.

The laboratory oriented report is sorted by laboratory code.

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	>0.4 ± 0.1	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	>0.17 ± 0.0425	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.2006 ± 0.0502	0.0232	95.2	-0.43
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.1228 ± 0.0307	0.0135	99.8	-0.02
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	>0.17 ± 0.0425	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	>0.17 ± 0.0425	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.175 ± 0.0438	0.0433	162	1.54
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.3808 ± 0.0952	0.0628	90.9	-0.61
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.1325 ± 0.0331	0.0269	98.4	-0.08
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.2913 ± 0.0728	0.0933	128	0.68
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.117 ± 0.0292	0.0142	115	1.08
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.0854 ± 0.0214	0.0208	69.8	-1.77


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	>0.4 ± 0.1	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	>0.17 ± 0.0425	0.202	-	-

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0001

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	>0.4 ± 0.1	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	- -
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	>0.4 ± 0.1	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	>0.17 ± 0.0425	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	>0.17 ± 0.0425	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	>0.17 ± 0.0425	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	>0.4 ± 0.1	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	>0.17 ± 0.0425	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	>0.34 ± 0.085	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	>0.4 ± 0.1	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	>0.4 ± 0.1	0.352	- -

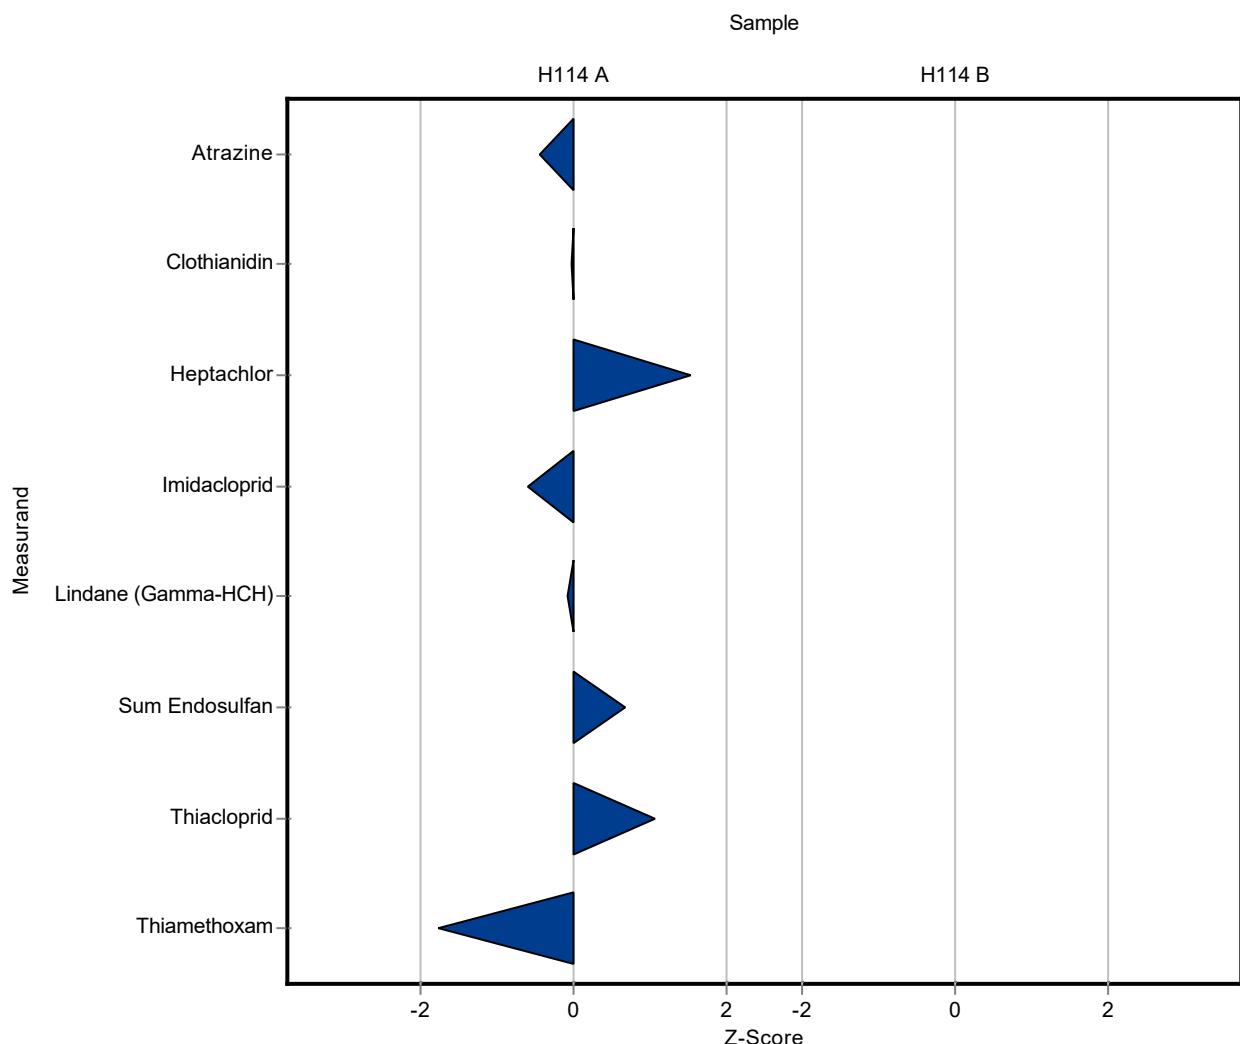


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.2006 ± 0.0502	0.0232	95.2	-0.10
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.1228 ± 0.0307	0.0135	99.8	0.00
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.175 ± 0.0438	0.0433	162	0.72
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.3808 ± 0.0952	0.0628	90.9	-0.20
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.1325 ± 0.0331	0.0269	98.4	-0.03
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.2913 ± 0.0728	0.0933	128	0.43
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.117 ± 0.0292	0.0142	115	0.26
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.0854 ± 0.0214	0.0208	69.8	-0.85

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	- -
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	- ± -	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

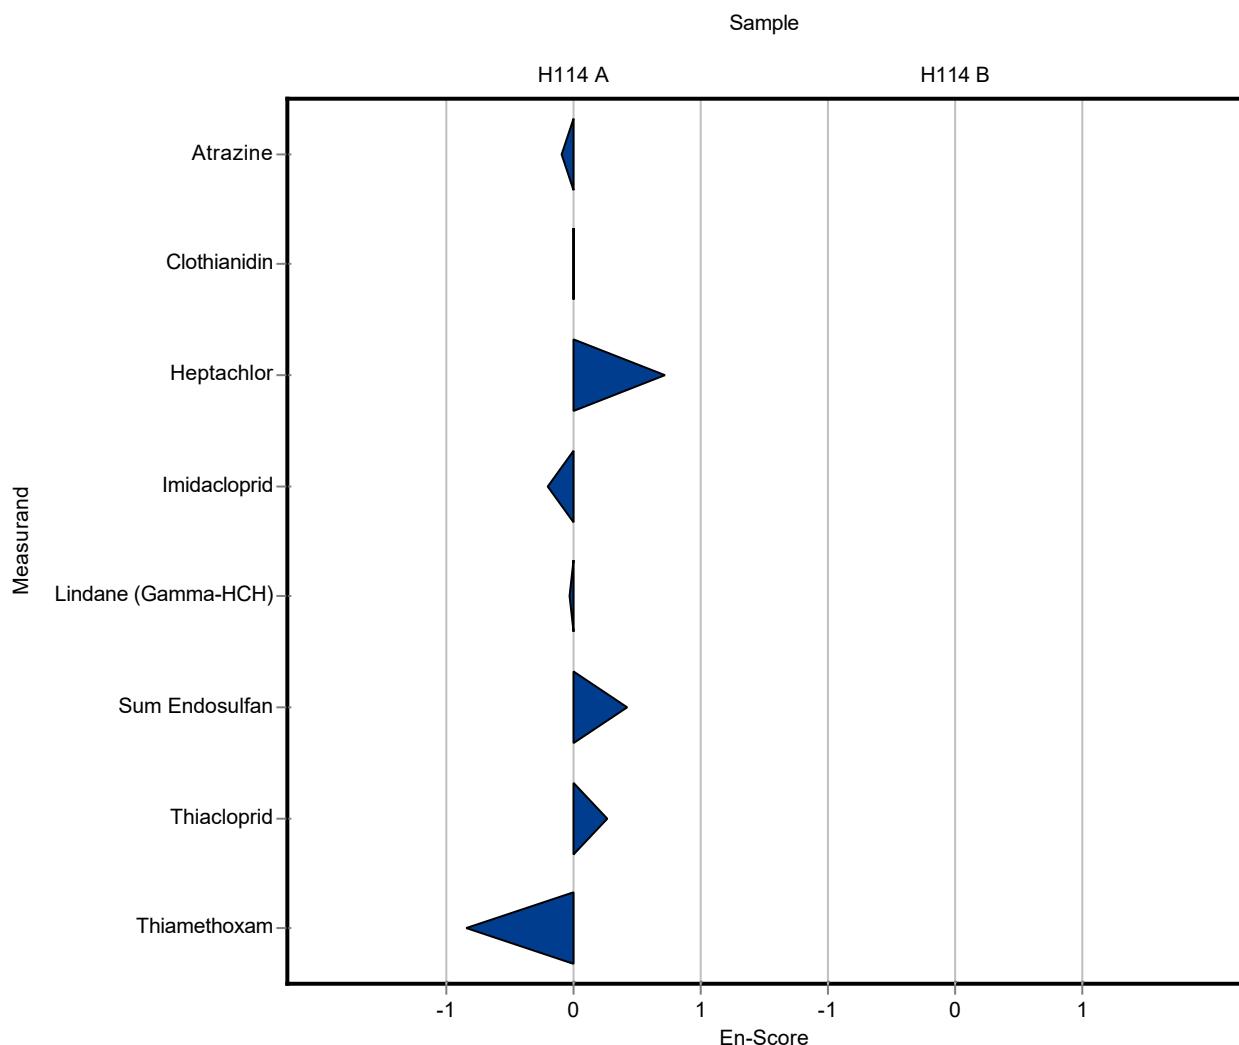

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.4058 ± 0.1034	0.0405	100	0.02
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.1335 ± 0.0464	0.0412	97.3	-0.09
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.2458 ± 0.0613	0.0232	117	1.52
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.232 ± 0.0711	0.027	103	0.25
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.309 ± 0.0873	0.0424	102	0.15
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.1273 ± 0.0304	0.0135	103	0.32
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.1756 ± 0.0656	0.0274	89.9	-0.72
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.1645 ± 0.0458	0.04	94.6	-0.23
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.1524 ± 0.0685	0.0543	104	0.10
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.1218 ± 0.053	0.0433	112	0.31
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.3707 ± 0.0924	0.0628	88.5	-0.77
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.1442 ± 0.0371	0.0269	107	0.35
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.2309 ± 0.056	0.0308	97.4	-0.20
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.0479 ± 0.0115	0.0174	79.8	-0.70
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.0582 ± 0.0216	0.0202	86.4	-0.45
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.2646 ± 0.1002	0.0769	114	0.41
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.0952 ± 0.0206	0.0142	93.7	-0.45
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.1098 ± 0.0245	0.0208	89.8	-0.60


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.1727 ± 0.2989	0.122	96.2	-0.38
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.6526 ± 0.2267	0.202	96.8	-0.11

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0002

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.0086 ± 0.5007	0.208	106 0.56
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.0336 ± 0.6233	0.254	96.1 -0.33
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.3701 ± 0.6698	0.32	104 0.27
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.8518 ± 0.443	0.208	98.1 -0.17
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.5024 ± 0.9351	0.393	89.2 -0.77
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.3957 ± 0.11	0.112	81.3 -0.81
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.4377 ± 0.1967	0.111	102 0.08
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.2729 ± 0.1187	0.14	78.2 -0.55
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	1.9967 ± 0.4976	0.327	91.7 -0.55
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.7596 ± 0.1951	0.146	104 0.21
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	1.6213 ± 0.3932	0.291	72.4 -2.12
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.4961 ± 0.358	0.262	74.2 -1.98
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.6134 ± 0.2278	0.192	96 -0.13
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.5654 ± 0.2128	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.326 ± 0.5022	0.334	97.5 -0.18
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	1.8489 ± 0.4128	0.352	89.2 -0.64

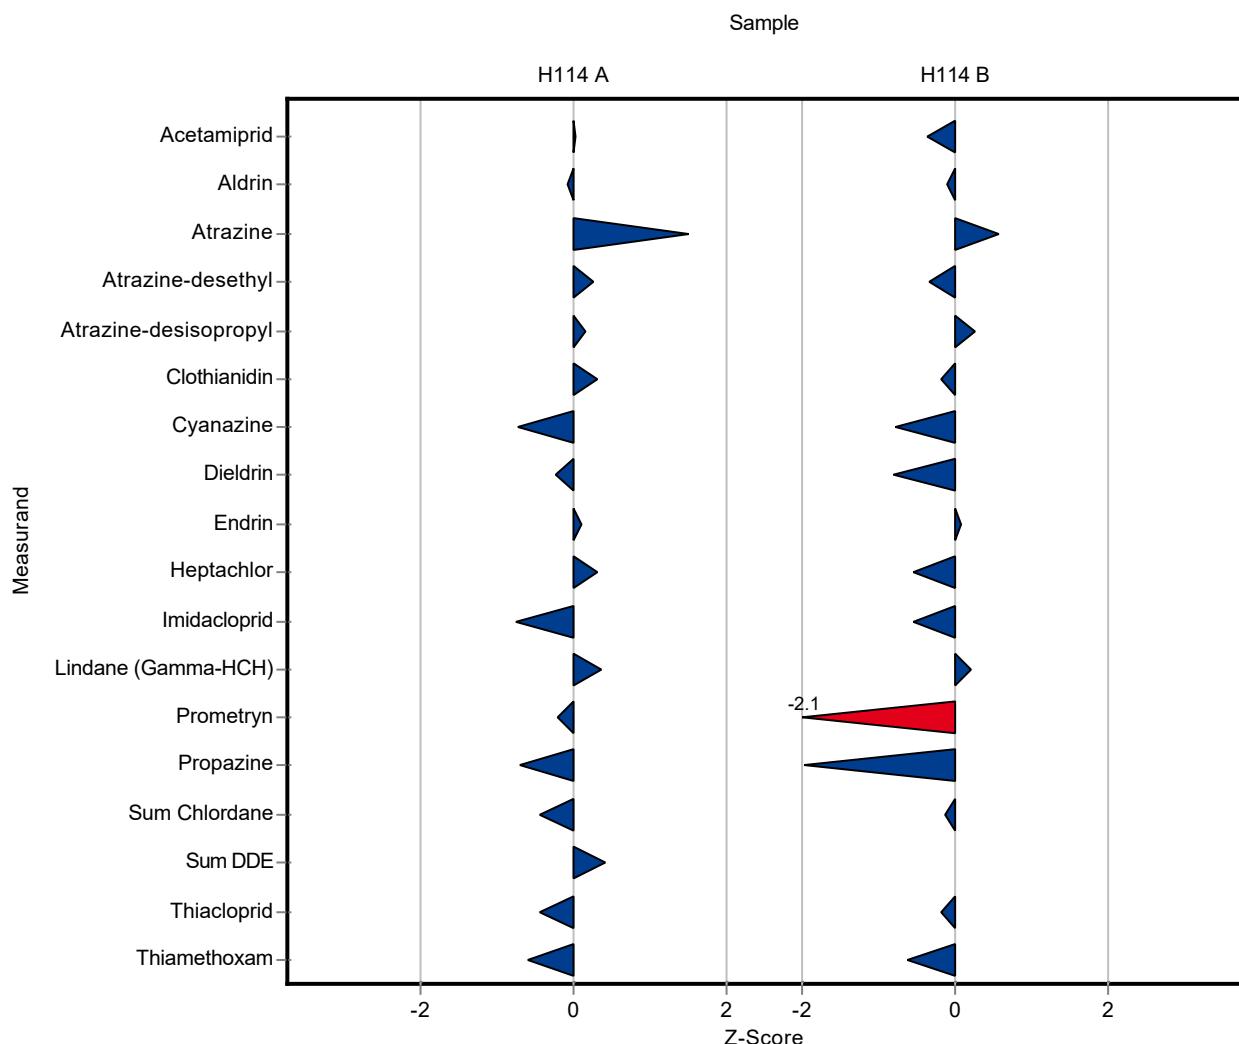


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.4058 ± 0.1034	0.0405	100	0.00
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.1335 ± 0.0464	0.0412	97.3	-0.04
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.2458 ± 0.0613	0.0232	117	0.29
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.232 ± 0.0711	0.027	103	0.05
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.309 ± 0.0873	0.0424	102	0.04
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.1273 ± 0.0304	0.0135	103	0.07
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.1756 ± 0.0656	0.0274	89.9	-0.15
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.1645 ± 0.0458	0.04	94.6	-0.10
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.1524 ± 0.0685	0.0543	104	0.04
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.1218 ± 0.053	0.0433	112	0.12
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.3707 ± 0.0924	0.0628	88.5	-0.26
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.1442 ± 0.0371	0.0269	107	0.13
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.2309 ± 0.056	0.0308	97.4	-0.05
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.0479 ± 0.0115	0.0174	79.8	-0.49
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.0582 ± 0.0216	0.0202	86.4	-0.21
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.2646 ± 0.1002	0.0769	114	0.15
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.0952 ± 0.0206	0.0142	93.7	-0.15
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.1098 ± 0.0245	0.0208	89.8	-0.25

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.1727 ± 0.2989	0.122	96.2	-0.08
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.6526 ± 0.2267	0.202	96.8	-0.05

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.0086 ± 0.5007	0.208	106 0.12
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.0336 ± 0.6233	0.254	96.1 -0.07
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.3701 ± 0.6698	0.32	104 0.06
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.8518 ± 0.443	0.208	98.1 -0.04
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.5024 ± 0.9351	0.393	89.2 -0.16
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.3957 ± 0.11	0.112	81.3 -0.40
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.4377 ± 0.1967	0.111	102 0.02
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.2729 ± 0.1187	0.14	78.2 -0.31
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	1.9967 ± 0.4976	0.327	91.7 -0.18
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.7596 ± 0.1951	0.146	104 0.08
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	1.6213 ± 0.3932	0.291	72.4 -0.78
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.4961 ± 0.358	0.262	74.2 -0.71
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.6134 ± 0.2278	0.192	96 -0.05
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.5654 ± 0.2128	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.326 ± 0.5022	0.334	97.5 -0.06
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	1.8489 ± 0.4128	0.352	89.2 -0.27

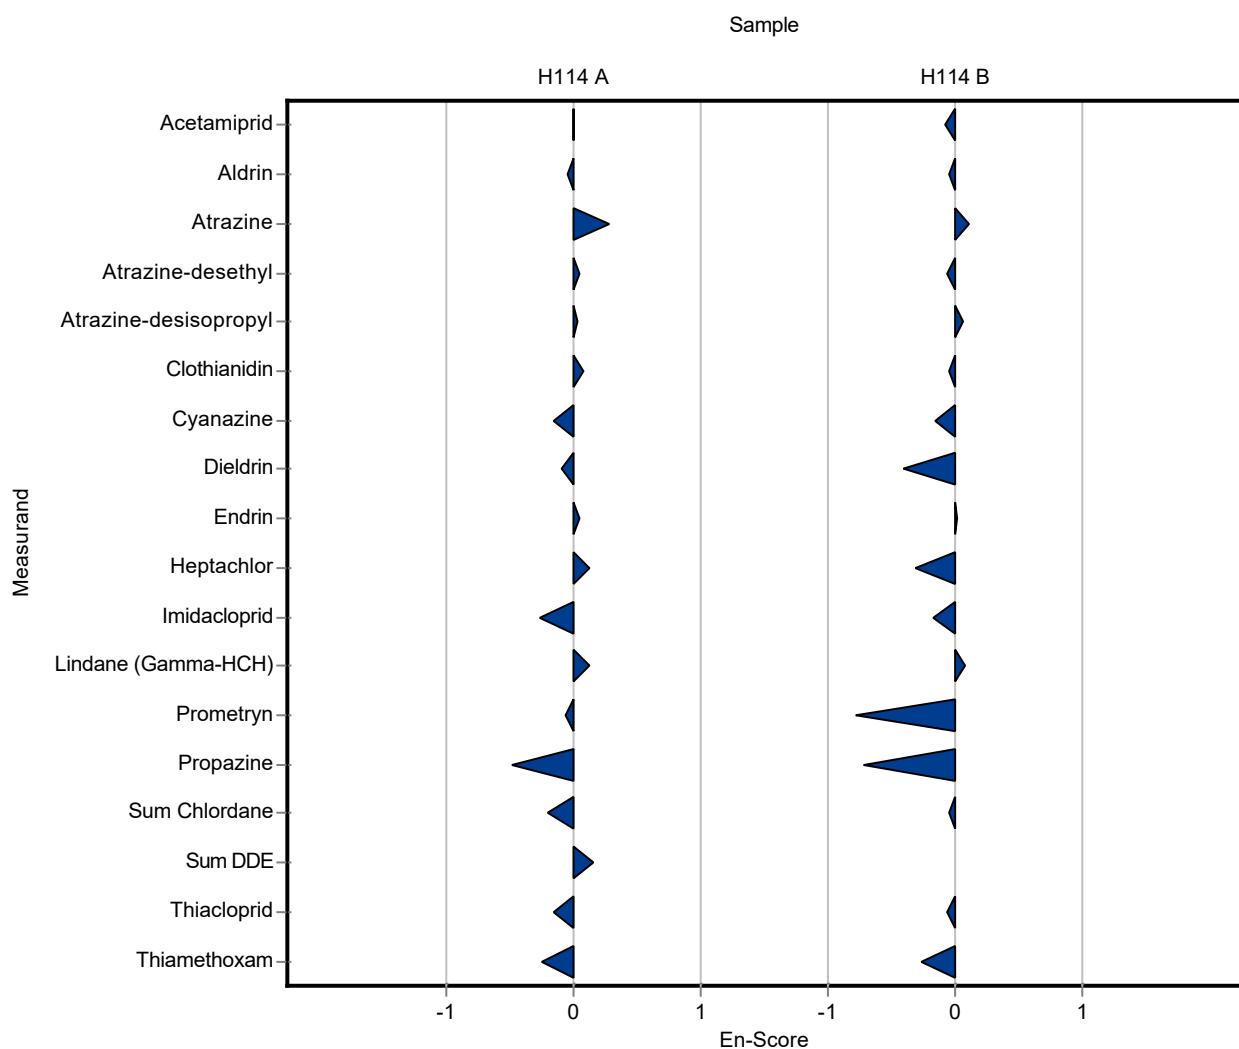

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.142 ± 0.00425	0.0412	103	0.12
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.169 ± 0.00508	0.04	97.2	-0.12
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.186 ± 0.00559	0.0543	127	0.72
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.128 ± 0.00385	0.0433	118	0.45
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.127 ± 0.00382	0.0269	94.3	-0.29
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	- ± -	0.0142	-	-
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.438 ± 0.0132	0.202	65	-1.17

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0003

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	- -
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.58 ± 0.0107	0.112	119 0.83
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.43 ± 0.0129	0.111	100 0.01
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.247 ± 0.00742	0.14	70.8 -0.73
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.432 ± 0.013	0.146	59.3 -2.04
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	- ± -	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

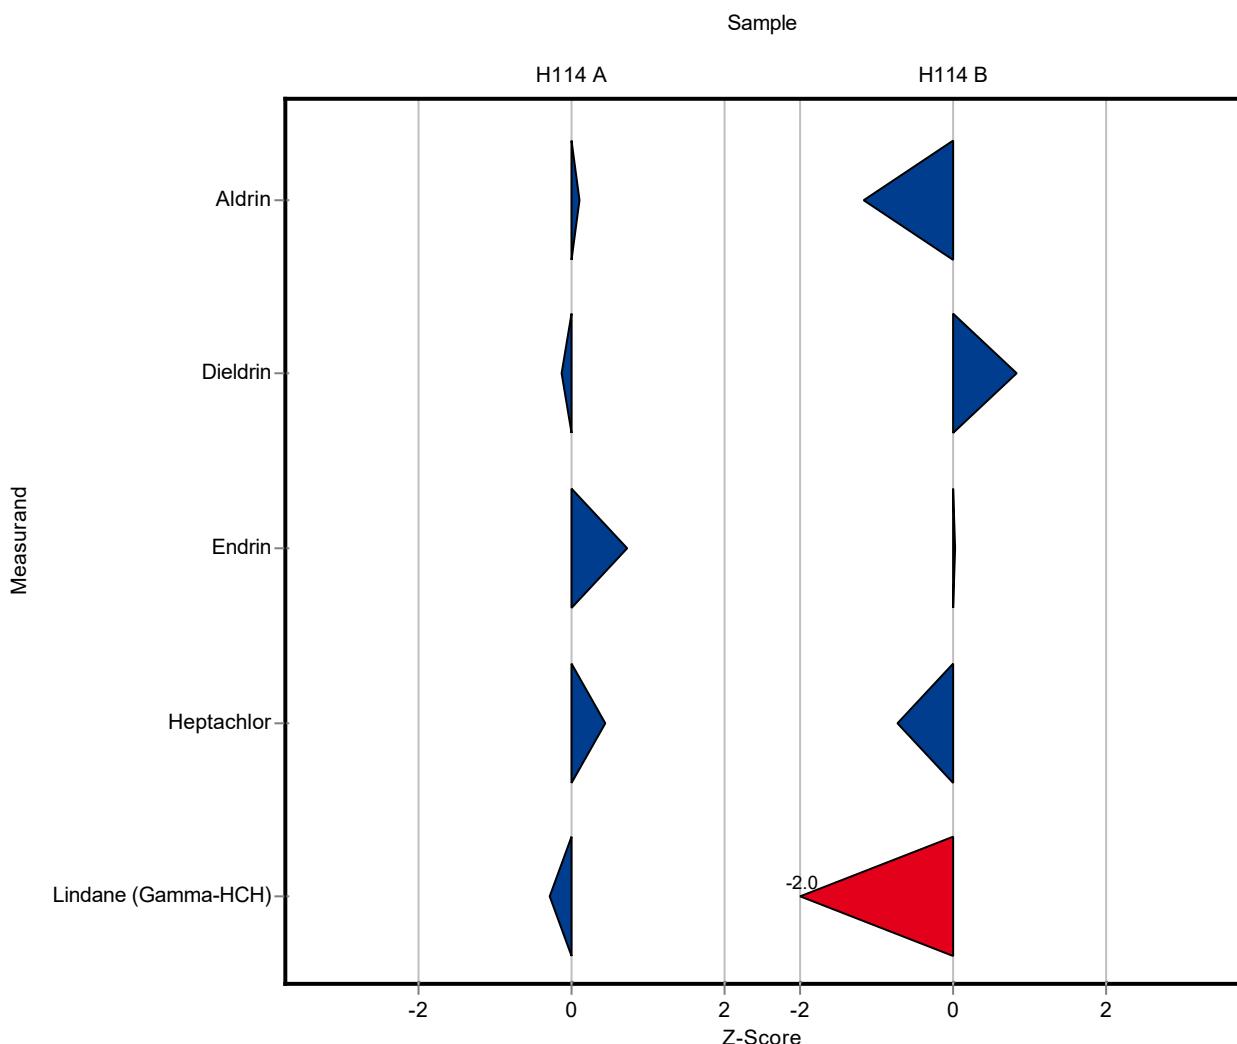


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.142 ± 0.00425	0.0412	103	0.28
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.169 ± 0.00508	0.04	97.2	-0.28
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.186 ± 0.00559	0.0543	127	1.03
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.128 ± 0.00385	0.0433	118	0.61
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.127 ± 0.00382	0.0269	94.3	-0.69
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	- ± -	0.0142	-	-
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.438 ± 0.0132	0.202	65	-2.38

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	- -
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.58 ± 0.0107	0.112	119 1.66
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.43 ± 0.0129	0.111	100 0.02
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.247 ± 0.00742	0.14	70.8 -1.52
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.432 ± 0.013	0.146	59.3 -7.07
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	- ± -	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

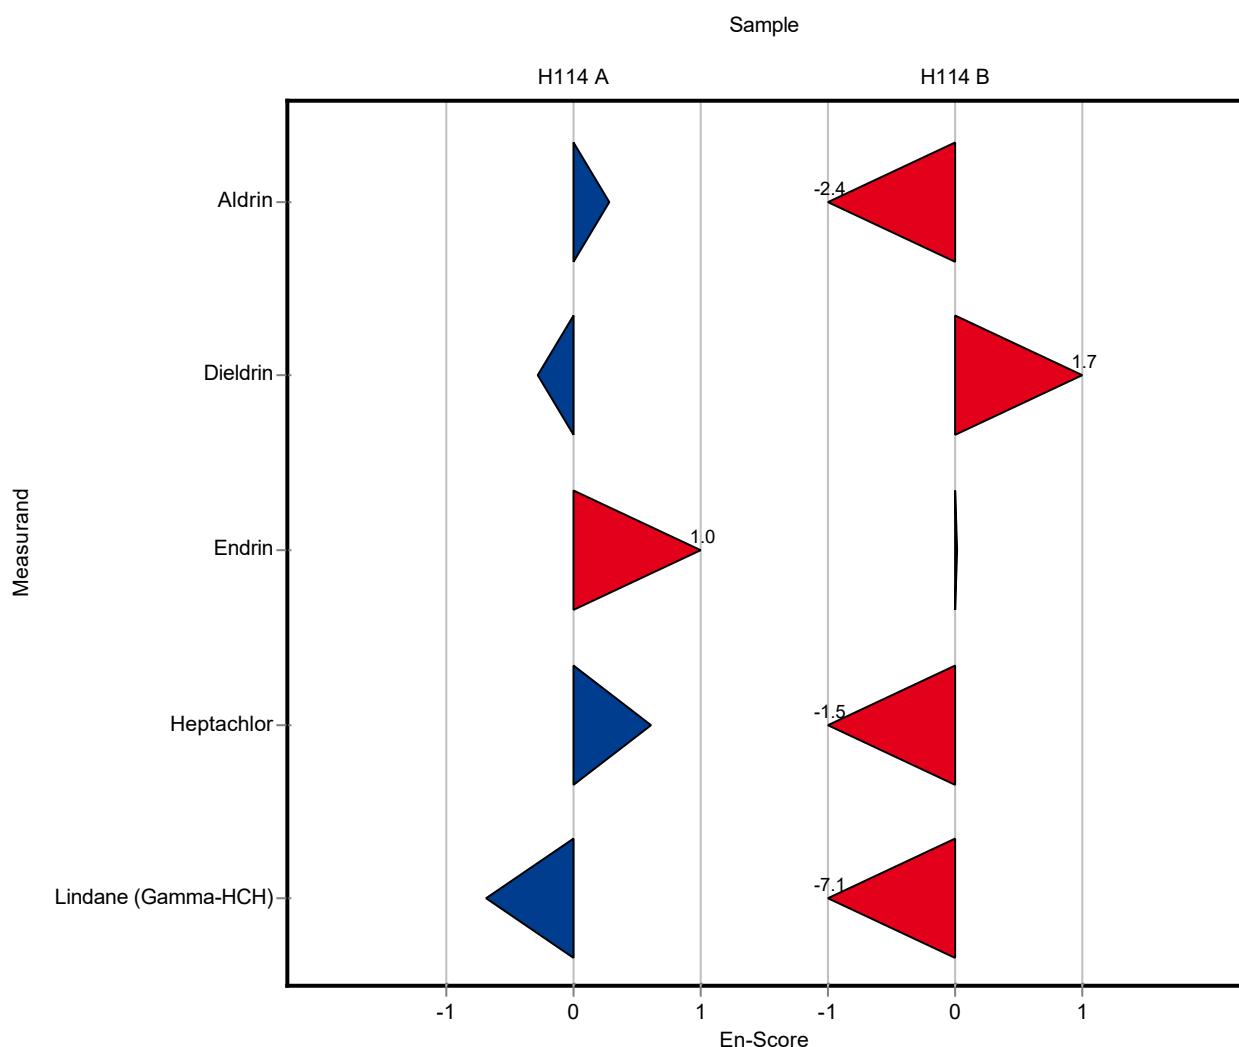

## Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.425 ± 0.14	0.0405	105	0.50
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.278 ± 0.122	0.0424	91.8	-0.58
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.212 ± 0.093	0.0311	95.5	-0.32
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.121 ± 0.053	0.0135	98.4	-0.15
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.395 ± 0.119	0.0628	94.3	-0.38
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.106 ± 0.036	0.0142	104	0.31
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.121 ± 0.053	0.0208	99	-0.06


## Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.35 ± 0.44	0.122	111	1.08
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0004

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.12 ± 0.93	0.32	92.9 -0.51
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.77 ± 0.78	0.248	100 0.01
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.85 ± 0.81	0.208	98 -0.18
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.19 ± 0.66	0.327	101 0.04
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.57 ± 0.87	0.334	108 0.55
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.1 ± 0.92	0.352	101 0.08

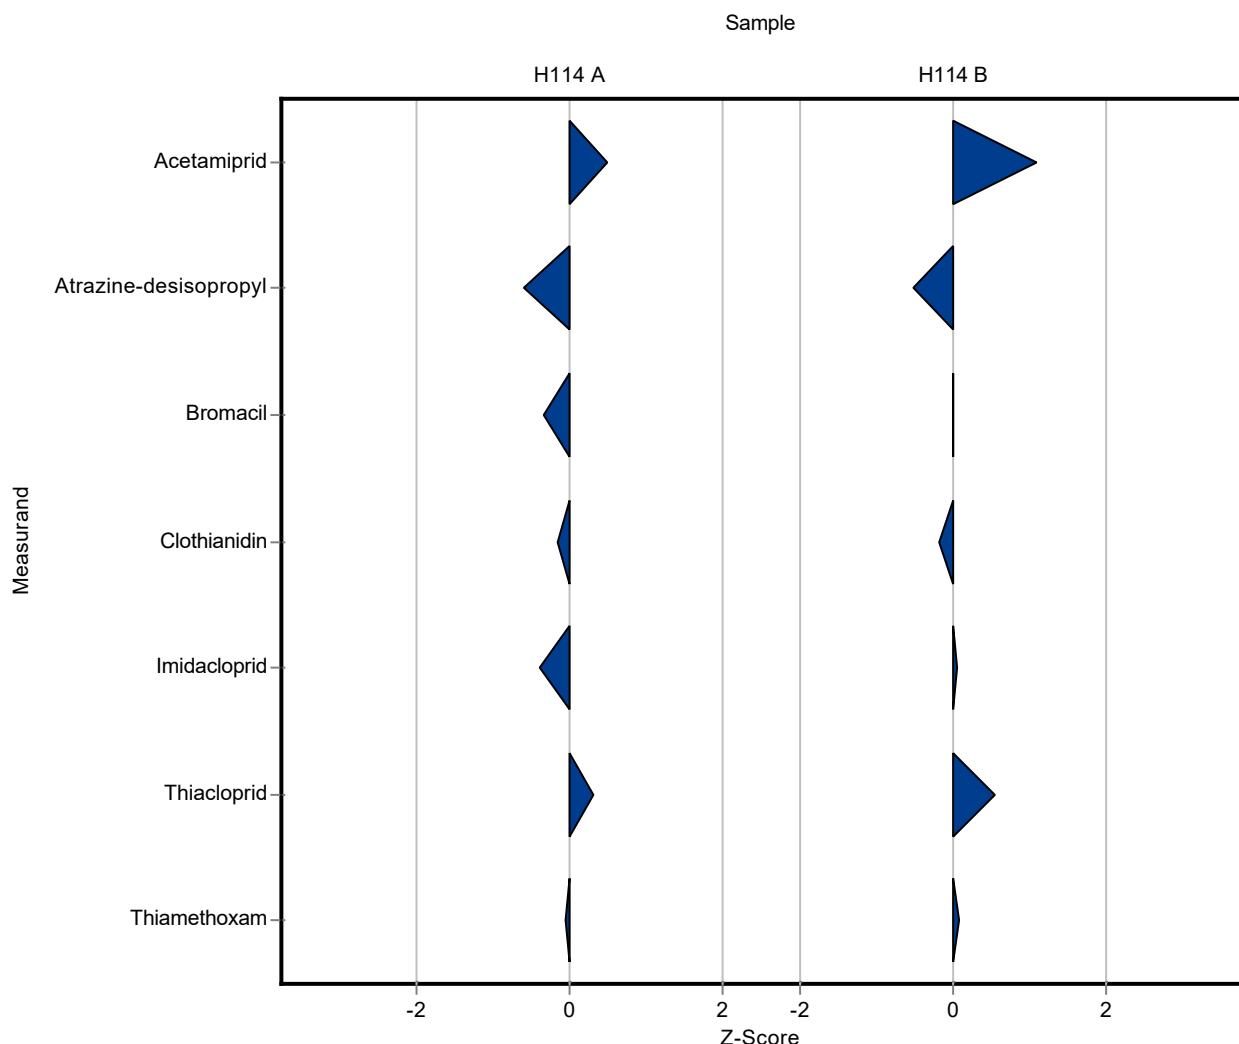


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.425 ± 0.14	0.0405	105	0.07
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.278 ± 0.122	0.0424	91.8	-0.10
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.212 ± 0.093	0.0311	95.5	-0.05
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.121 ± 0.053	0.0135	98.4	-0.02
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.395 ± 0.119	0.0628	94.3	-0.10
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.106 ± 0.036	0.0142	104	0.06
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.121 ± 0.053	0.0208	99	-0.01

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.35 ± 0.44	0.122	111	0.15
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.12 ± 0.93	0.32	92.9 -0.09
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.77 ± 0.78	0.248	100 0.00
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.85 ± 0.81	0.208	98 -0.02
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.19 ± 0.66	0.327	101 0.01
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.57 ± 0.87	0.334	108 0.11
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.1 ± 0.92	0.352	101 0.01

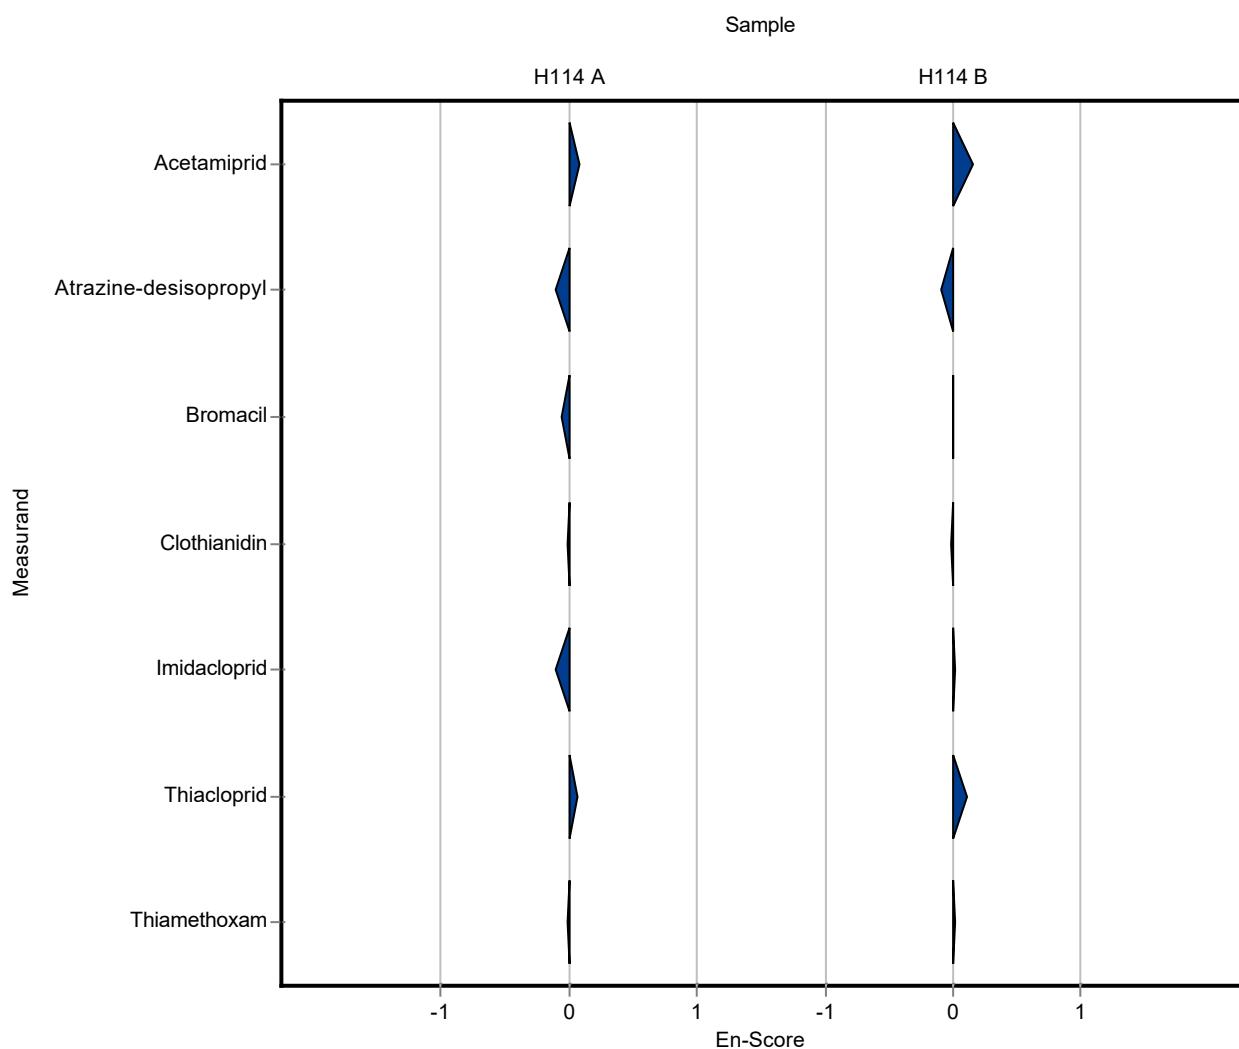

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.143 ± 0.026	0.0412	104	0.14
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.207 ± 0.037	0.0232	98.3	-0.16
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.224 ± 0.04	0.027	99.5	-0.05
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.341 ± 0.061	0.0424	113	0.90
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.2 ± 0.036	0.0311	90.1	-0.71
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.144 ± 0.026	0.0135	117	1.55
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.187 ± 0.034	0.0274	95.7	-0.31
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.191 ± 0.034	0.04	110	0.43
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.147 ± 0.026	0.0543	100	0.01
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.117 ± 0.021	0.0433	108	0.20
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.464 ± 0.0836	0.0628	111	0.72
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.151 ± 0.027	0.0269	112	0.61
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.233 ± 0.042	0.0308	98.3	-0.13
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.061 ± 0.011	0.0174	102	0.06
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.076 ± 0.014	0.0202	113	0.43
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.293 ± 0.053	0.0752	117	0.56
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.328 ± 0.059	0.0769	141	1.24
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.209 ± 0.038	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.243 ± 0.044	0.0933	107	0.17
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.103 ± 0.0185	0.0142	101	0.10
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.13 ± 0.0234	0.0208	106	0.37


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.755 ± 0.136	0.202	112	0.40

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0005

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.947 ± 0.35	0.208	103 0.27
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.11 ± 0.38	0.254	99.7 -0.02
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.506 ± 0.451	0.32	110 0.70
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.65 ± 0.297	0.248	93.3 -0.48
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	2.224 ± 0.4	0.208	118 1.62
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.774 ± 0.499	0.393	98.9 -0.08
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.542 ± 0.098	0.112	111 0.49
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.357 ± 0.064	0.111	83.3 -0.64
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.339 ± 0.061	0.14	97.1 -0.07
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.43 ± 0.437	0.327	112 0.78
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.772 ± 0.139	0.146	106 0.30
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.115 ± 0.381	0.291	94.5 -0.42
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.022 ± 0.364	0.262	100 0.03
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.753 ± 0.136	0.192	118 0.59
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.822 ± 0.148	0.187	132 1.06
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.649 ± 0.117	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.668 ± 0.12	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.817 ± 0.147	0.273	123 0.56
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.386 ± 0.43	0.334	100 0.00
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.35 ± 0.423	0.352	113 0.79

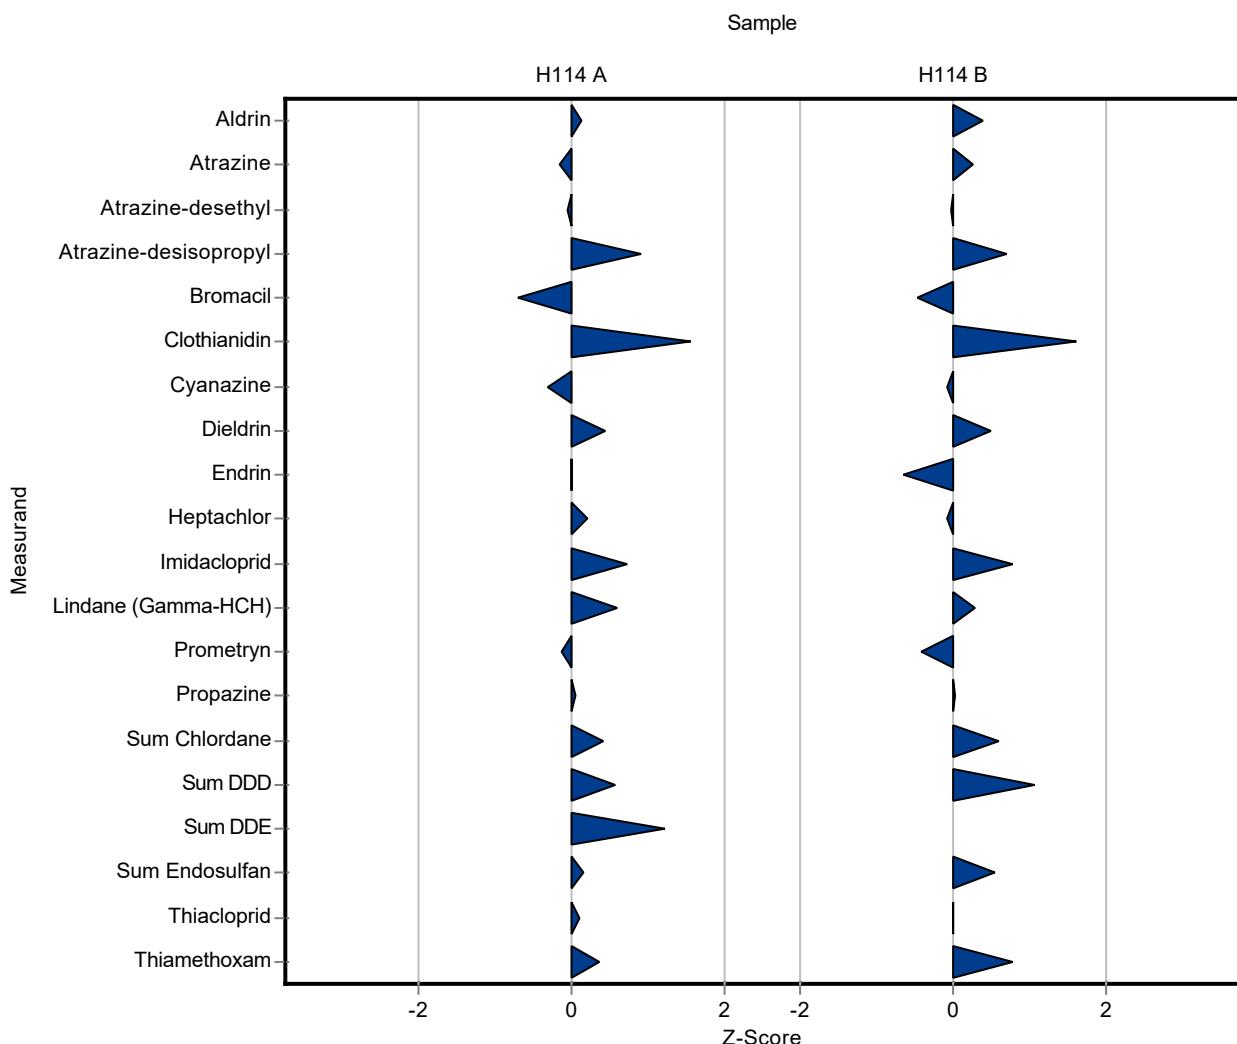


## Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.143 ± 0.026	0.0412	104	0.11
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.207 ± 0.037	0.0232	98.3	-0.05
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.224 ± 0.04	0.027	99.5	-0.02
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.341 ± 0.061	0.0424	113	0.31
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.2 ± 0.036	0.0311	90.1	-0.30
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.144 ± 0.026	0.0135	117	0.40
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.187 ± 0.034	0.0274	95.7	-0.12
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.191 ± 0.034	0.04	110	0.25
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.147 ± 0.026	0.0543	100	0.00
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.117 ± 0.021	0.0433	108	0.17
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.464 ± 0.0836	0.0628	111	0.27
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.151 ± 0.027	0.0269	112	0.30
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.233 ± 0.042	0.0308	98.3	-0.05
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.061 ± 0.011	0.0174	102	0.04
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.076 ± 0.014	0.0202	113	0.29
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.293 ± 0.053	0.0752	117	0.39
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.328 ± 0.059	0.0769	141	0.72
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.209 ± 0.038	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.243 ± 0.044	0.0933	107	0.16
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.103 ± 0.0185	0.0142	101	0.04
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.13 ± 0.0234	0.0208	106	0.16

## Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.755 ± 0.136	0.202	112	0.28

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.947 ± 0.35	0.208	103	0.08
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.11 ± 0.38	0.254	99.7	-0.01
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.506 ± 0.451	0.32	110	0.24
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.65 ± 0.297	0.248	93.3	-0.19
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	2.224 ± 0.4	0.208	118	0.41
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.774 ± 0.499	0.393	98.9	-0.03
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.542 ± 0.098	0.112	111	0.27
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.357 ± 0.064	0.111	83.3	-0.46
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.339 ± 0.061	0.14	97.1	-0.07
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.43 ± 0.437	0.327	112	0.29
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.772 ± 0.139	0.146	106	0.16
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.115 ± 0.381	0.291	94.5	-0.16
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.022 ± 0.364	0.262	100	0.01
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.753 ± 0.136	0.192	118	0.37
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.822 ± 0.148	0.187	132	0.63
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.649 ± 0.117	-	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.668 ± 0.12	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.817 ± 0.147	0.273	123	0.47
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.386 ± 0.43	0.334	100	0.00
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.35 ± 0.423	0.352	113	0.32

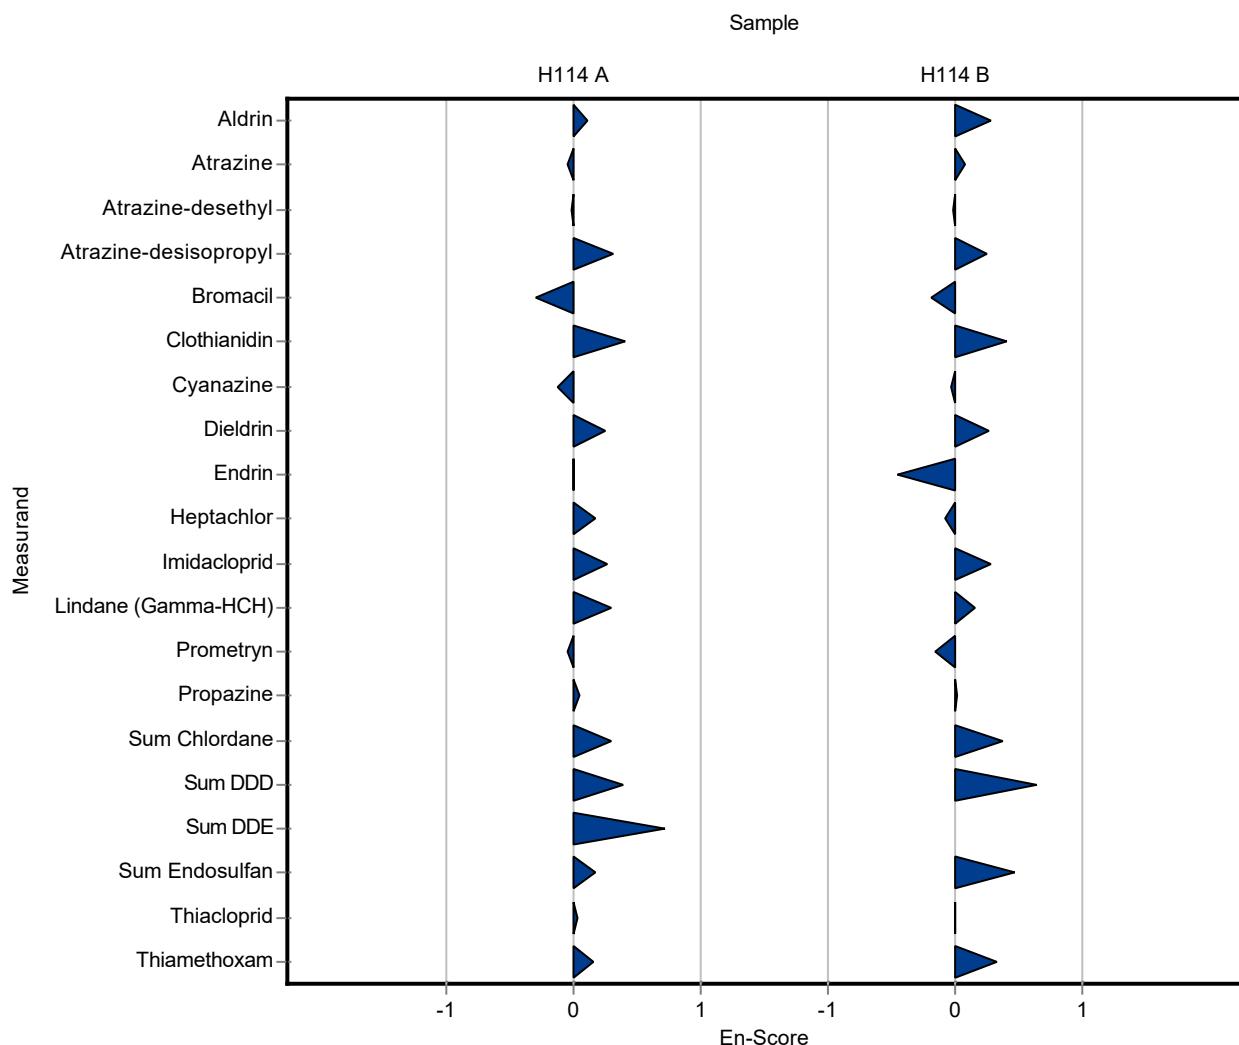

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.18 ± 0.002	0.0232	85.4	-1.32
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.209 ± 0.003	0.027	92.8	-0.60
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.239 ± 0.005	0.0424	79	-1.50
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.22 ± 0.009	0.0311	99.1	-0.07
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.169 ± 0.005	0.0274	86.5	-0.96
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.39 ± 0.01	0.0628	93.1	-0.46
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.22 ± 0.006	0.0308	92.8	-0.55
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.046 ± 0.007	0.0174	76.6	-0.81
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.094 ± 0.007	0.0142	92.5	-0.54
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.134 ± 0.003	0.0208	110	0.56


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0006

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.71 ± 0.009	0.208	90.4 -0.87
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.03 ± 0.014	0.254	95.9 -0.34
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	1.99 ± 0.028	0.32	87.2 -0.92
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.64 ± 0.044	0.248	92.8 -0.52
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.56 ± 0.03	0.393	91.2 -0.63
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	1.97 ± 0.05	0.327	90.5 -0.63
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.16 ± 0.03	0.291	96.5 -0.27
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.62 ± 0.035	0.262	80.4 -1.51
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	1.94 ± 0.037	0.334	81.3 -1.34
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.03 ± 0.014	0.352	97.9 -0.12

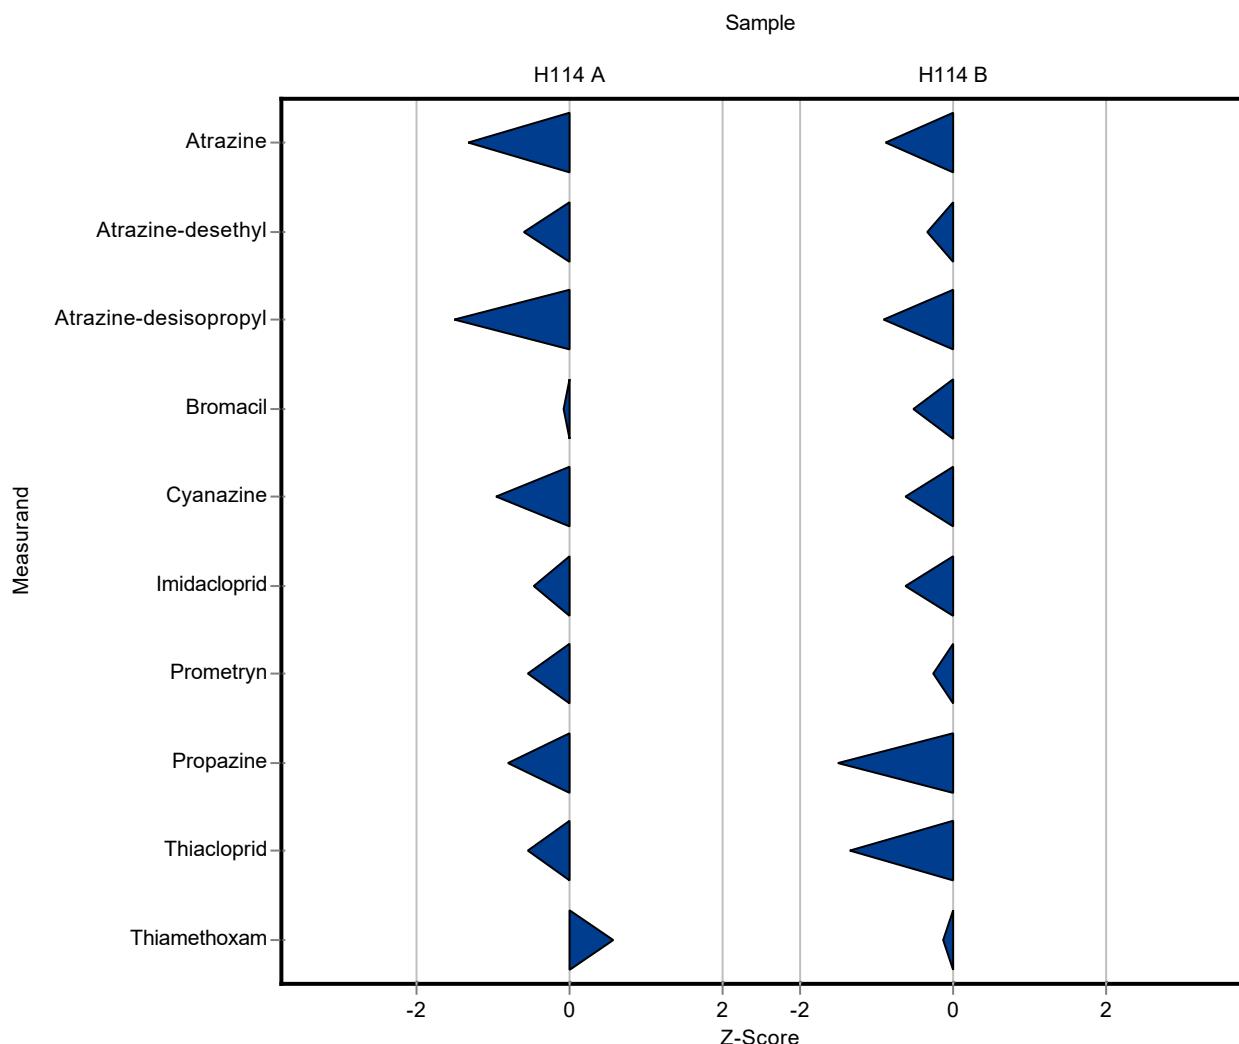


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.18 ± 0.002	0.0232	85.4	-2.52
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.209 ± 0.003	0.027	92.8	-1.17
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.239 ± 0.005	0.0424	79	-2.54
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.22 ± 0.009	0.0311	99.1	-0.10
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.169 ± 0.005	0.0274	86.5	-1.54
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.39 ± 0.01	0.0628	93.1	-0.96
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.22 ± 0.006	0.0308	92.8	-1.10
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.046 ± 0.007	0.0174	76.6	-0.82
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.094 ± 0.007	0.0142	92.5	-0.52
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.134 ± 0.003	0.0208	110	1.15

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.71 ± 0.009	0.208	90.4 -1.11
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.03 ± 0.014	0.254	95.9 -0.61
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	1.99 ± 0.028	0.32	87.2 -1.82
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.64 ± 0.044	0.248	92.8 -0.67
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.56 ± 0.03	0.393	91.2 -1.23
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	1.97 ± 0.05	0.327	90.5 -1.35
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.16 ± 0.03	0.291	96.5 -0.64
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.62 ± 0.035	0.262	80.4 -2.51
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	1.94 ± 0.037	0.334	81.3 -3.31
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.03 ± 0.014	0.352	97.9 -0.41

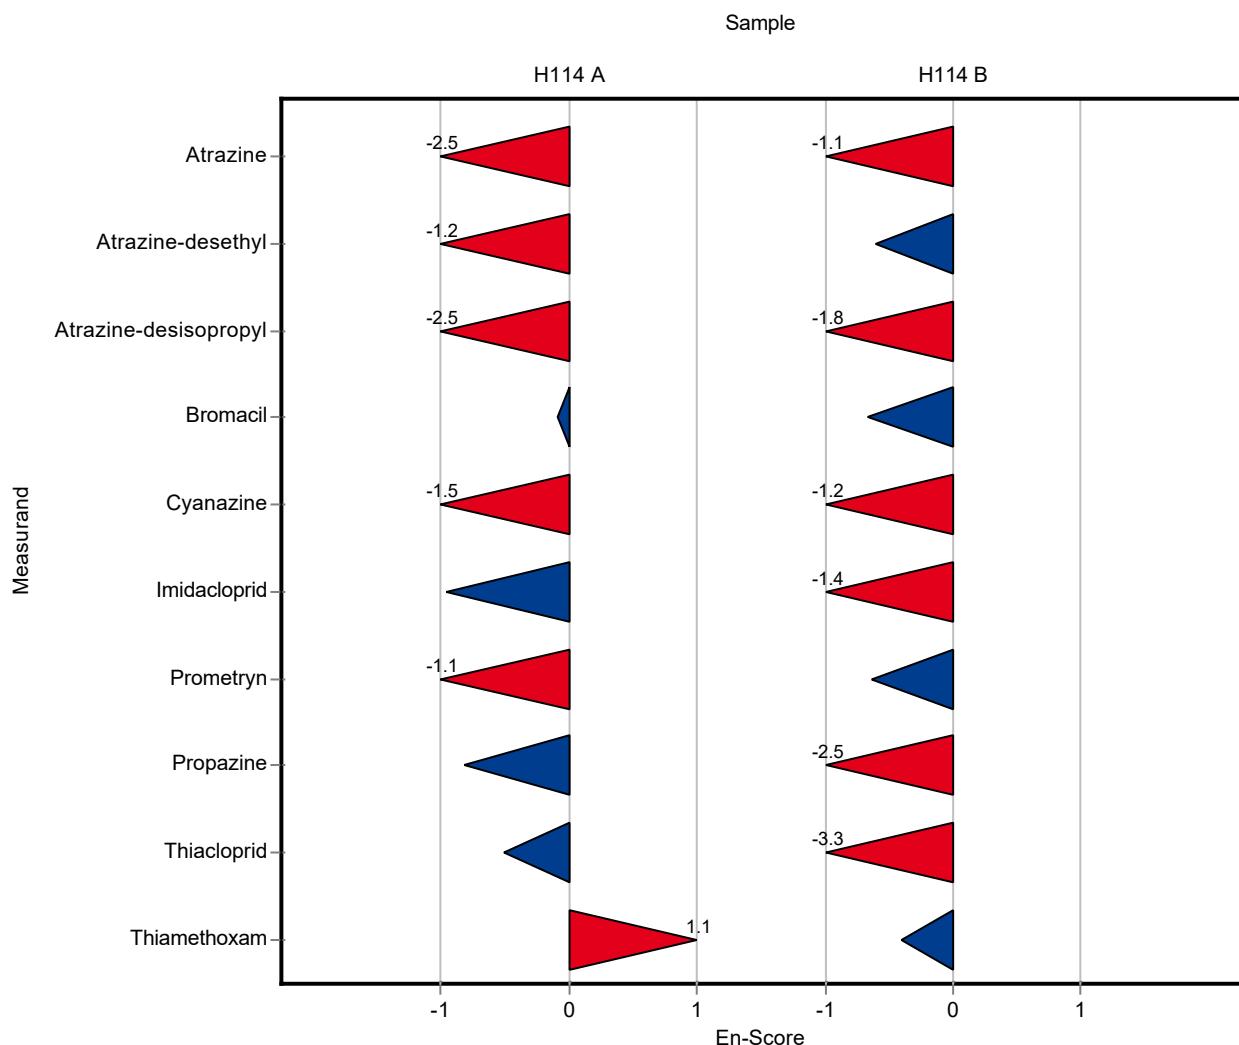

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.155 ± 0.031	0.0412	113	0.43
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.232 ± 0.029	0.0232	110	0.92
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.279 ± 0.035	0.027	124	1.99
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.368 ± 0.046	0.0424	122	1.54
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.244 ± 0.03	0.0311	110	0.71
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.23 ± 0.029	0.0274	118	1.27
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.166 ± 0.033	0.04	95.5	-0.20
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.127 ± 0.026	0.0543	86.6	-0.36
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.115 ± 0.023	0.0433	106	0.15
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.134 ± 0.027	0.0269	99.5	-0.03
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.299 ± 0.037	0.0308	126	2.01
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.071 ± 0.009	0.0174	118	0.63
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.069 ± 0.014	0.0202	102	0.08
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.231 ± 0.046	0.0752	92.2	-0.26
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.273 ± 0.055	0.0769	117	0.52
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.143 ± 0.029	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.231 ± 0.046	0.0933	102	0.04
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.107 ± 0.016	0.0142	105	0.38
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.757 ± 0.152	0.202	112	0.41

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0007

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.161 ± 0.27	0.208	114 1.29
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.435 ± 0.304	0.254	115 1.25
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.426 ± 0.303	0.32	106 0.45
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	2.191 ± 0.274	0.248	124 1.71
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	3.157 ± 0.395	0.393	113 0.89
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.484 ± 0.097	0.112	99.4 -0.03
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.487 ± 0.098	0.111	114 0.53
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.322 ± 0.065	0.14	92.2 -0.19
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.723 ± 0.145	0.146	99.2 -0.04
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.885 ± 0.361	0.291	129 2.22
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.315 ± 0.289	0.262	115 1.14
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.703 ± 0.141	0.192	110 0.33
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.669 ± 0.134	0.187	107 0.25
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.527 ± 0.105	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.462 ± 0.092	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.758 ± 0.152	0.273	114 0.34
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.56 ± 0.384	0.334	107 0.52
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

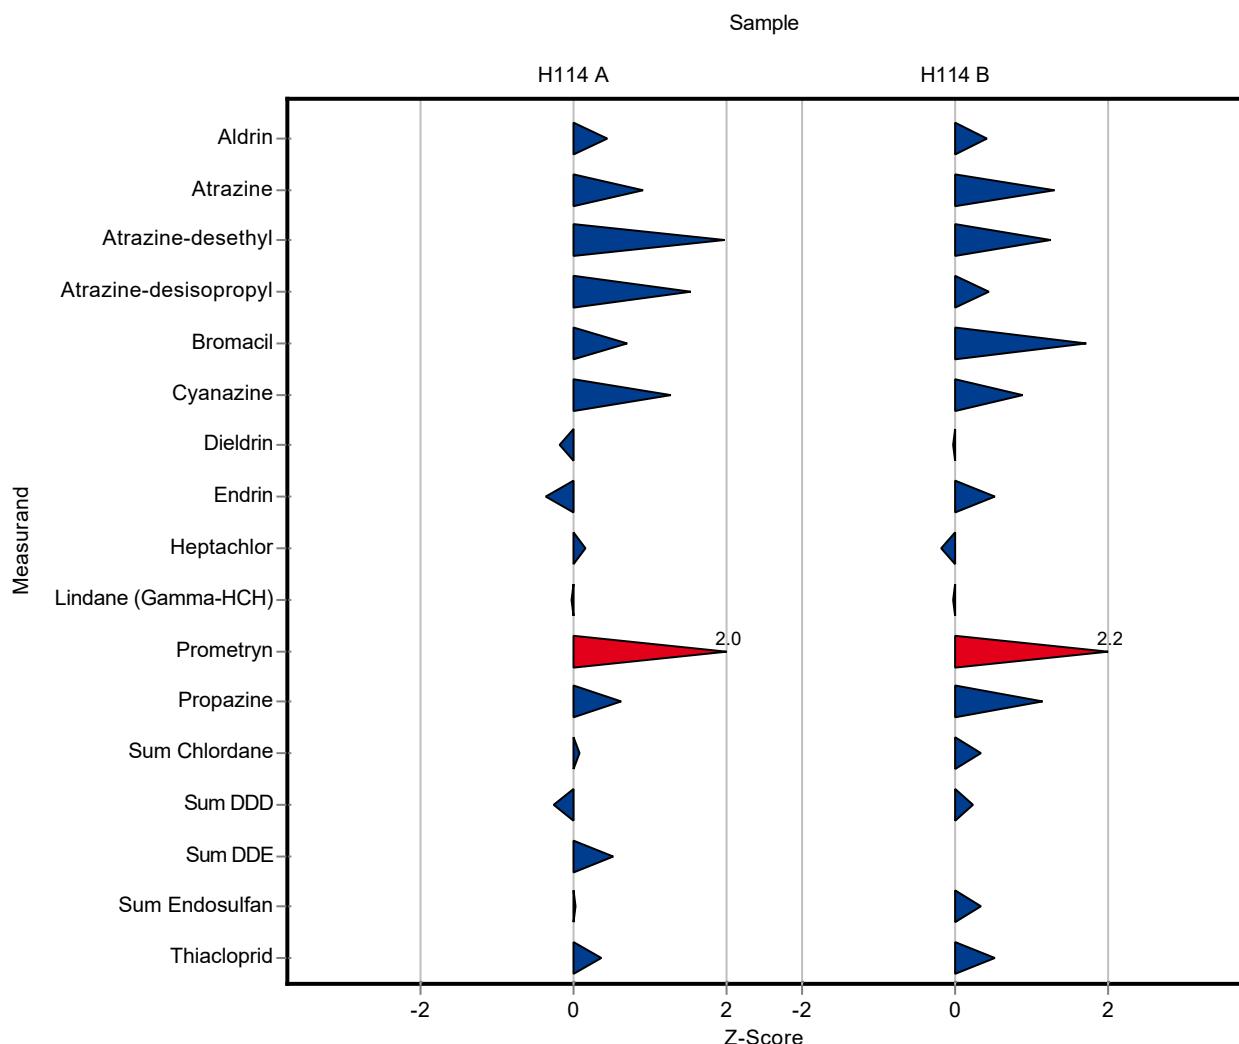


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.155 ± 0.031	0.0412	113	0.28
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.232 ± 0.029	0.0232	110	0.36
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.279 ± 0.035	0.027	124	0.76
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.368 ± 0.046	0.0424	122	0.69
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.244 ± 0.03	0.0311	110	0.36
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.23 ± 0.029	0.0274	118	0.58
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.166 ± 0.033	0.04	95.5	-0.12
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.127 ± 0.026	0.0543	86.6	-0.31
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.115 ± 0.023	0.0433	106	0.12
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.134 ± 0.027	0.0269	99.5	-0.01
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.299 ± 0.037	0.0308	126	0.83
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.071 ± 0.009	0.0174	118	0.54
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.069 ± 0.014	0.0202	102	0.06
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.231 ± 0.046	0.0752	92.2	-0.20
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.273 ± 0.055	0.0769	117	0.32
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.143 ± 0.029	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.231 ± 0.046	0.0933	102	0.04
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.107 ± 0.016	0.0142	105	0.17
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.757 ± 0.152	0.202	112	0.26

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.161 ± 0.27	0.208	114 0.48
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.435 ± 0.304	0.254	115 0.51
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.426 ± 0.303	0.32	106 0.23
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	2.191 ± 0.274	0.248	124 0.74
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	3.157 ± 0.395	0.393	113 0.43
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.484 ± 0.097	0.112	99.4 -0.01
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.487 ± 0.098	0.111	114 0.27
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.322 ± 0.065	0.14	92.2 -0.19
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.723 ± 0.145	0.146	99.2 -0.02
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.885 ± 0.361	0.291	129 0.89
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.315 ± 0.289	0.262	115 0.50
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.703 ± 0.141	0.192	110 0.20
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.669 ± 0.134	0.187	107 0.16
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.527 ± 0.105	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.462 ± 0.092	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.758 ± 0.152	0.273	114 0.28
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.56 ± 0.384	0.334	107 0.22
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

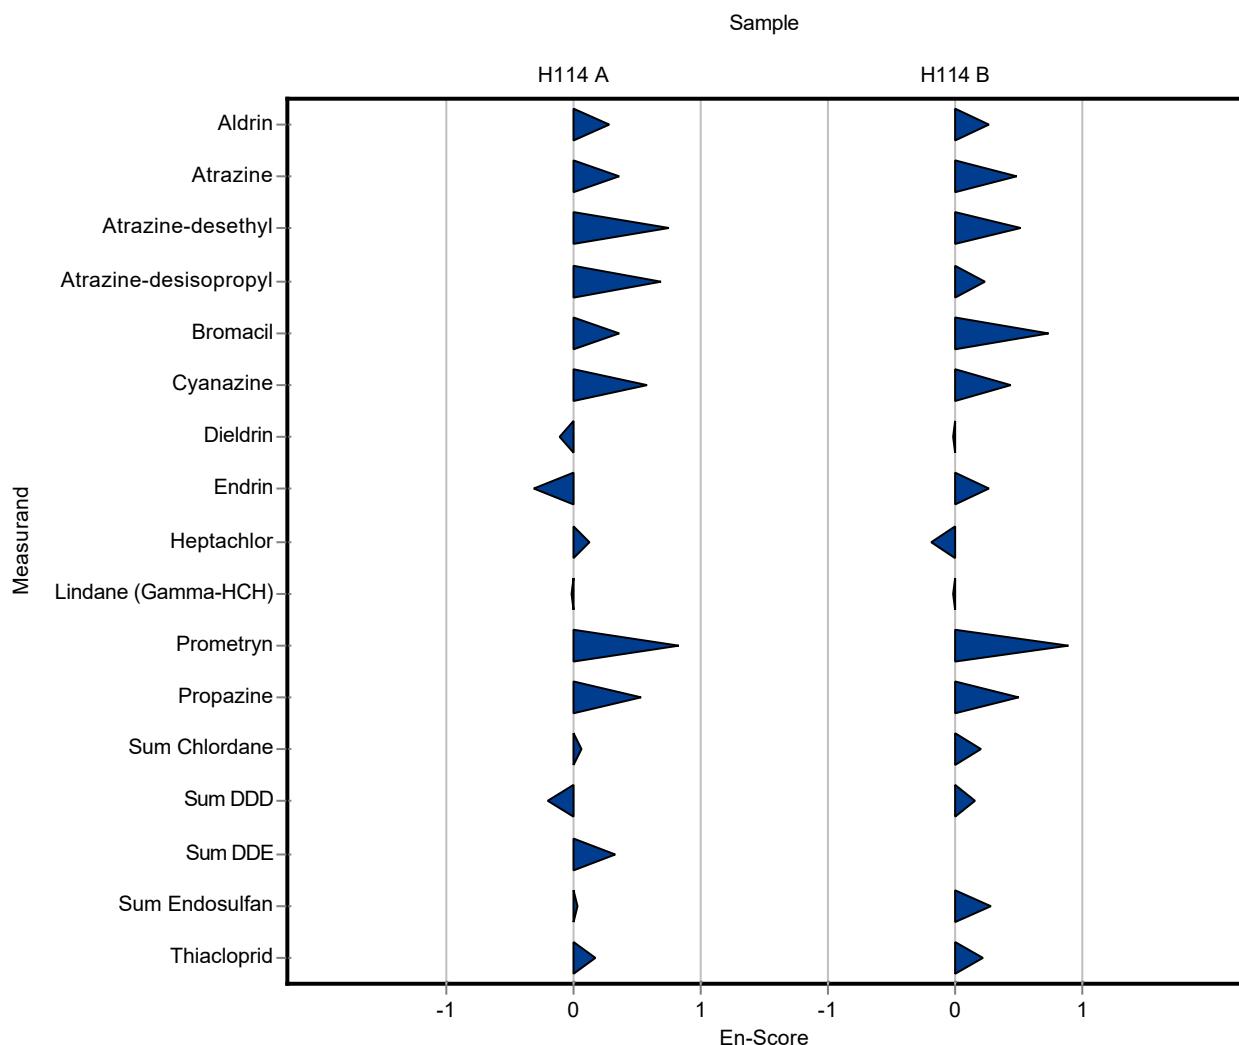

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.361 ± 0.09	0.0405	89.2	-1.08
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.017 ± 0.004	0.0412	12.4	-2.92
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.389 ± 0.097	0.0232	185	7.70
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.237 ± 0.059	0.027	105	0.44
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.352 ± 0.088	0.0424	116	1.16
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.198 ± 0.05	0.0311	89.2	-0.77
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.119 ± 0.03	0.0135	96.7	-0.30
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.213 ± 0.053	0.0274	109	0.64
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.173 ± 0.043	0.04	99.5	-0.02
Dinotefurane	µg/l	- ± -	0.163 ± 0.041	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.16 ± 0.04	0.0543	109	0.24
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.024 ± 0.006	0.0433	22.2	-1.95
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.394 ± 0.099	0.0628	94.1	-0.40
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.112 ± 0.028	0.0269	83.2	-0.84
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.138 ± 0.035	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.336 ± 0.084	0.0308	142	3.21
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.107 ± 0.027	0.0174	178	2.70
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.054 ± 0.014	0.0202	80.2	-0.66
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.279 ± 0.07	0.0752	111	0.38
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.183 ± 0.046	0.0769	78.6	-0.65
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.064 ± 0.016	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.15 ± 0.038	0.0933	65.9	-0.83
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.118 ± 0.03	0.0142	116	1.15
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.119 ± 0.03	0.0208	97.3	-0.16


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.026 ± 0.257	0.122	84.2	-1.58
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.067 ± 0.017	0.202	9.94	-3.00

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0008

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	3.173 ± 0.793	0.208	168 6.16
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.08 ± 0.52	0.254	98.3 -0.14
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.703 ± 0.676	0.32	118 1.31
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.597 ± 0.399	0.248	90.3 -0.69
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.571 ± 0.393	0.208	83.2 -1.52
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	3.066 ± 0.767	0.393	109 0.66
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.462 ± 0.116	0.112	94.9 -0.22
Dinotefurane	µg/l	- ± -	1.746 ± 0.437	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.52 ± 0.13	0.111	121 0.82
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.026 ± 0.007	0.14	7.45 -2.31
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.068 ± 0.517	0.327	95 -0.33
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.73 ± 0.183	0.146	100 0.01
Nitenpyram	µg/l	- ± -	2.798 ± 0.7	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	3.054 ± 0.764	0.291	136 2.80
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	3.098 ± 0.775	0.262	154 4.13
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.291 ± 0.073	0.192	45.5 -1.82
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.641 ± 0.16	0.187	103 0.10
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.308 ± 0.077	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.128 ± 0.032	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.518 ± 0.13	0.273	77.8 -0.54
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.566 ± 0.642	0.334	108 0.54
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	1.243 ± 0.311	0.352	60 -2.36

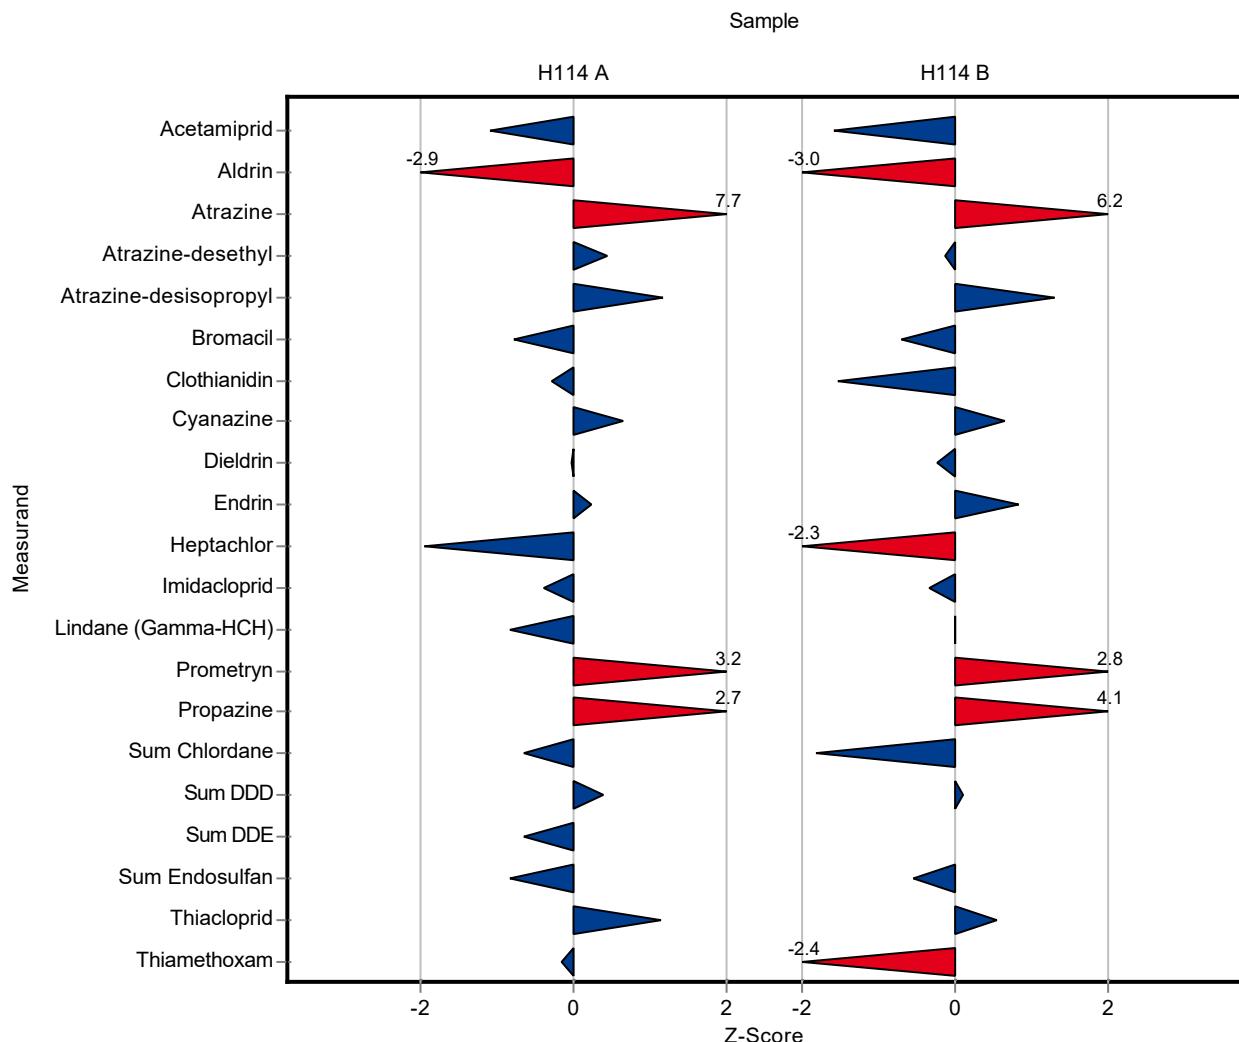


## Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.361 ± 0.09	0.0405	89.2	-0.24
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.017 ± 0.004	0.0412	12.4	-7.09
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.389 ± 0.097	0.0232	185	0.92
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.237 ± 0.059	0.027	105	0.10
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.352 ± 0.088	0.0424	116	0.28
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.198 ± 0.05	0.0311	89.2	-0.24
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.119 ± 0.03	0.0135	96.7	-0.07
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.213 ± 0.053	0.0274	109	0.16
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.173 ± 0.043	0.04	99.5	-0.01
Dinotefurane	µg/l	- ± -	0.163 ± 0.041	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.16 ± 0.04	0.0543	109	0.15
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.024 ± 0.006	0.0433	22.2	-2.53
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.394 ± 0.099	0.0628	94.1	-0.12
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.112 ± 0.028	0.0269	83.2	-0.40
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.138 ± 0.035	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.336 ± 0.084	0.0308	142	0.59
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.107 ± 0.027	0.0174	178	0.86
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.054 ± 0.014	0.0202	80.2	-0.45
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.279 ± 0.07	0.0752	111	0.20
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.183 ± 0.046	0.0769	78.6	-0.46
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.064 ± 0.016	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.15 ± 0.038	0.0933	65.9	-0.94
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.118 ± 0.03	0.0142	116	0.27
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.119 ± 0.03	0.0208	97.3	-0.05

## Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.026 ± 0.257	0.122	84.2	-0.37
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.067 ± 0.017	0.202	9.94	-5.99

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	3.173 ± 0.793	0.208	168	0.80
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.08 ± 0.52	0.254	98.3	-0.03
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.703 ± 0.676	0.32	118	0.31
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.597 ± 0.399	0.248	90.3	-0.21
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.571 ± 0.393	0.208	83.2	-0.39
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	3.066 ± 0.767	0.393	109	0.17
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.462 ± 0.116	0.112	94.9	-0.10
Dinotefurane	µg/l	- ± -	1.746 ± 0.437	-	-	-
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.52 ± 0.13	0.111	121	0.33
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.026 ± 0.007	0.14	7.45	-4.83
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.068 ± 0.517	0.327	95	-0.10
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.73 ± 0.183	0.146	100	0.00
Nitenpyram	µg/l	- ± -	2.798 ± 0.7	-	-	-
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	3.054 ± 0.764	0.291	136	0.53
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	3.098 ± 0.775	0.262	154	0.70
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.291 ± 0.073	0.192	45.5	-1.74
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.641 ± 0.16	0.187	103	0.05
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.308 ± 0.077	-	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.128 ± 0.032	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.518 ± 0.13	0.273	77.8	-0.50
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.566 ± 0.642	0.334	108	0.14
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	1.243 ± 0.311	0.352	60	-1.32

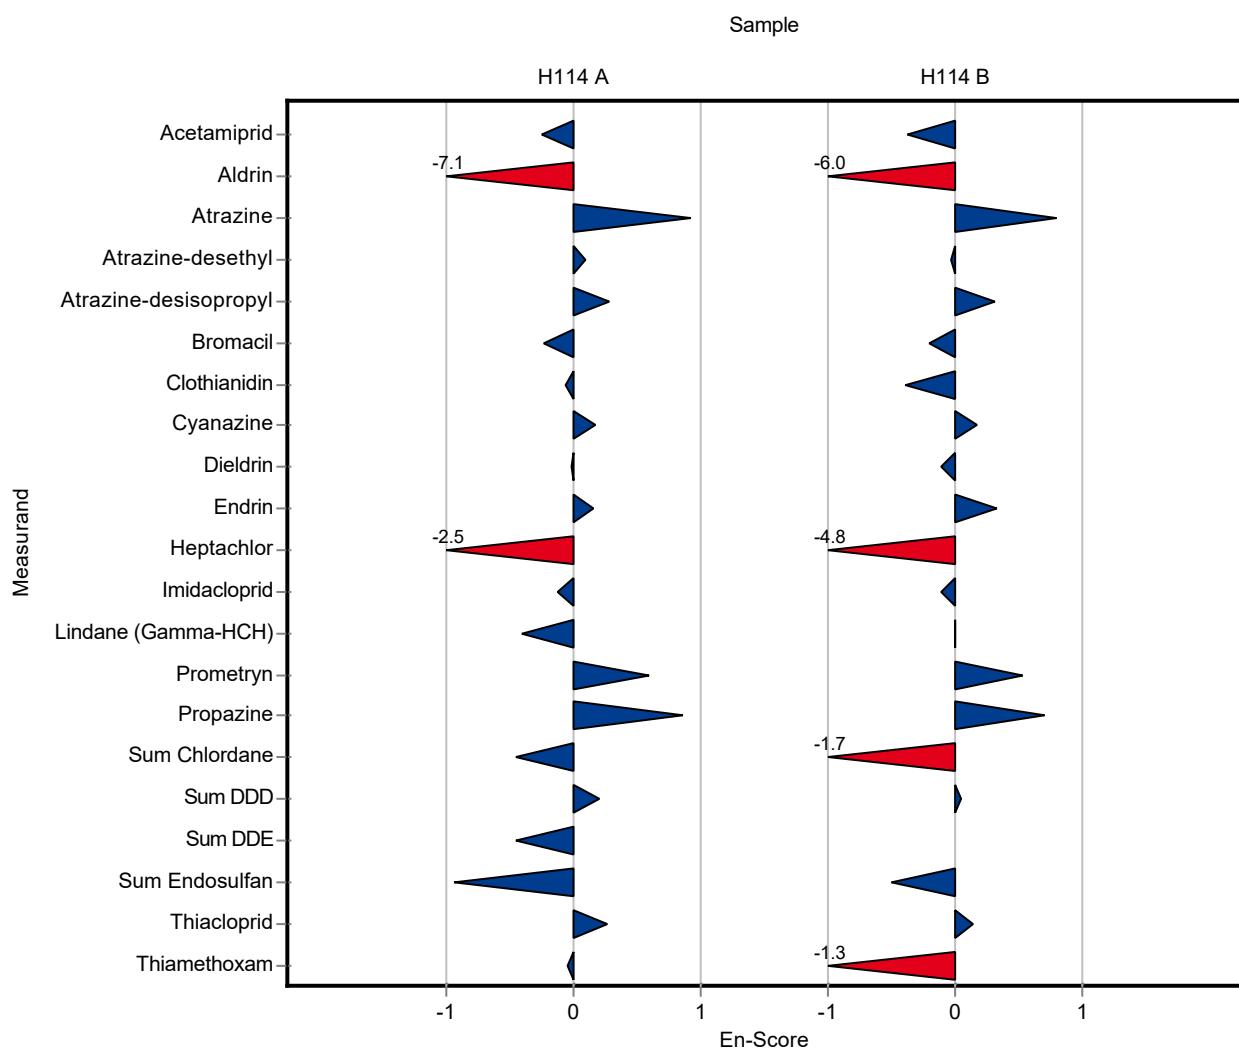

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.211 ± 0.042	0.0232	100	0.01
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.222 ± 0.055	0.027	98.6	-0.12
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.31 ± 0.062	0.0424	102	0.17
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.12 ± 0.024	0.0135	97.5	-0.22
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.396 ± 0.079	0.0628	94.5	-0.36
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.06 ± 0.012	0.0174	100	0.00
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.103 ± 0.021	0.0142	101	0.10
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.117 ± 0.023	0.0208	95.7	-0.25


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0009

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.901 ± 0.38	0.208	100 0.04
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.629 ± 0.657	0.254	124 2.02
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.631 ± 0.526	0.32	115 1.09
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.916 ± 0.383	0.208	102 0.14
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.275 ± 0.455	0.327	105 0.30
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.986 ± 0.397	0.262	98.5 -0.11
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.601 ± 0.52	0.334	109 0.64
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.084 ± 0.417	0.352	101 0.03

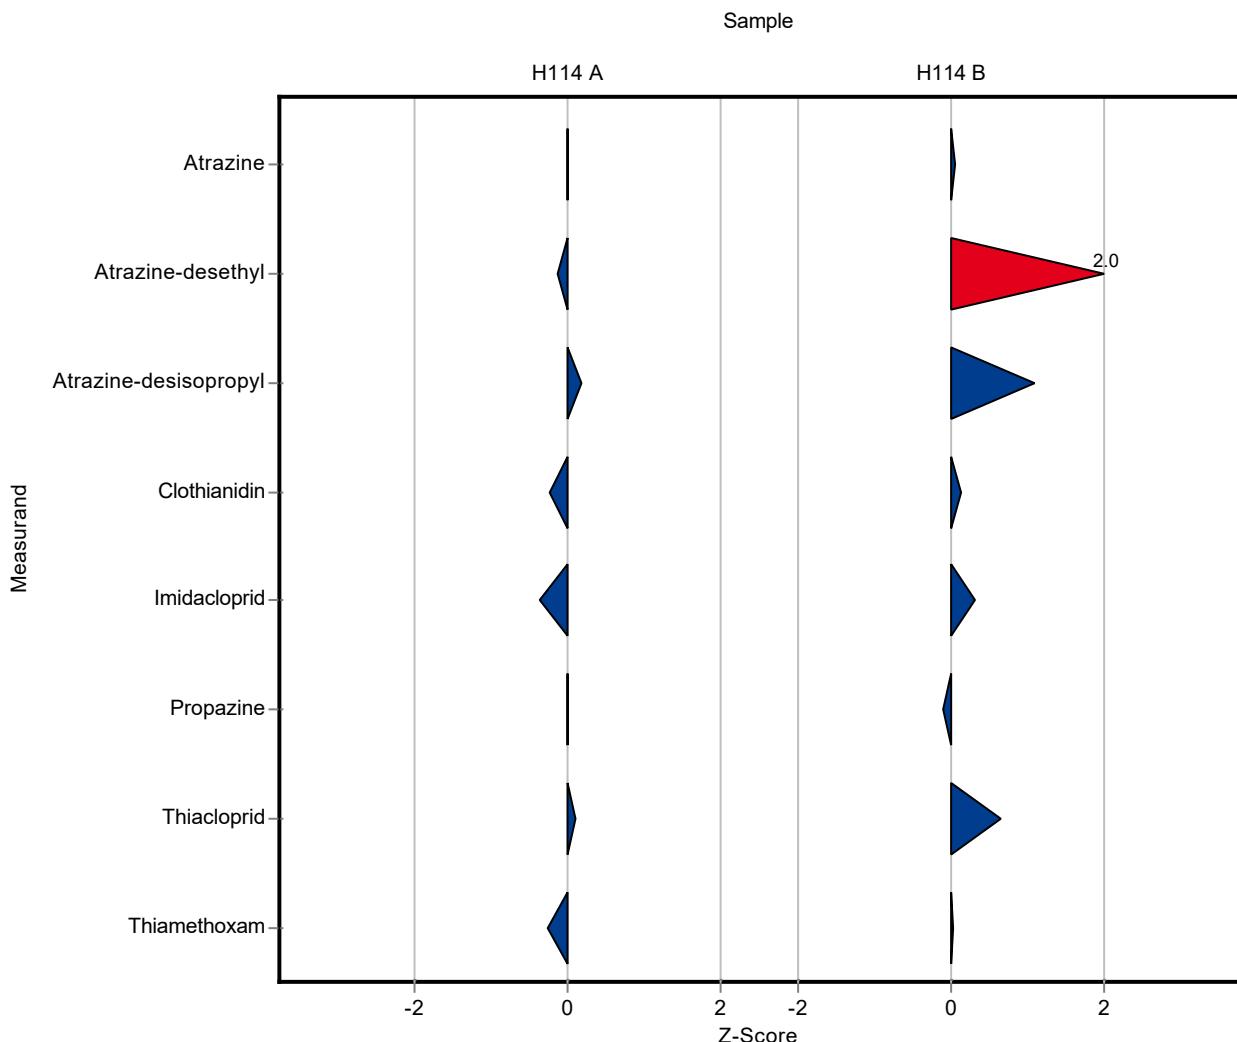


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.211 ± 0.042	0.0232	100	0.00
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.222 ± 0.055	0.027	98.6	-0.03
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.31 ± 0.062	0.0424	102	0.06
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.12 ± 0.024	0.0135	97.5	-0.06
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.396 ± 0.079	0.0628	94.5	-0.14
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.06 ± 0.012	0.0174	100	0.00
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.103 ± 0.021	0.0142	101	0.03
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.117 ± 0.023	0.0208	95.7	-0.11

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.901 ± 0.38	0.208	100 0.01
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.629 ± 0.657	0.254	124 0.39
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.631 ± 0.526	0.32	115 0.33
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.916 ± 0.383	0.208	102 0.04
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.275 ± 0.455	0.327	105 0.11
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.986 ± 0.397	0.262	98.5 -0.04
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.601 ± 0.52	0.334	109 0.20
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.084 ± 0.417	0.352	101 0.01

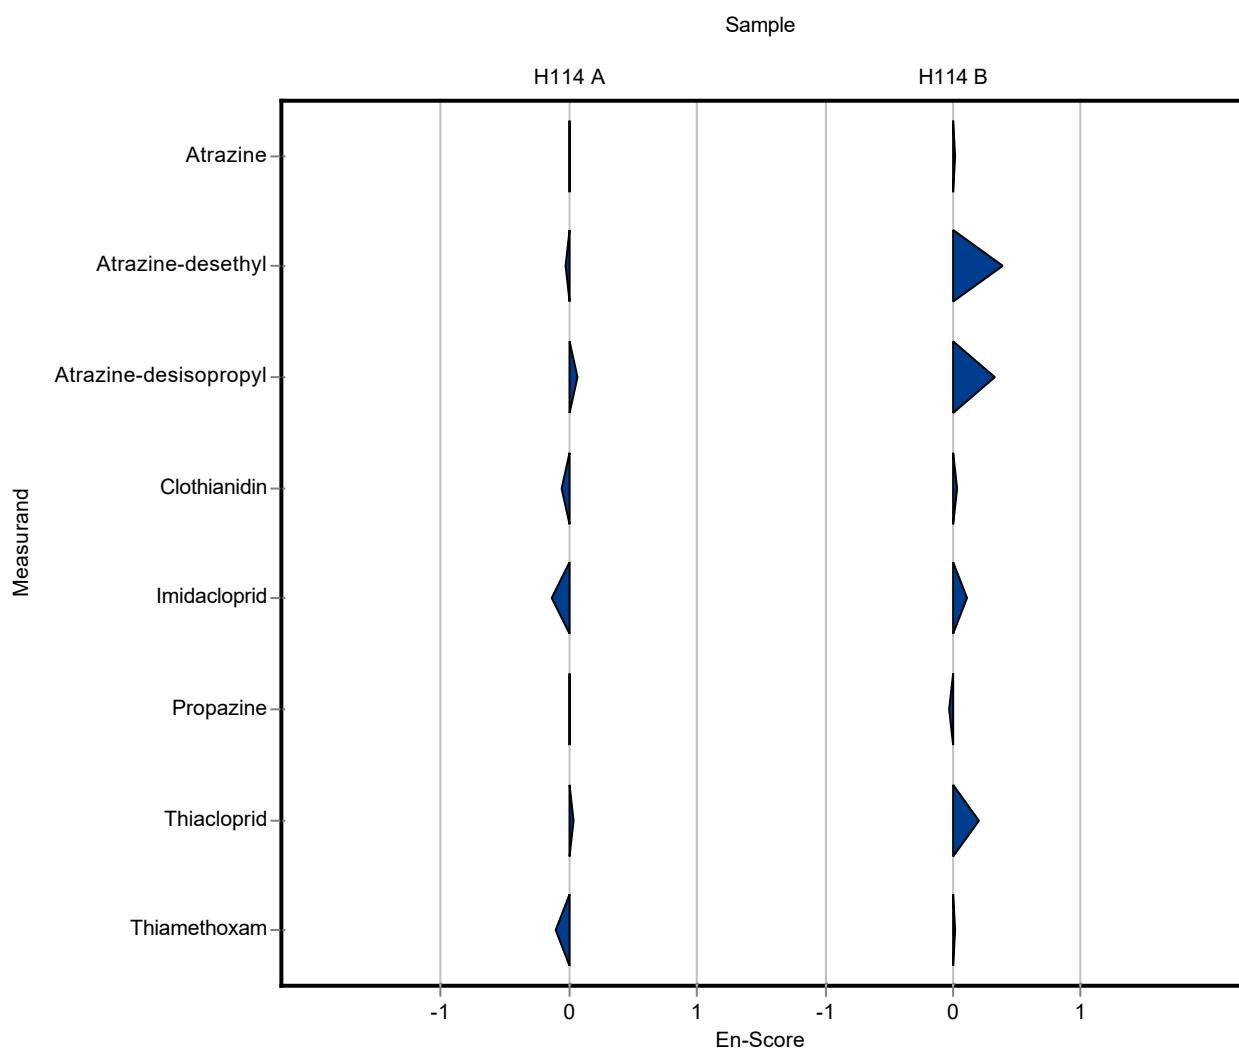

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.22 ± 0.026	0.0232	104	0.40
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.243 ± 0.051	0.027	108	0.66
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.319 ± 0.048	0.0424	105	0.38
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.241 ± 0.053	0.0311	109	0.61
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.211 ± 0.042	0.0274	108	0.57
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.253 ± 0.051	0.0308	107	0.52
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.0603 ± 0.012	0.0174	100	0.02
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	- ± -	0.0142	-	-
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0010

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.12 ± 0.25	0.208	112 1.10
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.34 ± 0.49	0.254	111 0.88
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.51 ± 0.38	0.32	110 0.71
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	2.05 ± 0.45	0.248	116 1.14
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	3.35 ± 0.67	0.393	119 1.39
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.58 ± 0.52	0.291	115 1.17
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.24 ± 0.45	0.262	111 0.86
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	- ± -	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

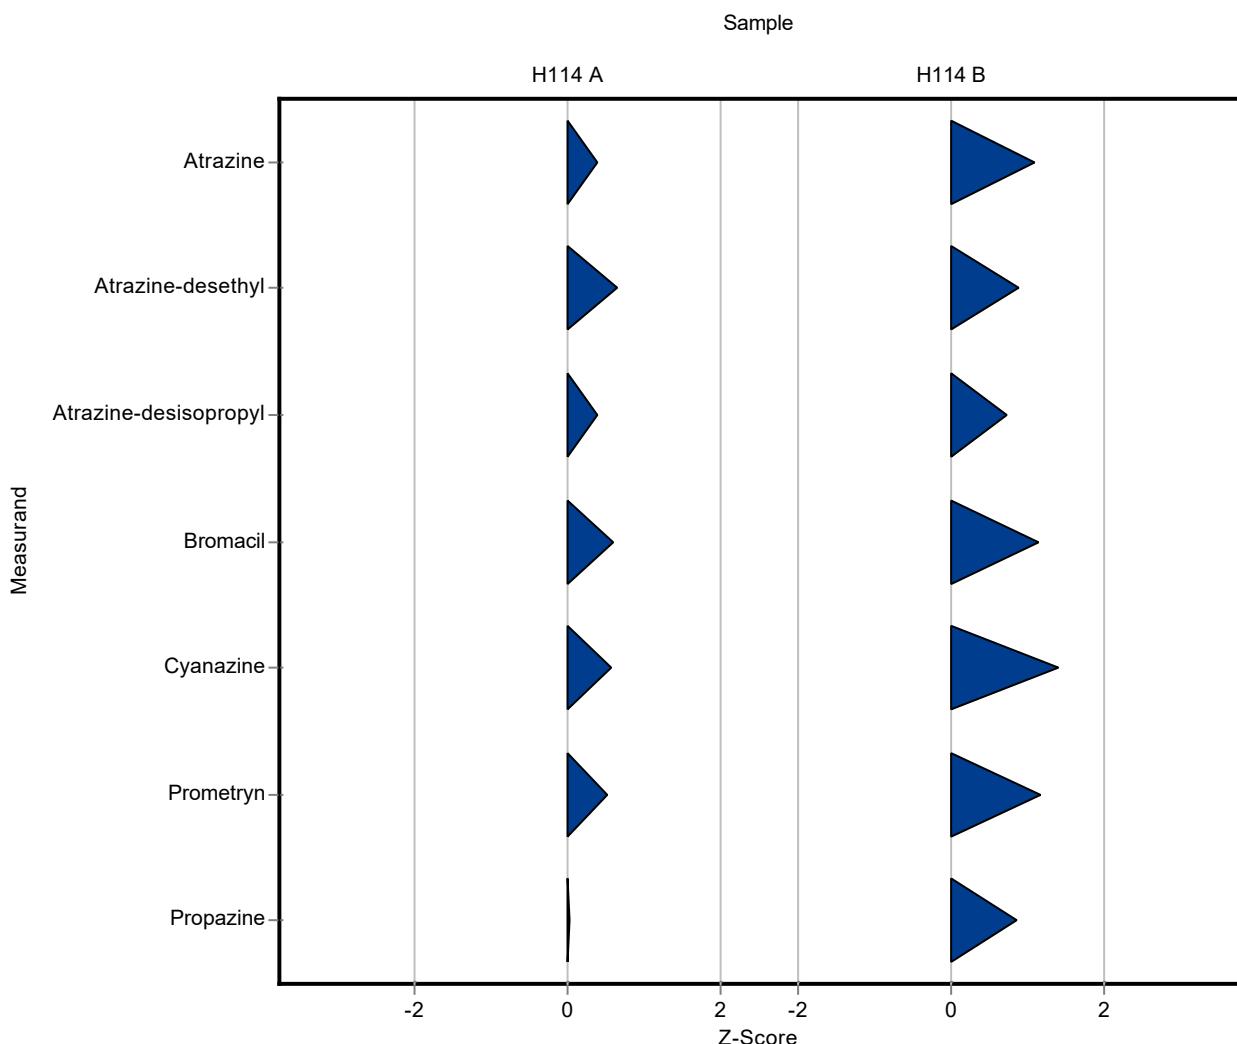


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.22 ± 0.026	0.0232	104	0.18
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.243 ± 0.051	0.027	108	0.17
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.319 ± 0.048	0.0424	105	0.17
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.241 ± 0.053	0.0311	109	0.18
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.211 ± 0.042	0.0274	108	0.18
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.253 ± 0.051	0.0308	107	0.16
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.0603 ± 0.012	0.0174	100	0.01
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	- ± -	0.0142	-	-
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.12 ± 0.25	0.208	112 0.43
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.34 ± 0.49	0.254	111 0.23
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.51 ± 0.38	0.32	110 0.29
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	2.05 ± 0.45	0.248	116 0.31
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	3.35 ± 0.67	0.393	119 0.40
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.58 ± 0.52	0.291	115 0.33
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.24 ± 0.45	0.262	111 0.25
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	- ± -	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

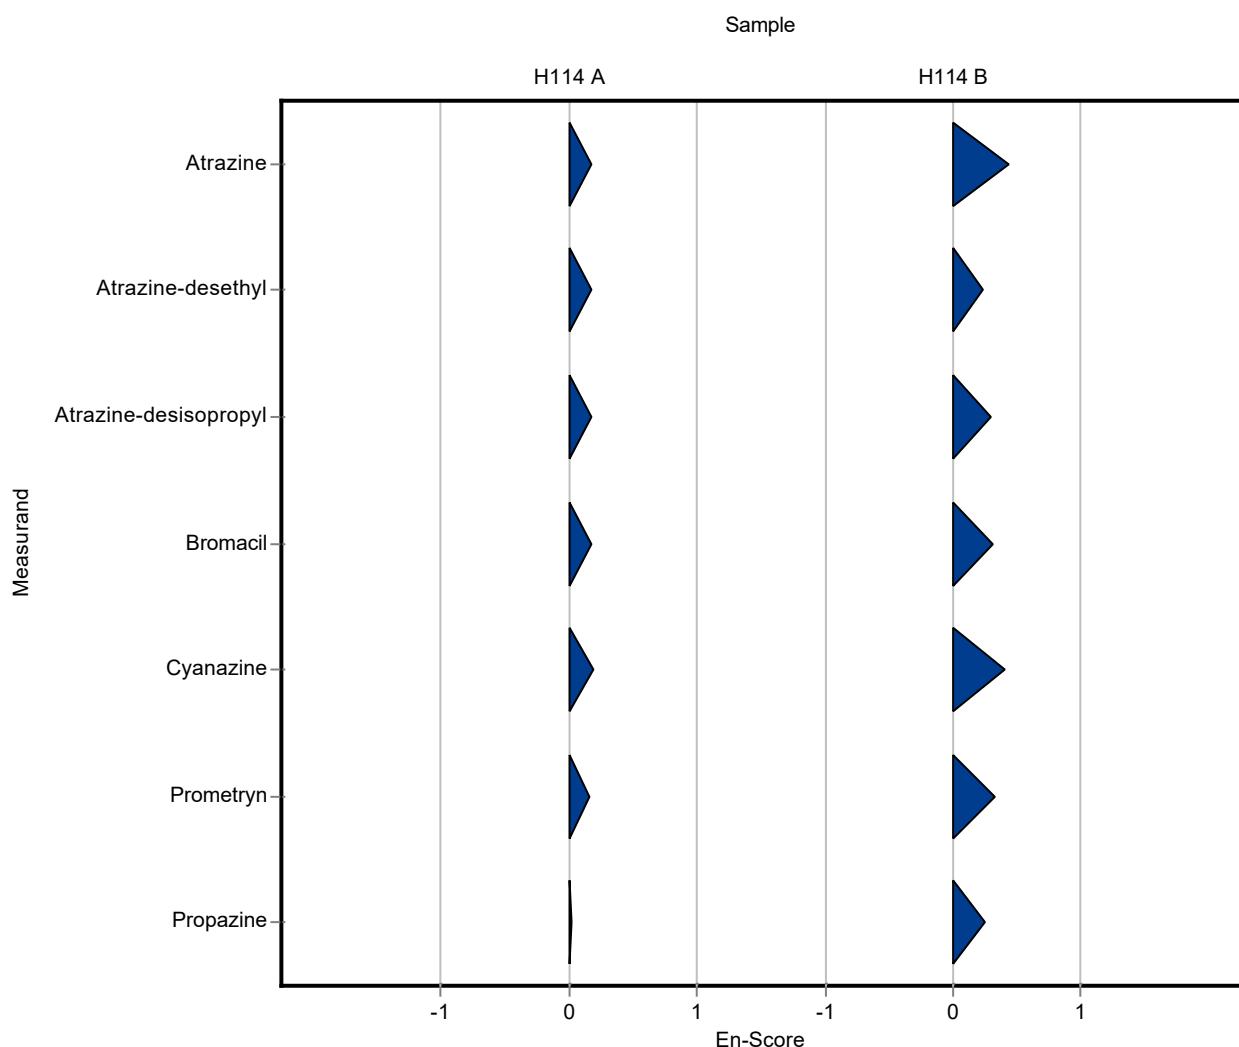

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.429 ± 0.17	0.0405	106	0.60
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.193 ± 0.08	0.027	85.7	-1.19
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.255 ± 0.11	0.0424	84.2	-1.13
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.204 ± 0.09	0.0311	91.9	-0.58
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.126 ± 0.06	0.0135	102	0.22
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.477 ± 0.18	0.0628	114	0.93
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.093 ± 0.041	0.0142	91.5	-0.61
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.132 ± 0.06	0.0208	108	0.47


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.255 ± 0.4	0.122	103	0.30
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0011

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	1.715 ± 0.5	0.254	81 -1.58
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	1.725 ± 0.5	0.32	75.6 -1.75
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.59 ± 0.5	0.248	89.9 -0.72
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.53 ± 0.5	0.208	81.1 -1.72
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	1.985 ± 0.6	0.327	91.2 -0.59
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.06 ± 0.7	0.334	86.3 -0.98
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	1.795 ± 0.6	0.352	86.6 -0.79

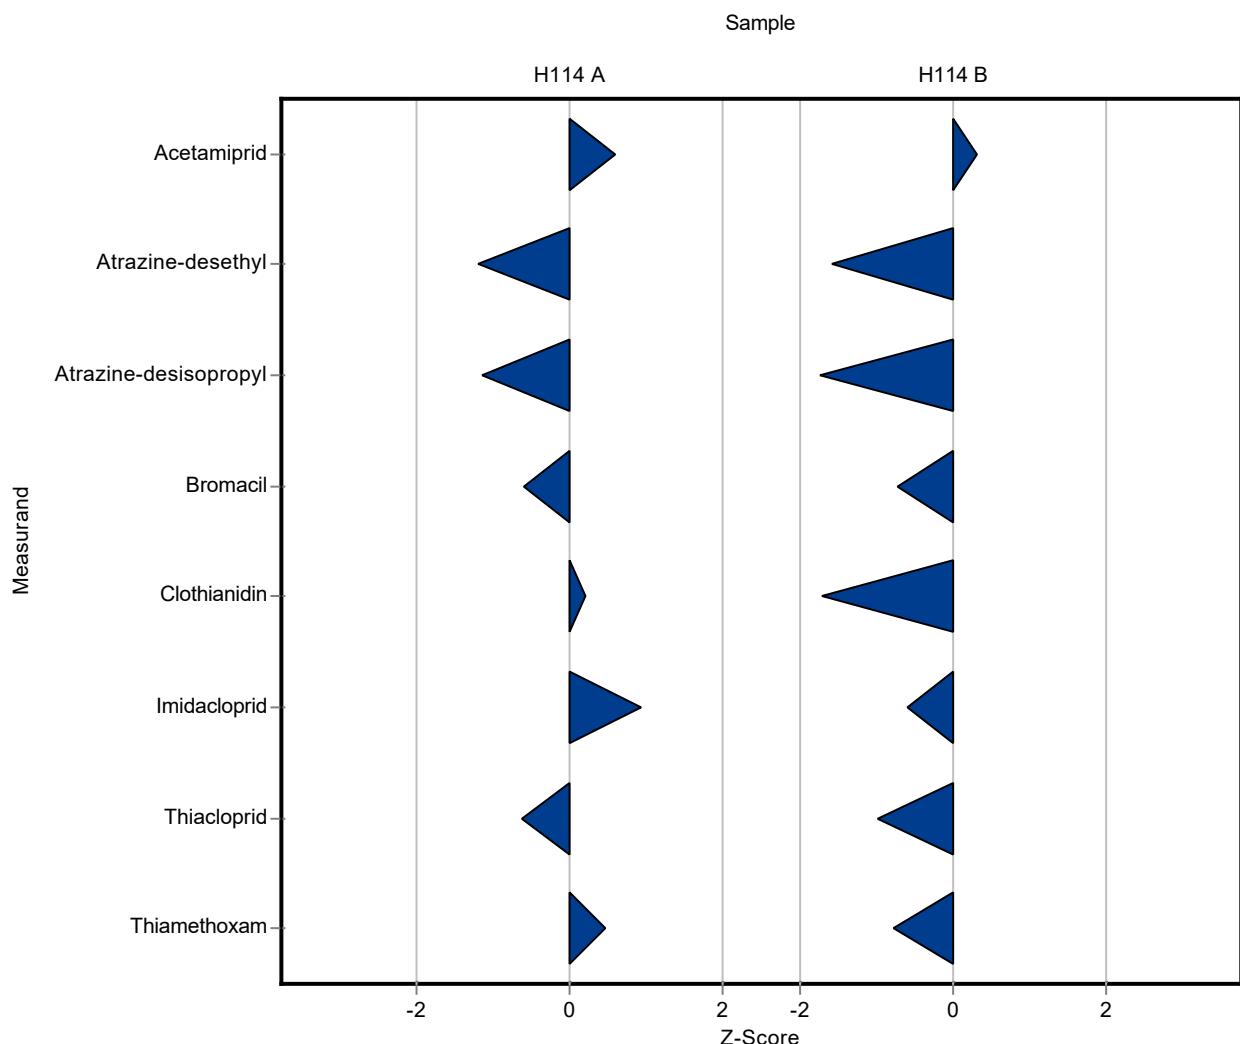


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.429 ± 0.17	0.0405	106	0.07
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.193 ± 0.08	0.027	85.7	-0.20
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.255 ± 0.11	0.0424	84.2	-0.22
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.204 ± 0.09	0.0311	91.9	-0.10
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.126 ± 0.06	0.0135	102	0.02
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.477 ± 0.18	0.0628	114	0.16
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.093 ± 0.041	0.0142	91.5	-0.11
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.132 ± 0.06	0.0208	108	0.08

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.255 ± 0.4	0.122	103	0.05
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	1.715 ± 0.5	0.254	81 -0.40
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	1.725 ± 0.5	0.32	75.6 -0.55
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.59 ± 0.5	0.248	89.9 -0.18
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.53 ± 0.5	0.208	81.1 -0.35
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	1.985 ± 0.6	0.327	91.2 -0.16
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.06 ± 0.7	0.334	86.3 -0.23
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	1.795 ± 0.6	0.352	86.6 -0.23

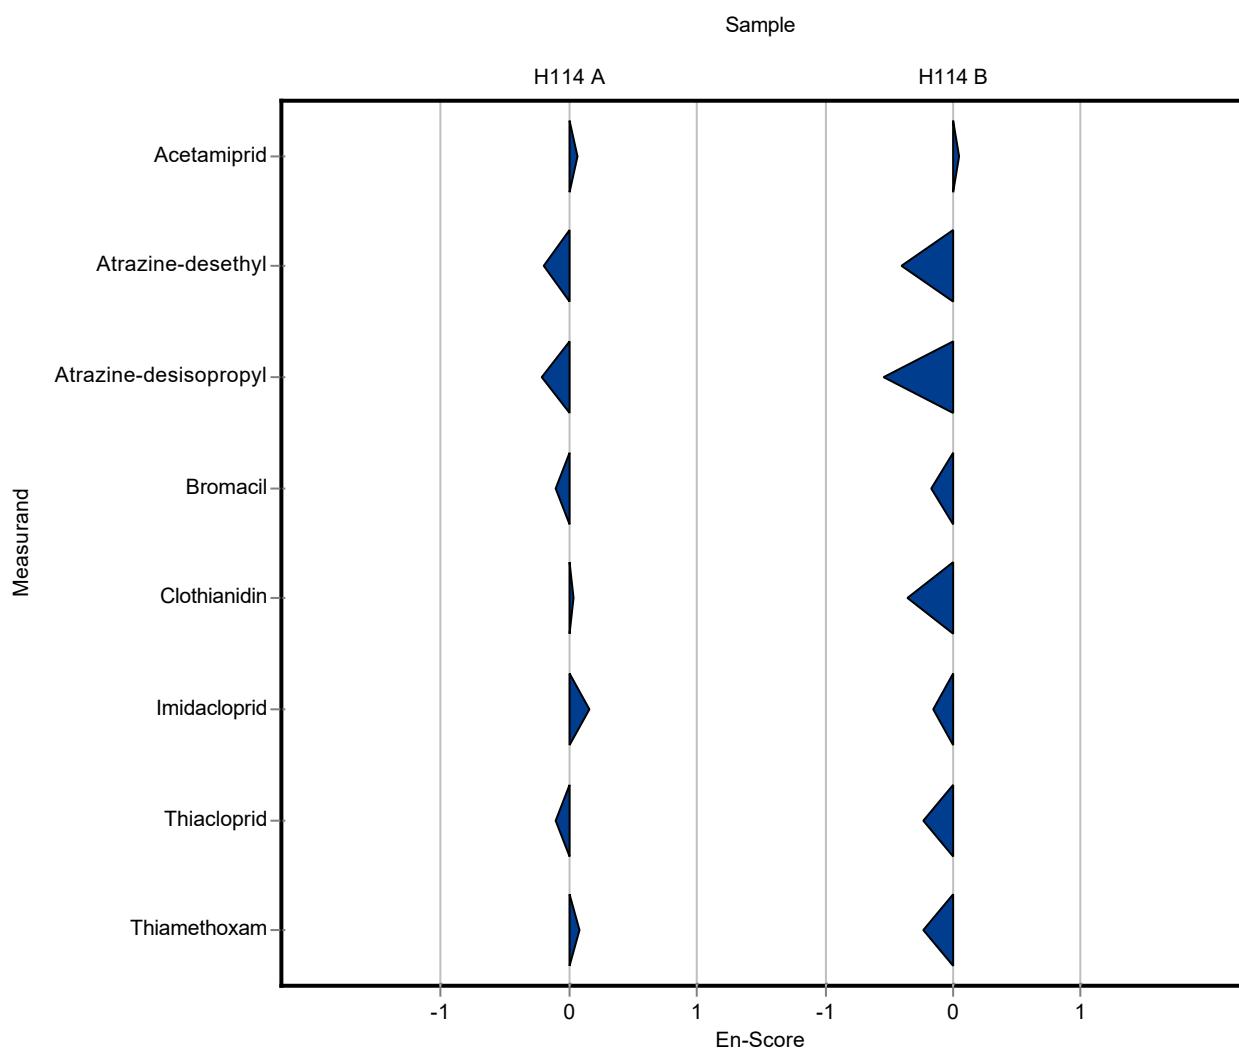

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.2375 ± 0.1188	0.0405	58.7	-4.13
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.027 ± 0.014	0.0412	19.7	-2.68
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.1985 ± 0.0993	0.0232	94.2	-0.52
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.0495 ± 0.0248	0.027	22	-6.50
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.2281 ± 0.1141	0.0311	103	0.19
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.0197 ± 0.0099	0.0135	16	-7.64
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.059 ± 0.03	0.04	33.9	-2.87
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.053 ± 0.027	0.0543	36.1	-1.73
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.009 ± 0.005	0.0433	8.31	-2.29
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.1121 ± 0.0561	0.0628	26.8	-4.88
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	<0.01 (LOQ) ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.0164 ± 0.0082	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.1401 ± 0.0701	0.0308	59.1	-3.15
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.033 ± 0.0165	0.0174	55	-1.55
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.219 ± 0.11	0.0752	87.4	-0.42
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.091 ± 0.046	0.0769	39.1	-1.85
Sum DDT	µg/l	- ± -	<0.01 (LOQ) ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.044 ± 0.022	0.0933	19.3	-1.97
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.0852 ± 0.0426	0.0142	83.8	-1.15
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.0151 ± 0.0076	0.0208	12.4	-5.16


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	0.5327 ± 0.2664	0.122	43.7	-5.63
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.059 ± 0.03	0.202	8.75	-3.04

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0012

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.1813 ± 0.5907	0.208	62.4 -3.41
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	0.5606 ± 0.2803	0.254	26.5 -6.13
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	- -
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.1834 ± 0.5917	0.248	66.9 -2.36
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	0.3351 ± 0.1676	0.208	17.8 -7.48
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.317 ± 0.159	0.112	65.1 -1.52
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.062 ± 0.031	0.111	14.5 -3.29
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.042 ± 0.021	0.14	12 -2.20
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	0.5542 ± 0.2771	0.327	25.5 -4.97
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.073 ± 0.037	0.146	10 -4.50
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.6814 ± 0.3407	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	0.9671 ± 0.4836	0.291	43.2 -4.37
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	0.6888 ± 0.3444	0.262	34.2 -5.06
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.079 ± 0.04	0.187	12.7 -2.91
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.017 ± 0.009	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.029 ± 0.015	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.206 ± 0.103	0.273	31 -1.68
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	1.1531 ± 0.5766	0.334	48.3 -3.69
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	0.4513 ± 0.2257	0.352	21.8 -4.60

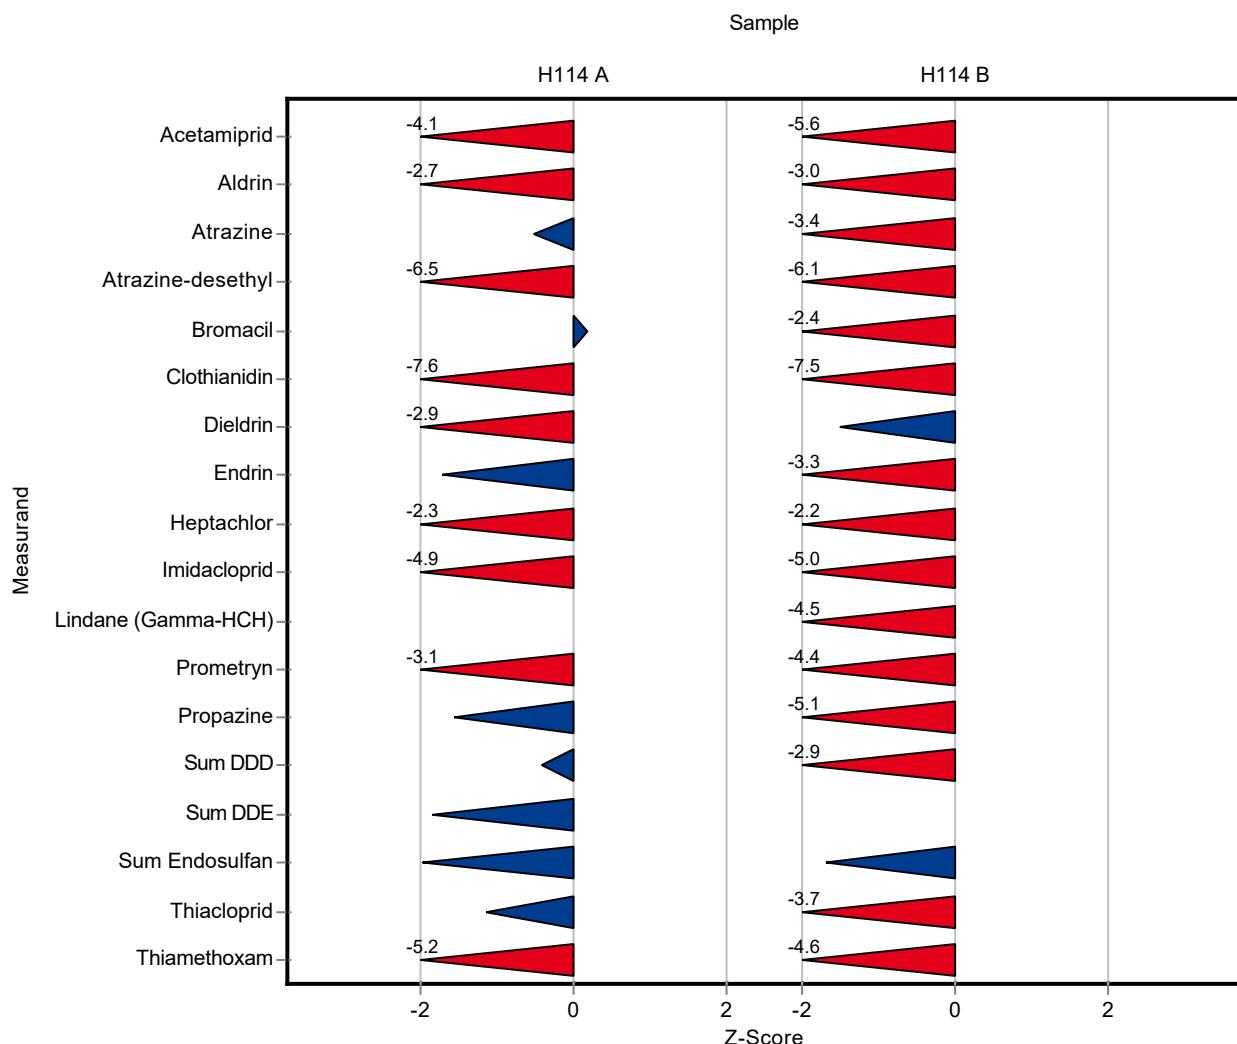


## Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.2375 ± 0.1188	0.0405	58.7	-0.70
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.027 ± 0.014	0.0412	19.7	-3.47
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.1985 ± 0.0993	0.0232	94.2	-0.06
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.0495 ± 0.0248	0.027	22	-3.44
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.2281 ± 0.1141	0.0311	103	0.03
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.0197 ± 0.0099	0.0135	16	-5.18
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.059 ± 0.03	0.04	33.9	-1.86
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.053 ± 0.027	0.0543	36.1	-1.44
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.009 ± 0.005	0.0433	8.31	-3.04
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.1121 ± 0.0561	0.0628	26.8	-2.68
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	<0.01 (LOQ) ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.0164 ± 0.0082	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.1401 ± 0.0701	0.0308	59.1	-0.69
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.033 ± 0.0165	0.0174	55	-0.79
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.219 ± 0.11	0.0752	87.4	-0.14
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.091 ± 0.046	0.0769	39.1	-1.30
Sum DDT	µg/l	- ± -	<0.01 (LOQ) ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.044 ± 0.022	0.0933	19.3	-3.35
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.0852 ± 0.0426	0.0142	83.8	-0.19
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.0151 ± 0.0076	0.0208	12.4	-6.19

## Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	0.5327 ± 0.2664	0.122	43.7	-1.27
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.059 ± 0.03	0.202	8.75	-5.45

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.1813 ± 0.5907	0.208	62.4	-0.60
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	0.5606 ± 0.2803	0.254	26.5	-2.69
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	-	-
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.1834 ± 0.5917	0.248	66.9	-0.49
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	0.3351 ± 0.1676	0.208	17.8	-4.08
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	-	-
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.317 ± 0.159	0.112	65.1	-0.53
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.062 ± 0.031	0.111	14.5	-3.35
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.042 ± 0.021	0.14	12	-3.95
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	0.5542 ± 0.2771	0.327	25.5	-2.87
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.073 ± 0.037	0.146	10	-8.09
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.6814 ± 0.3407	-	-	-
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	0.9671 ± 0.4836	0.291	43.2	-1.31
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	0.6888 ± 0.3444	0.262	34.2	-1.89
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	-	-
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.079 ± 0.04	0.187	12.7	-4.12
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.017 ± 0.009	-	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.029 ± 0.015	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.206 ± 0.103	0.273	31	-1.84
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	1.1531 ± 0.5766	0.334	48.3	-1.06
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	0.4513 ± 0.2257	0.352	21.8	-3.50

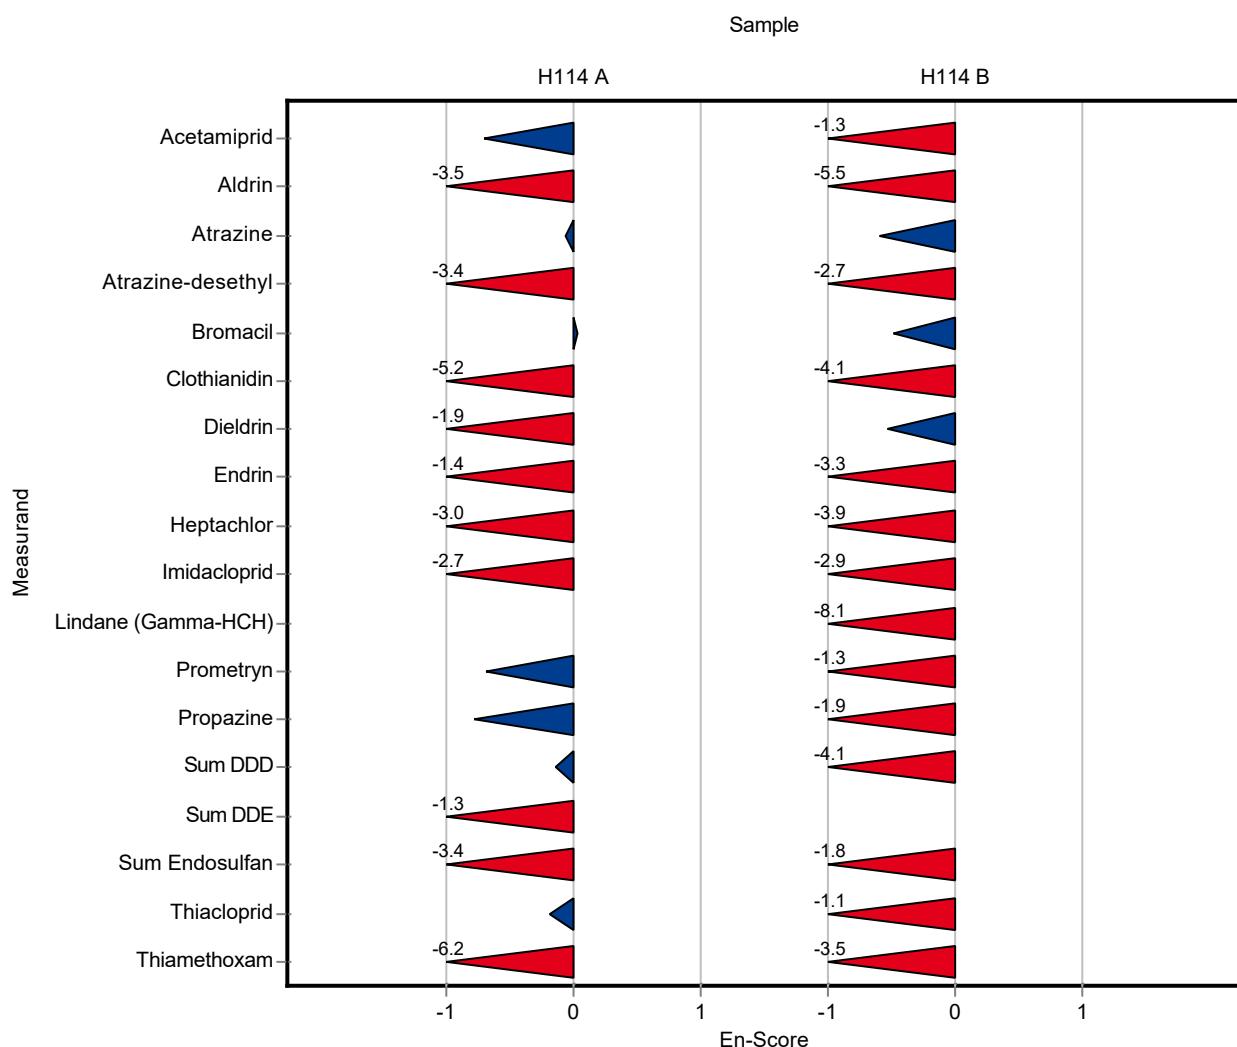

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.121 ± 0.009	0.0412	88.2	-0.39
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.236 ± 0.002	0.0232	112	1.09
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.22 ± 0.001	0.027	97.7	-0.19
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.302 ± 0.006	0.0424	99.8	-0.02
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.272 ± 0.002	0.0311	122	1.61
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	<0.025 (LOQ) ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.216 ± 0.002	0.0274	111	0.75
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.135 ± 0.015	0.04	77.7	-0.97
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.159 ± 0.016	0.0433	147	1.17
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.461 ± 0.005	0.0628	110	0.67
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.266 ± 0.002	0.0308	112	0.94
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.0714 ± 0.001	0.0174	119	0.65
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.111 ± 0.001	0.0142	109	0.66
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.129 ± 0.001	0.0208	106	0.32


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.652 ± 0.064	0.202	96.7	-0.11

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0013

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.09 ± 0.032	0.208	110 0.95
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.1 ± 0.02	0.254	99.2 -0.06
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.35 ± 0.015	0.32	103 0.21
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	2.22 ± 0.015	0.248	126 1.83
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	<0.025 (LOQ) ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.9 ± 0.055	0.393	103 0.24
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.406 ± 0.031	0.112	83.4 -0.72
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.403 ± 0.036	0.14	115 0.39
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.26 ± 0.031	0.327	104 0.26
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.3 ± 0.046	0.291	103 0.21
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.19 ± 0.062	0.262	109 0.67
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.5 ± 0.012	0.334	105 0.34
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.18 ± 0.012	0.352	105 0.30

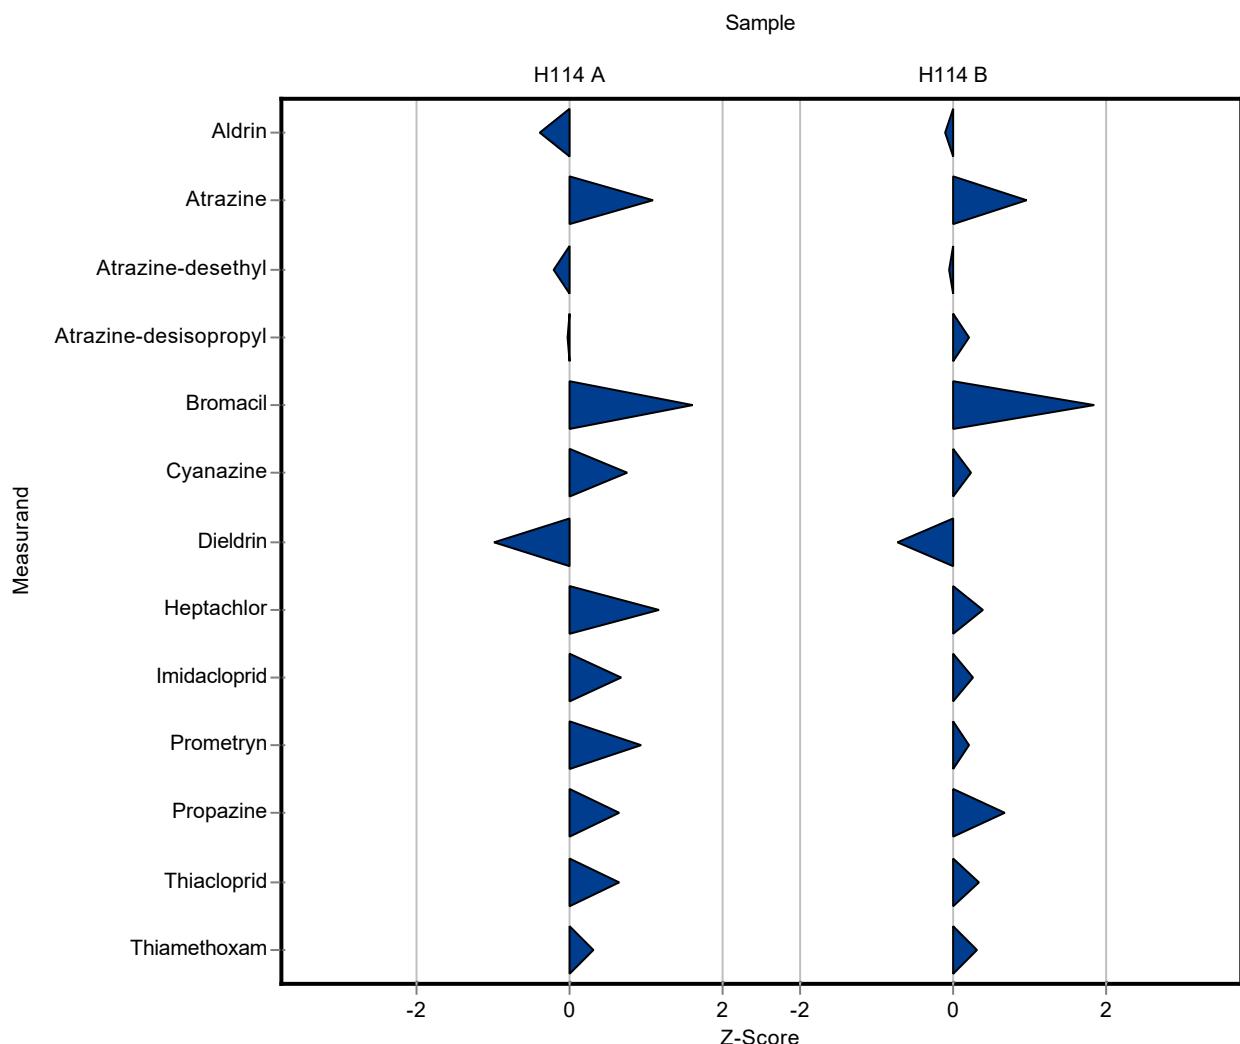


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.121 ± 0.009	0.0412	88.2	-0.69
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.236 ± 0.002	0.0232	112	2.08
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.22 ± 0.001	0.027	97.7	-0.41
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.302 ± 0.006	0.0424	99.8	-0.03
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.272 ± 0.002	0.0311	122	4.10
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	<0.025 (LOQ) ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.216 ± 0.002	0.0274	111	1.42
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.135 ± 0.015	0.04	77.7	-1.17
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.159 ± 0.016	0.0433	147	1.14
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.461 ± 0.005	0.0628	110	1.71
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.266 ± 0.002	0.0308	112	2.71
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.0714 ± 0.001	0.0174	119	1.14
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.111 ± 0.001	0.0142	109	1.80
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.129 ± 0.001	0.0208	106	0.79

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.652 ± 0.064	0.202	96.7	-0.14

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.09 ± 0.032	0.208	110 1.13
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.1 ± 0.02	0.254	99.2 -0.11
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.35 ± 0.015	0.32	103 0.44
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	2.22 ± 0.015	0.248	126 2.61
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	<0.025 (LOQ) ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.9 ± 0.055	0.393	103 0.43
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.406 ± 0.031	0.112	83.4 -1.00
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.403 ± 0.036	0.14	115 0.55
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.26 ± 0.031	0.327	104 0.64
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.3 ± 0.046	0.291	103 0.44
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.19 ± 0.062	0.262	109 0.93
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.5 ± 0.012	0.334	105 0.98
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.18 ± 0.012	0.352	105 1.02

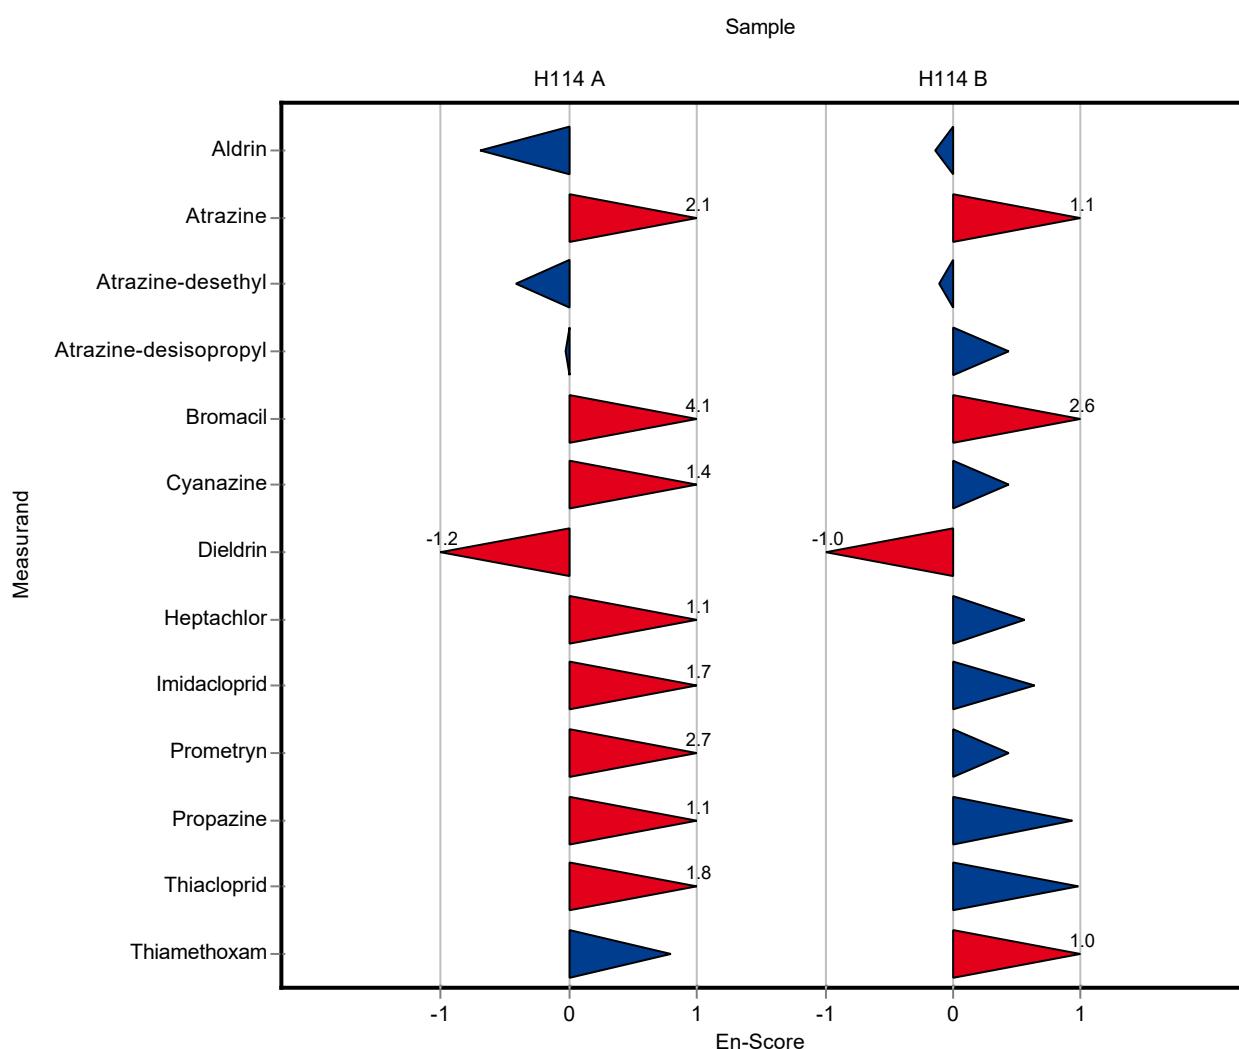

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.215 ± 0.056	0.0311	96.8	-0.23
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.16 ± 0.064	0.04	92.1	-0.35
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.061 ± 0.031	0.0269	45.3	-2.74
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.19 ± 0.076	0.0933	83.5	-0.40
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	- ± -	0.0142	-	-
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0014

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	- -
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.385 ± 0.36	0.248	78.3 -1.55
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.5 ± 0.2	0.112	103 0.12
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.636 ± 0.337	0.146	87.3 -0.64
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.79 ± 0.32	0.273	119 0.46
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	- ± -	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

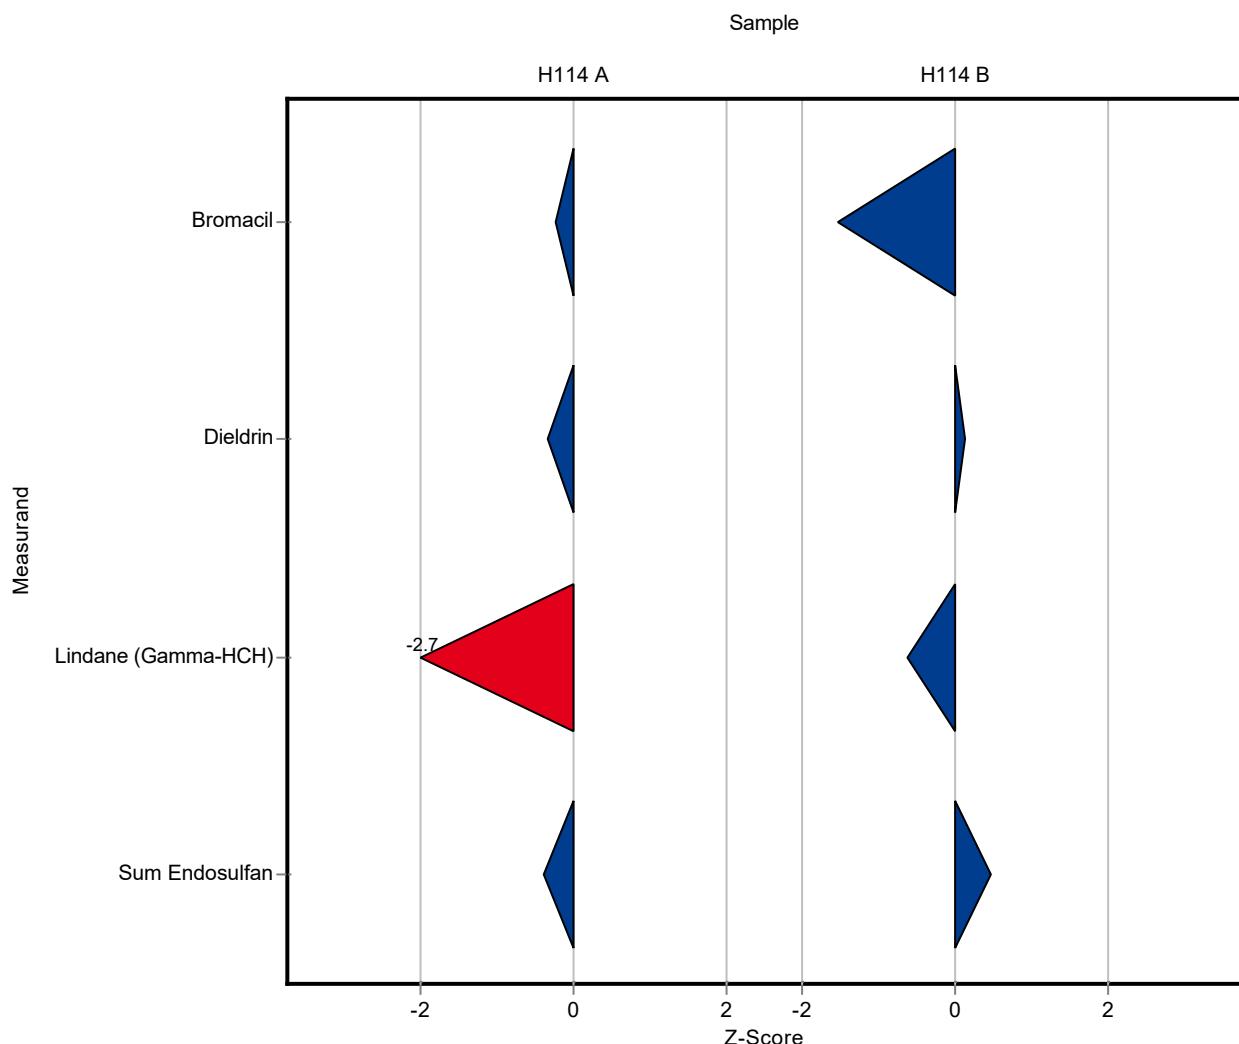


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.215 ± 0.056	0.0311	96.8	-0.06
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.16 ± 0.064	0.04	92.1	-0.11
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.061 ± 0.031	0.0269	45.3	-1.18
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.19 ± 0.076	0.0933	83.5	-0.24
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	- ± -	0.0142	-	-
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	- -
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.385 ± 0.36	0.248	78.3 -0.52
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.5 ± 0.2	0.112	103 0.03
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.636 ± 0.337	0.146	87.3 -0.14
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.79 ± 0.32	0.273	119 0.19
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	- ± -	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

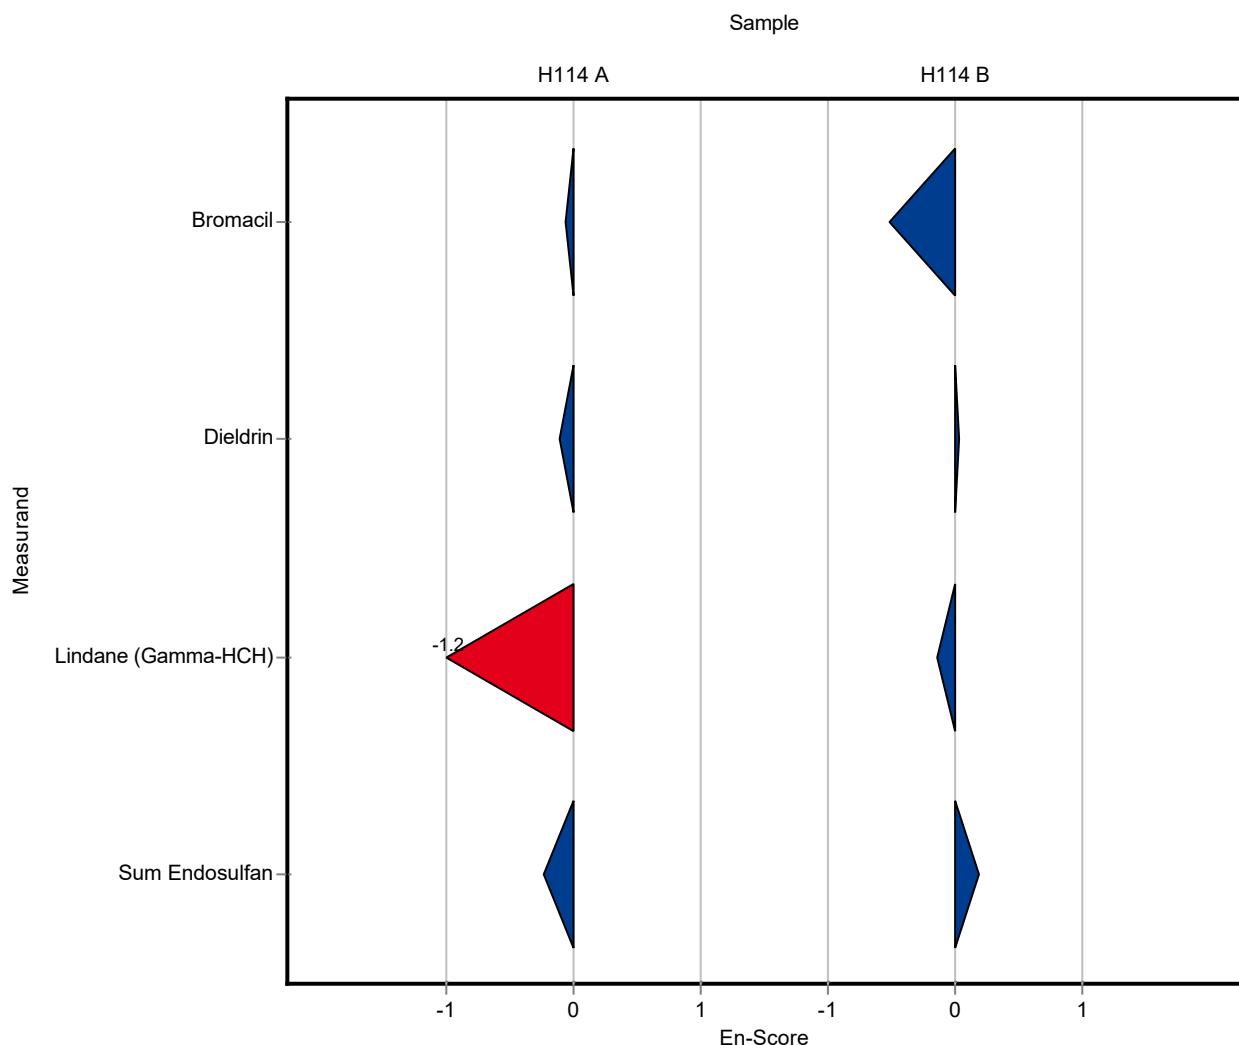

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.4 ± 0.06	0.0405	98.8	-0.12
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.253 ± 0.038	0.0412	184	2.81
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.18 ± 0.027	0.0232	85.4	-1.32
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.196 ± 0.029	0.027	87	-1.08
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.22 ± 0.033	0.0424	72.7	-1.95
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.202 ± 0.03	0.0311	91	-0.64
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.098 ± 0.015	0.0135	79.7	-1.85
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.175 ± 0.026	0.0274	89.6	-0.75
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.275 ± 0.041	0.04	158	2.53
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.224 ± 0.034	0.0543	153	1.42
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.307 ± 0.046	0.0433	283	4.59
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.395 ± 0.059	0.0628	94.3	-0.38
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.193 ± 0.029	0.0269	143	2.17
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.222 ± 0.033	0.0308	93.6	-0.49
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.05 ± 0.007	0.0174	83.3	-0.58
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.164 ± 0.025	0.0202	243	4.78
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.486 ± 0.073	0.0769	209	3.29
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.605 ± 0.091	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.306 ± 0.046	0.0933	134	0.84
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.101 ± 0.015	0.0142	99.4	-0.04
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.12 ± 0.018	0.0208	98.1	-0.11


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.247 ± 0.187	0.122	102	0.23
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.858 ± 0.128	0.202	127	0.91

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0015

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.685 ± 0.253	0.208	89.1 -0.99
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	1.973 ± 0.296	0.254	93.2 -0.56
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.039 ± 0.306	0.32	89.3 -0.76
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.776 ± 0.266	0.248	100 0.03
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.666 ± 0.25	0.208	88.3 -1.07
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.451 ± 0.368	0.393	87.4 -0.90
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.63 ± 0.095	0.112	129 1.28
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.524 ± 0.079	0.111	122 0.86
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.546 ± 0.082	0.14	156 1.41
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	1.969 ± 0.295	0.327	90.5 -0.64
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.696 ± 0.104	0.146	95.5 -0.22
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.127 ± 0.319	0.291	95 -0.38
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.775 ± 0.266	0.262	88.1 -0.92
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.742 ± 0.111	0.192	116 0.54
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	-
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.921 ± 0.138	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.89 ± 0.133	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.915 ± 0.137	0.273	137 0.91
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.337 ± 0.35	0.334	97.9 -0.15
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.074 ± 0.311	0.352	100 0.00

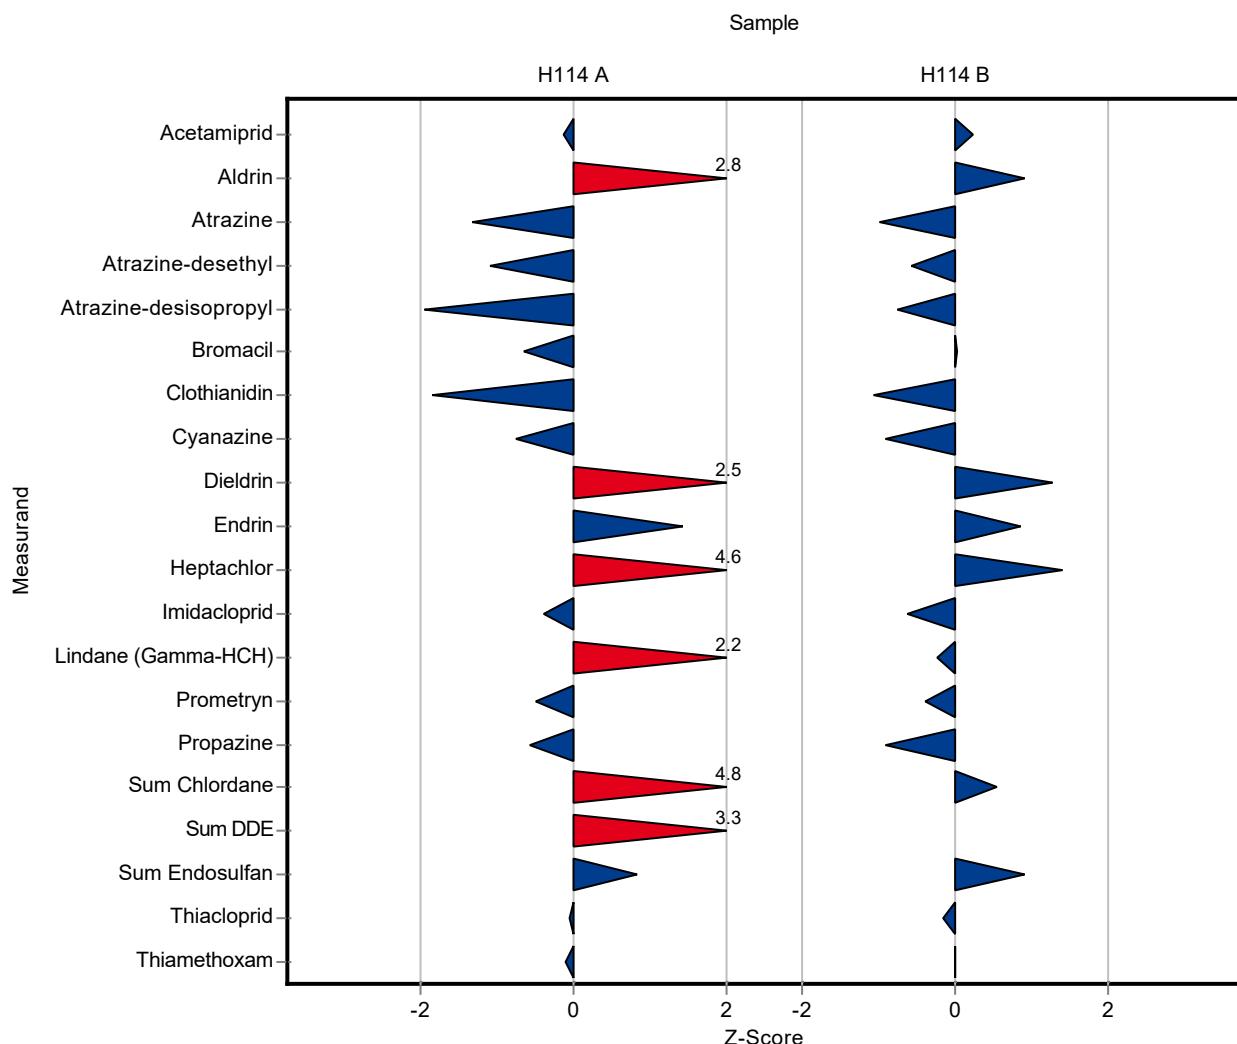


## Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.4 ± 0.06	0.0405	98.8	-0.04
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.253 ± 0.038	0.0412	184	1.49
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.18 ± 0.027	0.0232	85.4	-0.56
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.196 ± 0.029	0.027	87	-0.49
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.22 ± 0.033	0.0424	72.7	-1.18
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.202 ± 0.03	0.0311	91	-0.33
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.098 ± 0.015	0.0135	79.7	-0.83
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.175 ± 0.026	0.0274	89.6	-0.38
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.275 ± 0.041	0.04	158	1.22
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.224 ± 0.034	0.0543	153	1.00
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.307 ± 0.046	0.0433	283	2.05
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.395 ± 0.059	0.0628	94.3	-0.20
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.193 ± 0.029	0.0269	143	1.00
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.222 ± 0.033	0.0308	93.6	-0.23
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.05 ± 0.007	0.0174	83.3	-0.59
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.164 ± 0.025	0.0202	243	1.90
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.486 ± 0.073	0.0769	209	1.61
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.605 ± 0.091	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.306 ± 0.046	0.0933	134	0.80
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.101 ± 0.015	0.0142	99.4	-0.02
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.12 ± 0.018	0.0208	98.1	-0.06

## Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.247 ± 0.187	0.122	102	0.07
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.858 ± 0.128	0.202	127	0.67

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.685 ± 0.253	0.208	89.1	-0.39
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	1.973 ± 0.296	0.254	93.2	-0.24
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.039 ± 0.306	0.32	89.3	-0.39
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.776 ± 0.266	0.248	100	0.01
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	1.666 ± 0.25	0.208	88.3	-0.42
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.451 ± 0.368	0.393	87.4	-0.47
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.63 ± 0.095	0.112	129	0.73
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.524 ± 0.079	0.111	122	0.53
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.546 ± 0.082	0.14	156	1.12
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	1.969 ± 0.295	0.327	90.5	-0.35
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.696 ± 0.104	0.146	95.5	-0.15
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.127 ± 0.319	0.291	95	-0.17
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.775 ± 0.266	0.262	88.1	-0.44
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.742 ± 0.111	0.192	116	0.40
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	-	-
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.921 ± 0.138	-	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.89 ± 0.133	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.915 ± 0.137	0.273	137	0.81
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.337 ± 0.35	0.334	97.9	-0.07
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.074 ± 0.311	0.352	100	0.00

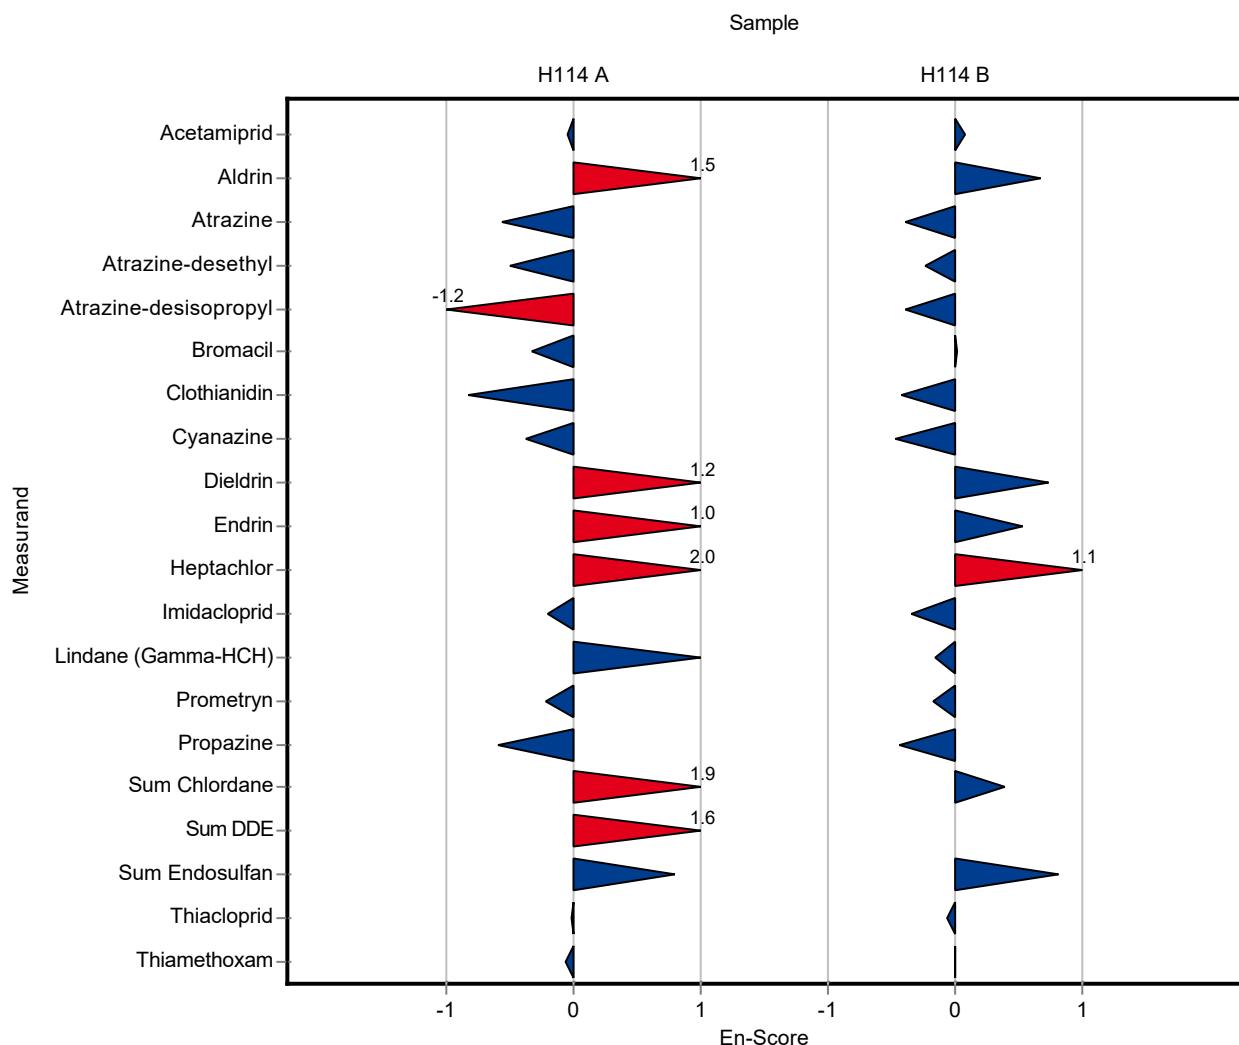

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.403 ± 0.065	0.0405	99.5	-0.05
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.094 ± 0.016	0.0412	68.5	-1.05
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.212 ± 0.035	0.0232	101	0.06
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.208 ± 0.039	0.027	92.3	-0.64
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.287 ± 0.071	0.0424	94.8	-0.37
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.229 ± 0.036	0.0311	103	0.22
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.125 ± 0.021	0.0135	102	0.15
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.174 ± 0.025	0.0274	89.1	-0.78
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.219 ± 0.04	0.04	126	1.13
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.193 ± 0.029	0.0543	132	0.85
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.08 ± 0.015	0.0433	73.9	-0.65
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.468 ± 0.107	0.0628	112	0.78
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.146 ± 0.013	0.0269	108	0.42
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.117 ± 0.02	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.244 ± 0.043	0.0308	103	0.23
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.058 ± 0.009	0.0174	96.6	-0.12
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.064 ± 0.013	0.0202	95	-0.17
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.284 ± 0.057	0.0752	113	0.44
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.264 ± 0.053	0.0769	113	0.40
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.194 ± 0.039	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.229 ± 0.046	0.0933	101	0.02
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.103 ± 0.016	0.0142	101	0.10
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.13 ± 0.013	0.0208	106	0.37


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.23 ± 0.2	0.122	101	0.09
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.455 ± 0.077	0.202	67.5	-1.08

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0016

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.94 ± 0.32	0.208	103 0.23
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	1.89 ± 0.36	0.254	89.3 -0.89
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.11 ± 0.52	0.32	92.4 -0.54
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.88 ± 0.3	0.248	106 0.45
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	2.23 ± 0.37	0.208	118 1.65
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.51 ± 0.36	0.393	89.5 -0.75
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.526 ± 0.097	0.112	108 0.35
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.531 ± 0.08	0.111	124 0.92
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.229 ± 0.042	0.14	65.6 -0.86
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.3 ± 0.52	0.327	106 0.38
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.715 ± 0.064	0.146	98.1 -0.09
Nitenpyram	µg/l	- ± -	2.52 ± 0.43	-	-
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.25 ± 0.4	0.291	101 0.04
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.94 ± 0.3	0.262	96.3 -0.29
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.541 ± 0.11	0.192	84.7 -0.51
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.623 ± 0.13	0.187	100 0.00
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.391 ± 0.078	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.413 ± 0.083	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.633 ± 0.13	0.273	95.1 -0.12
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.48 ± 0.4	0.334	104 0.28
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.07 ± 0.2	0.352	99.8 -0.01

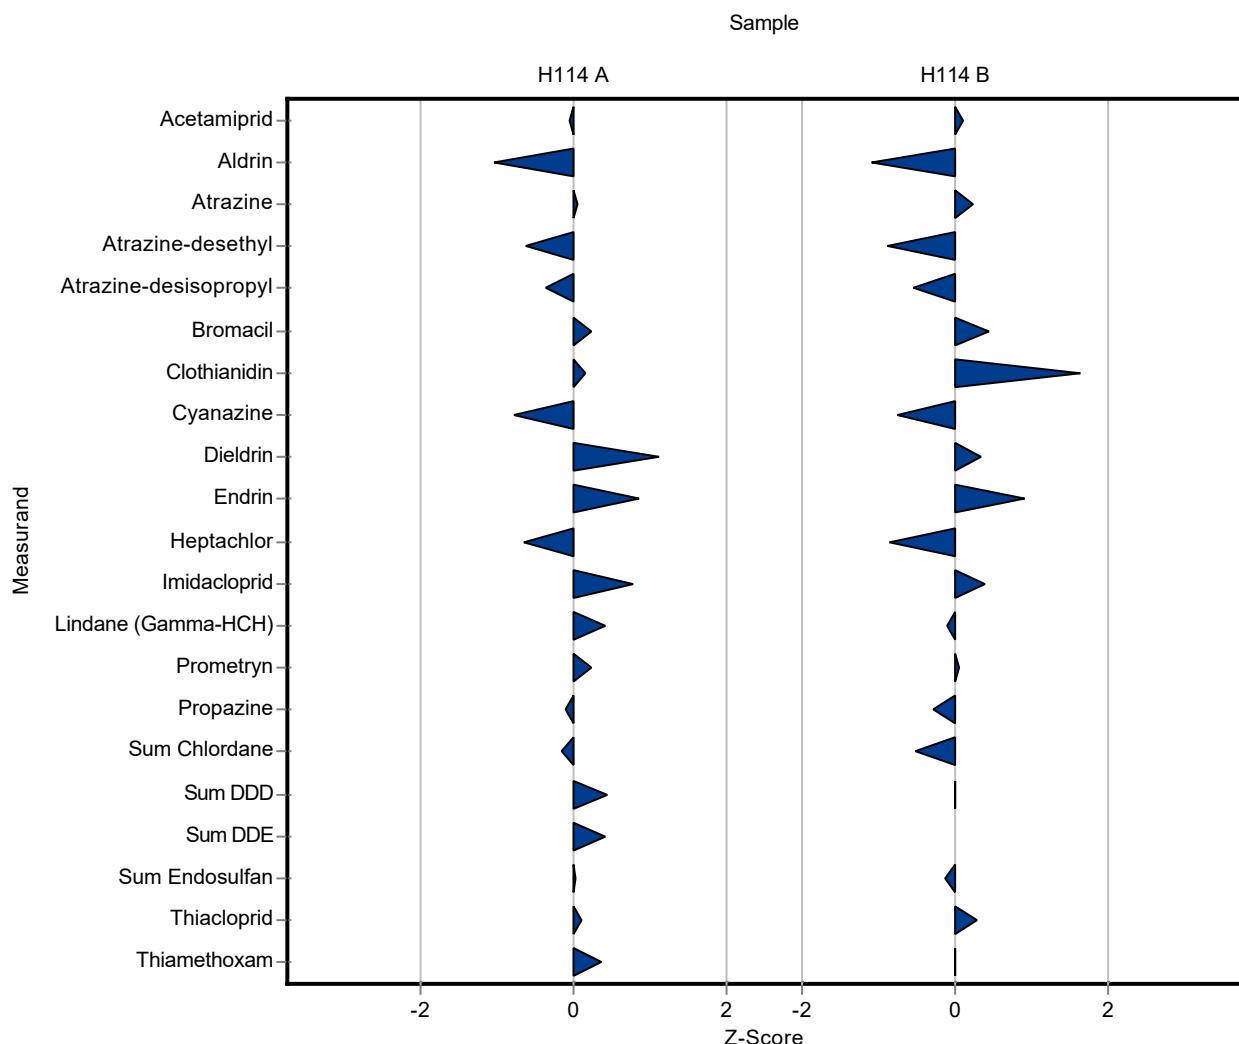


## Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.403 ± 0.065	0.0405	99.5	-0.01
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.094 ± 0.016	0.0412	68.5	-1.22
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.212 ± 0.035	0.0232	101	0.02
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.208 ± 0.039	0.027	92.3	-0.22
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.287 ± 0.071	0.0424	94.8	-0.11
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.229 ± 0.036	0.0311	103	0.10
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.125 ± 0.021	0.0135	102	0.05
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.174 ± 0.025	0.0274	89.1	-0.41
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.219 ± 0.04	0.04	126	0.56
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.193 ± 0.029	0.0543	132	0.68
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.08 ± 0.015	0.0433	73.9	-0.65
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.468 ± 0.107	0.0628	112	0.23
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.146 ± 0.013	0.0269	108	0.42
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.117 ± 0.02	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.244 ± 0.043	0.0308	103	0.08
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.058 ± 0.009	0.0174	96.6	-0.10
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.064 ± 0.013	0.0202	95	-0.12
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.284 ± 0.057	0.0752	113	0.29
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.264 ± 0.053	0.0769	113	0.26
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.194 ± 0.039	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.229 ± 0.046	0.0933	101	0.01
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.103 ± 0.016	0.0142	101	0.04
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.13 ± 0.013	0.0208	106	0.28

## Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.23 ± 0.2	0.122	101	0.03
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.455 ± 0.077	0.202	67.5	-1.21

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.94 ± 0.32	0.208	103 0.07
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	1.89 ± 0.36	0.254	89.3 -0.31
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.11 ± 0.52	0.32	92.4 -0.16
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	1.88 ± 0.3	0.248	106 0.18
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	2.23 ± 0.37	0.208	118 0.45
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.51 ± 0.36	0.393	89.5 -0.40
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.526 ± 0.097	0.112	108 0.20
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.531 ± 0.08	0.111	124 0.56
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.229 ± 0.042	0.14	65.6 -1.13
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.3 ± 0.52	0.327	106 0.12
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.715 ± 0.064	0.146	98.1 -0.10
Nitenpyram	µg/l	- ± -	2.52 ± 0.43	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.25 ± 0.4	0.291	101 0.01
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.94 ± 0.3	0.262	96.3 -0.12
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.541 ± 0.11	0.192	84.7 -0.38
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.623 ± 0.13	0.187	100 0.00
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.391 ± 0.078	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.413 ± 0.083	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.633 ± 0.13	0.273	95.1 -0.11
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.48 ± 0.4	0.334	104 0.12
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.07 ± 0.2	0.352	99.8 -0.01

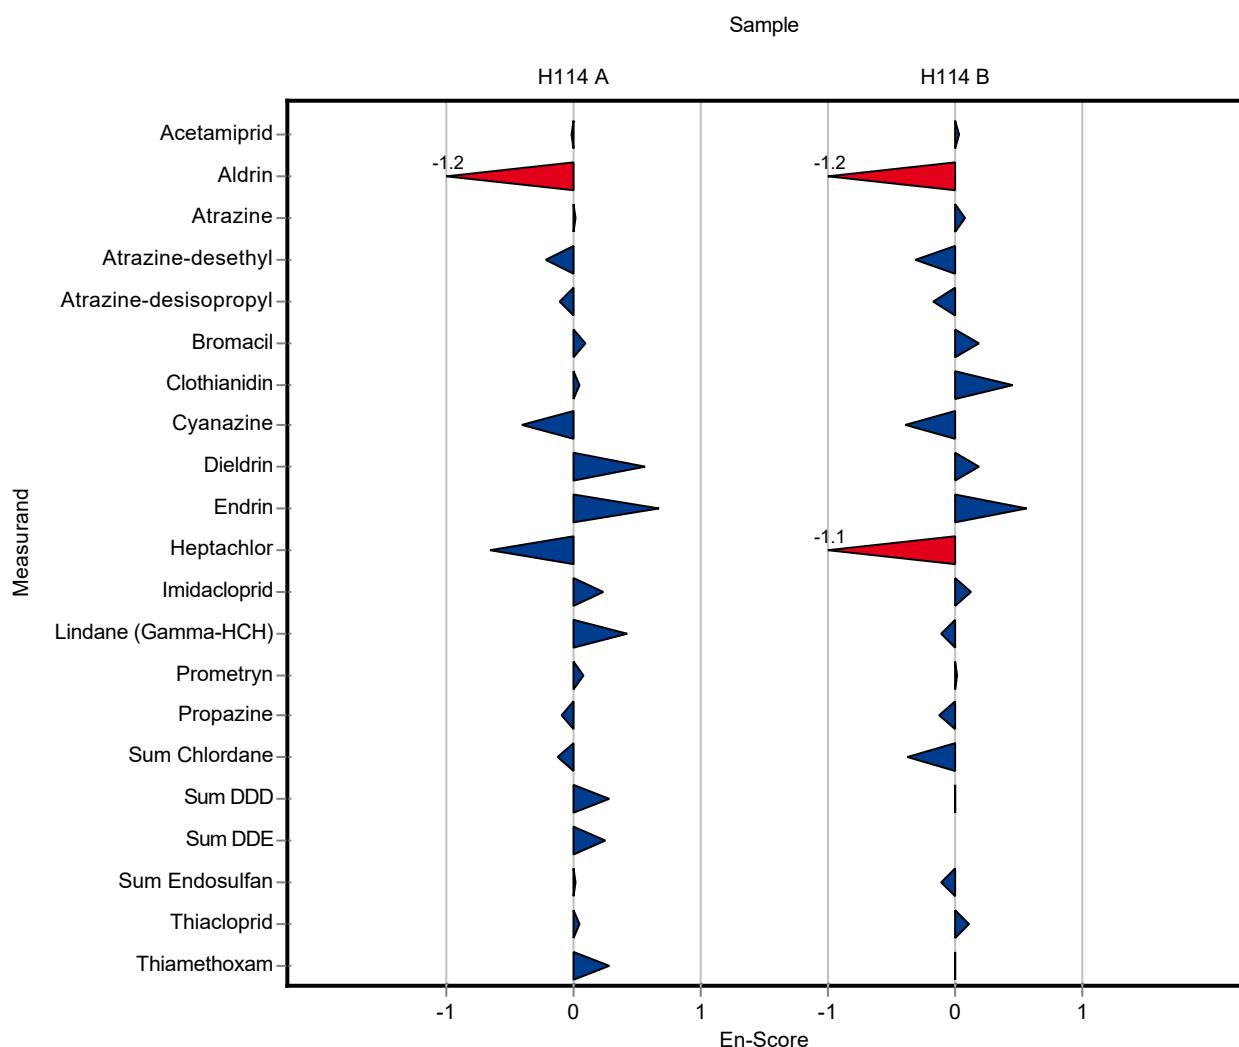

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.19067 ± 0.04195	0.0232	90.5	-0.86
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.22508 ± 0.04952	0.027	99.9	-0.01
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.33768 ± 0.07429	0.0424	112	0.83
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.20352 ± 0.04477	0.0311	91.7	-0.60
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.17383 ± 0.03824	0.0274	89	-0.79
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.2346 ± 0.05161	0.0308	99	-0.08
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.05275 ± 0.01161	0.0174	87.9	-0.42
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.09303 ± 0.02047	0.0142	91.5	-0.60
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0017

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.75703 ± 0.38655	0.208	92.9 -0.65
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	1.87688 ± 0.41291	0.254	88.7 -0.94
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.0293 ± 0.44644	0.32	88.9 -0.79
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.54175 ± 0.55918	0.393	90.6 -0.67
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.17533 ± 0.47857	0.291	97.2 -0.22
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.86635 ± 0.41059	0.262	92.6 -0.57
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.251 ± 0.49522	0.334	94.3 -0.41
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

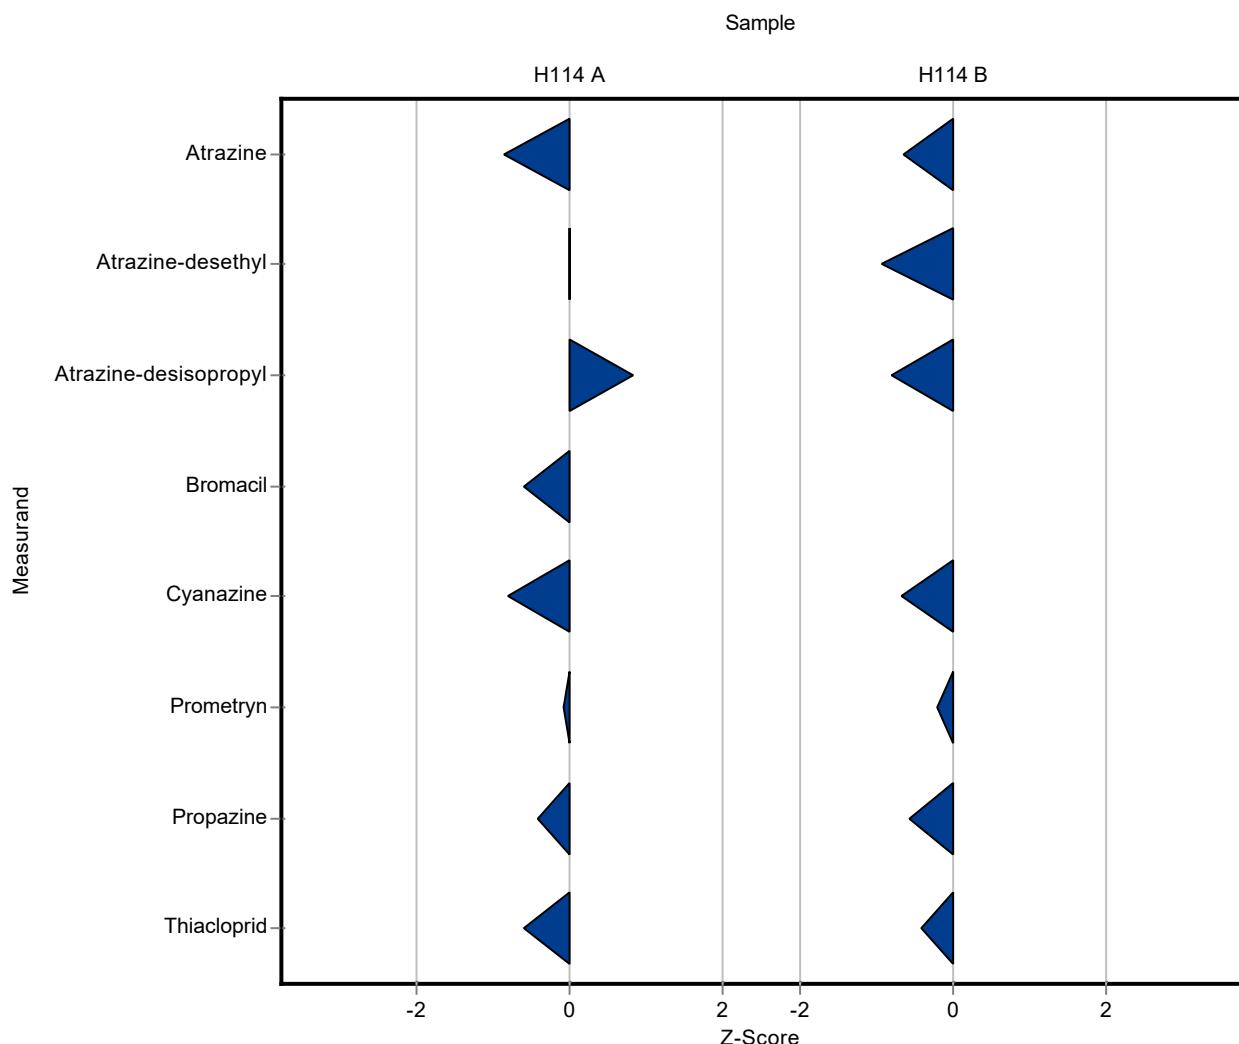


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	- ± -	0.0412	-	-
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.19067 ± 0.04195	0.0232	90.5	-0.24
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.22508 ± 0.04952	0.027	99.9	0.00
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.33768 ± 0.07429	0.0424	112	0.23
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.20352 ± 0.04477	0.0311	91.7	-0.21
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.17383 ± 0.03824	0.0274	89	-0.28
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	- ± -	0.04	-	-
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	- ± -	0.0433	-	-
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	- ± -	0.0269	-	-
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.2346 ± 0.05161	0.0308	99	-0.02
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.05275 ± 0.01161	0.0174	87.9	-0.29
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	- ± -	0.0752	-	-
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	- ± -	0.0769	-	-
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	- ± -	0.0933	-	-
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.09303 ± 0.02047	0.0142	91.5	-0.21
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	- ± -	0.202	-	-

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	1.75703 ± 0.38655	0.208	92.9 -0.17
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	1.87688 ± 0.41291	0.254	88.7 -0.29
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.0293 ± 0.44644	0.32	88.9 -0.28
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	2.54175 ± 0.55918	0.393	90.6 -0.23
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	- ± -	0.112	- -
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	- ± -	0.14	- -
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	- ± -	0.146	- -
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.17533 ± 0.47857	0.291	97.2 -0.07
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	1.86635 ± 0.41059	0.262	92.6 -0.18
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	- ± -	0.187	- -
Sum DDE	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	- ± -	0.273	- -
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.251 ± 0.49522	0.334	94.3 -0.14
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

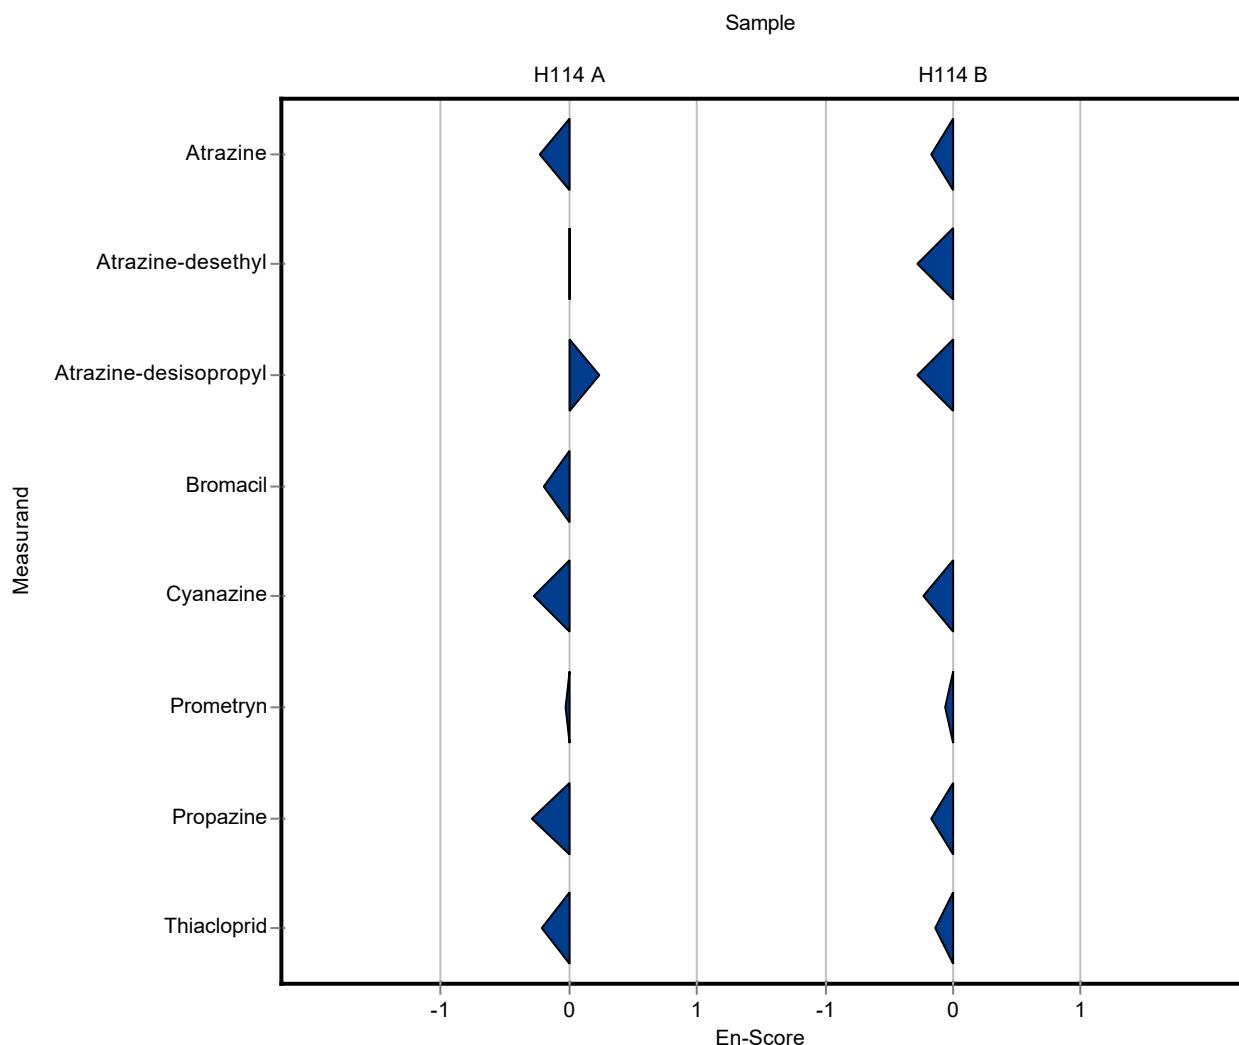

## Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.41 ± 0.205	0.0405	101	0.13
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.155 ± 0.0753	0.0412	113	0.43
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.225 ± 0.113	0.0232	107	0.62
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.24 ± 0.12	0.027	107	0.55
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.32 ± 0.16	0.0424	106	0.41
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.24 ± 0.12	0.0311	108	0.58
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.145 ± 0.073	0.0135	118	1.62
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.205 ± 0.103	0.0274	105	0.35
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.175 ± 0.088	0.04	101	0.03
Dinotefurane	µg/l	- ± -	0.1 ± 0.05	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.078 ± 0.037	0.0543	53.2	-1.27
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.14 ± 0.07	0.0433	129	0.73
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.435 ± 0.218	0.0628	104	0.26
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.14 ± 0.07	0.0269	104	0.20
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.115 ± 0.058	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.23 ± 0.115	0.0308	97	-0.23
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.062 ± 0.031	0.0174	103	0.11
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.083 ± 0.042	0.0202	123	0.77
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.24 ± 0.12	0.0752	95.8	-0.14
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.27 ± 0.135	0.0769	116	0.48
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.19 ± 0.095	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.196 ± 0.098	0.0933	86.1	-0.34
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.095 ± 0.048	0.0142	93.5	-0.47
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.14 ± 0.07	0.0208	115	0.85


## Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.25 ± 0.63	0.122	103	0.26
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.77 ± 0.385	0.202	114	0.47

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0018

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.2 ± 1.1	0.208	116 1.48
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.3 ± 1.15	0.254	109 0.72
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.45 ± 1.23	0.32	107 0.52
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	2.05 ± 1.03	0.248	116 1.14
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	2.15 ± 1.08	0.208	114 1.26
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	3.05 ± 1.53	0.393	109 0.62
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.57 ± 0.285	0.112	117 0.74
Dinotefurane	µg/l	- ± -	1.95 ± 0.975	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.245 ± 0.123	0.111	57.2 -1.65
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.405 ± 0.203	0.14	116 0.40
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.5 ± 1.25	0.327	115 0.99
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.81 ± 0.405	0.146	111 0.56
Nitenpyram	µg/l	- ± -	2.45 ± 1.23	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.2 ± 1.1	0.291	98.3 -0.13
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.2 ± 1.1	0.262	109 0.70
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.83 ± 0.415	0.192	130 1.00
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.435 ± 0.218	0.187	69.8 -1.01
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.71 ± 0.355	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.485 ± 0.243	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.745 ± 0.373	0.273	112 0.29
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.45 ± 1.23	0.334	103 0.19
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.2 ± 1.1	0.352	106 0.36

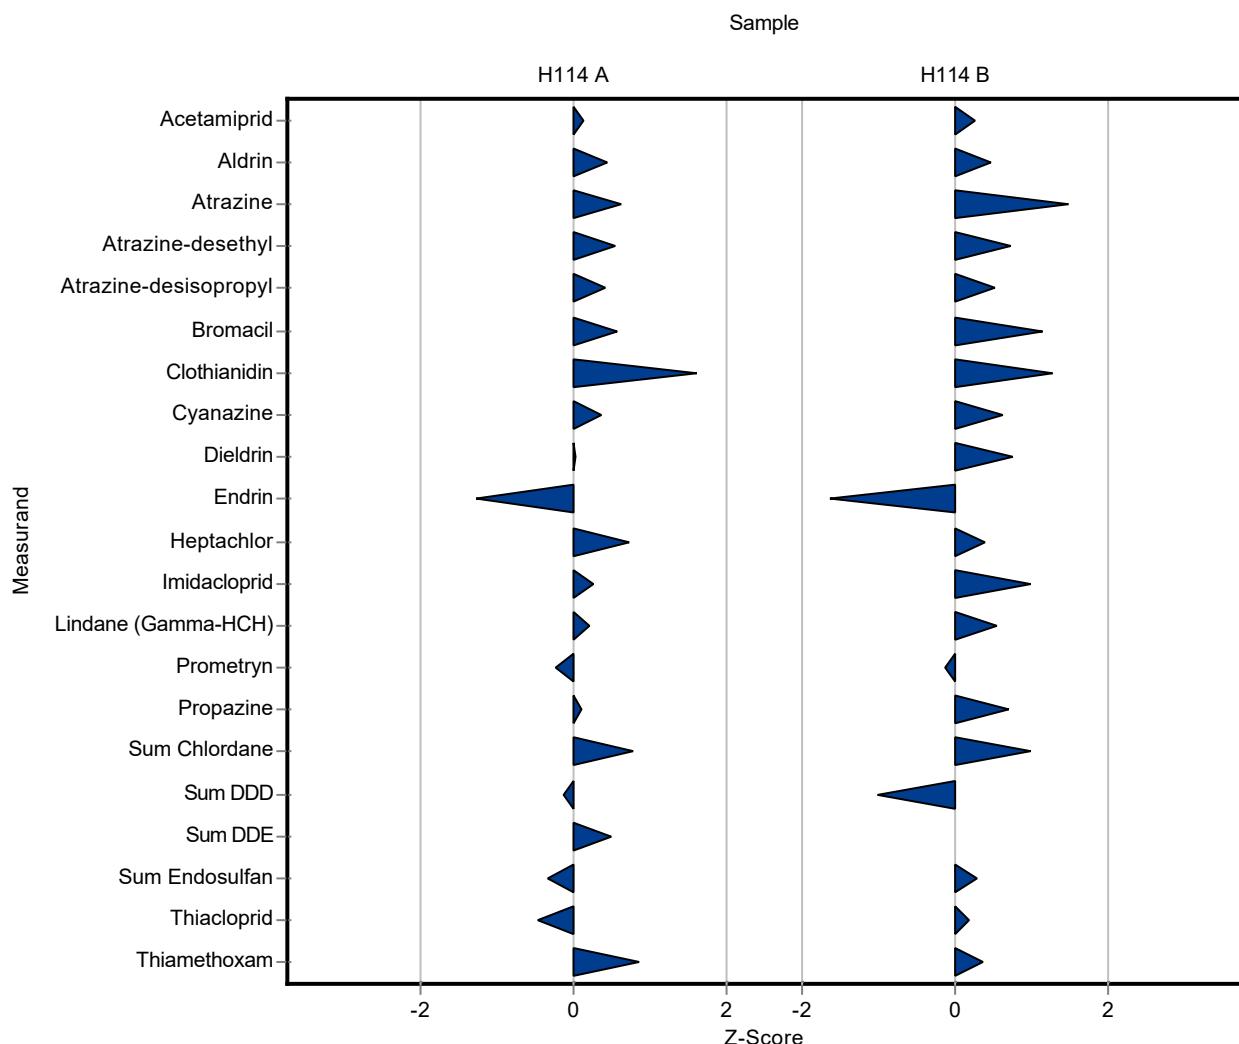


## Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	0.41 ± 0.205	0.0405	101	0.01
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.155 ± 0.0753	0.0412	113	0.12
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	0.225 ± 0.113	0.0232	107	0.06
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	0.24 ± 0.12	0.027	107	0.06
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	0.32 ± 0.16	0.0424	106	0.05
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	0.24 ± 0.12	0.0311	108	0.07
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	0.145 ± 0.073	0.0135	118	0.15
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	0.205 ± 0.103	0.0274	105	0.05
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.175 ± 0.088	0.04	101	0.01
Dinotefurane	µg/l	- ± -	0.1 ± 0.05	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	0.078 ± 0.037	0.0543	53.2	-0.83
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.14 ± 0.07	0.0433	129	0.22
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	0.435 ± 0.218	0.0628	104	0.04
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.14 ± 0.07	0.0269	104	0.04
Nitenpyram	µg/l	- ± -	0.115 ± 0.058	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	0.23 ± 0.115	0.0308	97	-0.03
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	0.062 ± 0.031	0.0174	103	0.03
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	0.083 ± 0.042	0.0202	123	0.19
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.24 ± 0.12	0.0752	95.8	-0.04
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.27 ± 0.135	0.0769	116	0.13
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.19 ± 0.095	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.196 ± 0.098	0.0933	86.1	-0.16
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	0.095 ± 0.048	0.0142	93.5	-0.07
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	0.14 ± 0.07	0.0208	115	0.13

## Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	1.25 ± 0.63	0.122	103	0.02
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.77 ± 0.385	0.202	114	0.12

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	2.2 ± 1.1	0.208	116 0.14
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	2.3 ± 1.15	0.254	109 0.08
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	2.45 ± 1.23	0.32	107 0.07
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	2.05 ± 1.03	0.248	116 0.14
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	2.15 ± 1.08	0.208	114 0.12
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	3.05 ± 1.53	0.393	109 0.08
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.57 ± 0.285	0.112	117 0.15
Dinotefurane	µg/l	- ± -	1.95 ± 0.975	-	- - -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	0.245 ± 0.123	0.111	57.2 -0.70
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.405 ± 0.203	0.14	116 0.14
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	2.5 ± 1.25	0.327	115 0.13
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.81 ± 0.405	0.146	111 0.10
Nitenpyram	µg/l	- ± -	2.45 ± 1.23	-	- - -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	2.2 ± 1.1	0.291	98.3 -0.02
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	2.2 ± 1.1	0.262	109 0.08
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	0.83 ± 0.415	0.192	130 0.23
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.435 ± 0.218	0.187	69.8 -0.42
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.71 ± 0.355	-	- - -
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.485 ± 0.243	-	- - -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.745 ± 0.373	0.273	112 0.10
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	2.45 ± 1.23	0.334	103 0.03
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	2.2 ± 1.1	0.352	106 0.06

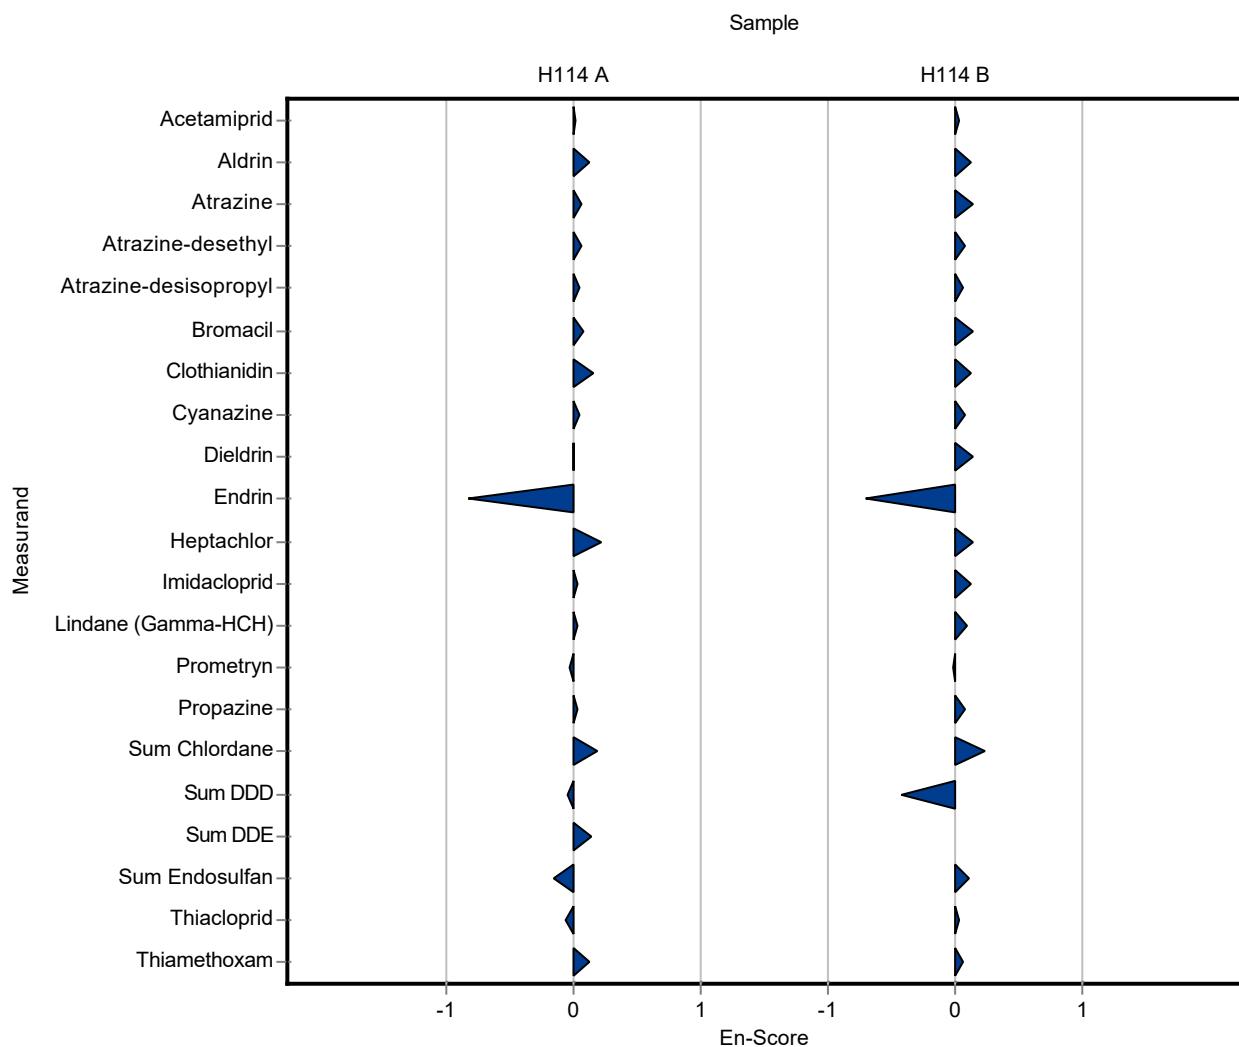

Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.1543 ± 0.023	0.0412	112	0.41
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.1855 ± 0.028	0.04	107	0.29
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.1226 ± 0.018	0.0433	113	0.33
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.1254 ± 0.019	0.0269	93.1	-0.34
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.2081 ± 0.031	0.0752	83	-0.57
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.2216 ± 0.033	0.0769	95.1	-0.15
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.3995 ± 0.06	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.2117 ± 0.032	0.0933	93	-0.17
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	- ± -	0.0142	-	-
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-


Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	z-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.7302 ± 0.11	0.202	108	0.28

Summary of results Pesticides H114

Labcode: LC0019

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	z-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	- -
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.4291 ± 0.064	0.112	88.1 -0.52
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.3777 ± 0.057	0.14	108 0.21
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.7152 ± 0.107	0.146	98.2 -0.09
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.5488 ± 0.082	0.187	88.1 -0.40
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.3595 ± 0.054	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.5176 ± 0.078	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.6078 ± 0.091	0.273	91.3 -0.21
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	- ± -	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

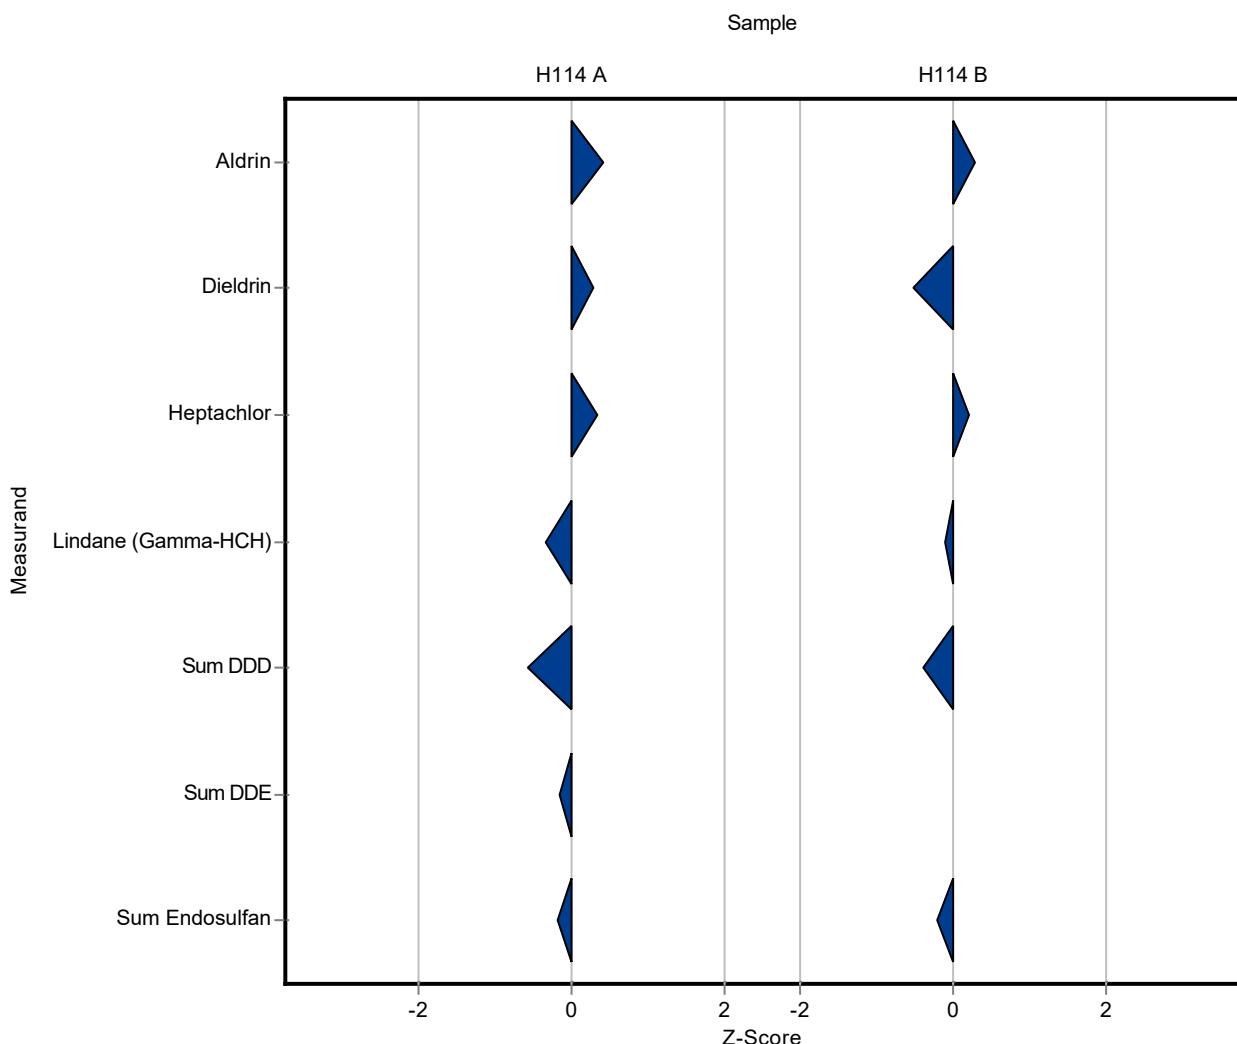


Sample: H114A

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	0.405 ± 0.0168	- ± -	0.0405	-	-
Aldrin	µg/l	0.137 ± 0.0149	0.1543 ± 0.023	0.0412	112	0.35
Atrazine	µg/l	0.211 ± 0.0115	- ± -	0.0232	-	-
Atrazine-desethyl	µg/l	0.225 ± 0.0125	- ± -	0.027	-	-
Atrazine-desisopropyl	µg/l	0.303 ± 0.023	- ± -	0.0424	-	-
Bromacil	µg/l	0.222 ± 0.0115	- ± -	0.0311	-	-
Clothianidin	µg/l	0.123 ± 0.0024	- ± -	0.0135	-	-
Cyanazine	µg/l	0.195 ± 0.0139	- ± -	0.0274	-	-
Dieldrin	µg/l	0.174 ± 0.0139	0.1855 ± 0.028	0.04	107	0.20
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Endrin	µg/l	0.147 ± 0.0363	- ± -	0.0543	-	-
Heptachlor	µg/l	0.108 ± 0.0312	0.1226 ± 0.018	0.0433	113	0.30
Imidacloprid	µg/l	0.419 ± 0.0225	- ± -	0.0628	-	-
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.135 ± 0.00809	0.1254 ± 0.019	0.0269	93.1	-0.24
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	-	-
Prometryn	µg/l	0.237 ± 0.00991	- ± -	0.0308	-	-
Propazine	µg/l	0.06 ± 0.00973	- ± -	0.0174	-	-
Sum Chlordane	µg/l	0.0674 ± 0.00891	- ± -	0.0202	-	-
Sum DDD	µg/l	0.251 ± 0.0259	0.2081 ± 0.031	0.0752	83	-0.63
Sum DDE	µg/l	0.233 ± 0.0583	0.2216 ± 0.033	0.0769	95.1	-0.13
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.3995 ± 0.06	-	-	-
Sum Endosulfan	µg/l	0.228 ± 0.0326	0.2117 ± 0.032	0.0933	93	-0.22
Thiacloprid	µg/l	0.102 ± 0.0048	- ± -	0.0142	-	-
Thiamethoxam	µg/l	0.122 ± 0.0083	- ± -	0.0208	-	-

Sample: H114B

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion	Recovery [%]	En-Score
Acetamiprid	µg/l	1.22 ± 0.0754	- ± -	0.122	-	-
Aldrin	µg/l	0.674 ± 0.0955	0.7302 ± 0.11	0.202	108	0.23

Parameter	Unit	Assigned value ± U (k=2)	Result ± U	Criterion Recovery [%]	En-Score
Atrazine	µg/l	1.89 ± 0.163	- ± -	0.208	- -
Atrazine-desethyl	µg/l	2.12 ± 0.139	- ± -	0.254	- -
Atrazine-desisopropyl	µg/l	2.28 ± 0.151	- ± -	0.32	- -
Bromacil	µg/l	1.77 ± 0.171	- ± -	0.248	- -
Clothianidin	µg/l	1.89 ± 0.180	- ± -	0.208	- -
Cyanazine	µg/l	2.81 ± 0.19	- ± -	0.393	- -
Dieldrin	µg/l	0.487 ± 0.0518	0.4291 ± 0.064	0.112	88.1 -0.42
Dinotefurane	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Endrin	µg/l	0.428 ± 0.0902	- ± -	0.111	- -
Heptachlor	µg/l	0.349 ± 0.0655	0.3777 ± 0.057	0.14	108 0.22
Imidacloprid	µg/l	2.18 ± 0.116	- ± -	0.327	- -
Lindane (Gamma-HCH)	µg/l	0.729 ± 0.0329	0.7152 ± 0.107	0.146	98.2 -0.06
Nitenpyram	µg/l	- ± -	- ± -	-	- -
Prometryn	µg/l	2.24 ± 0.107	- ± -	0.291	- -
Propazine	µg/l	2.02 ± 0.141	- ± -	0.262	- -
Sum Chlordane	µg/l	0.639 ± 0.136	- ± -	0.192	- -
Sum DDD	µg/l	0.623 ± 0.105	0.5488 ± 0.082	0.187	88.1 -0.38
Sum DDE	µg/l	- ± -	0.3595 ± 0.054	-	- -
Sum DDT	µg/l	- ± -	0.5176 ± 0.078	-	- -
Sum Endosulfan	µg/l	0.666 ± 0.14	0.6078 ± 0.091	0.273	91.3 -0.25
Thiacloprid	µg/l	2.39 ± 0.113	- ± -	0.334	- -
Thiamethoxam	µg/l	2.07 ± 0.102	- ± -	0.352	- -

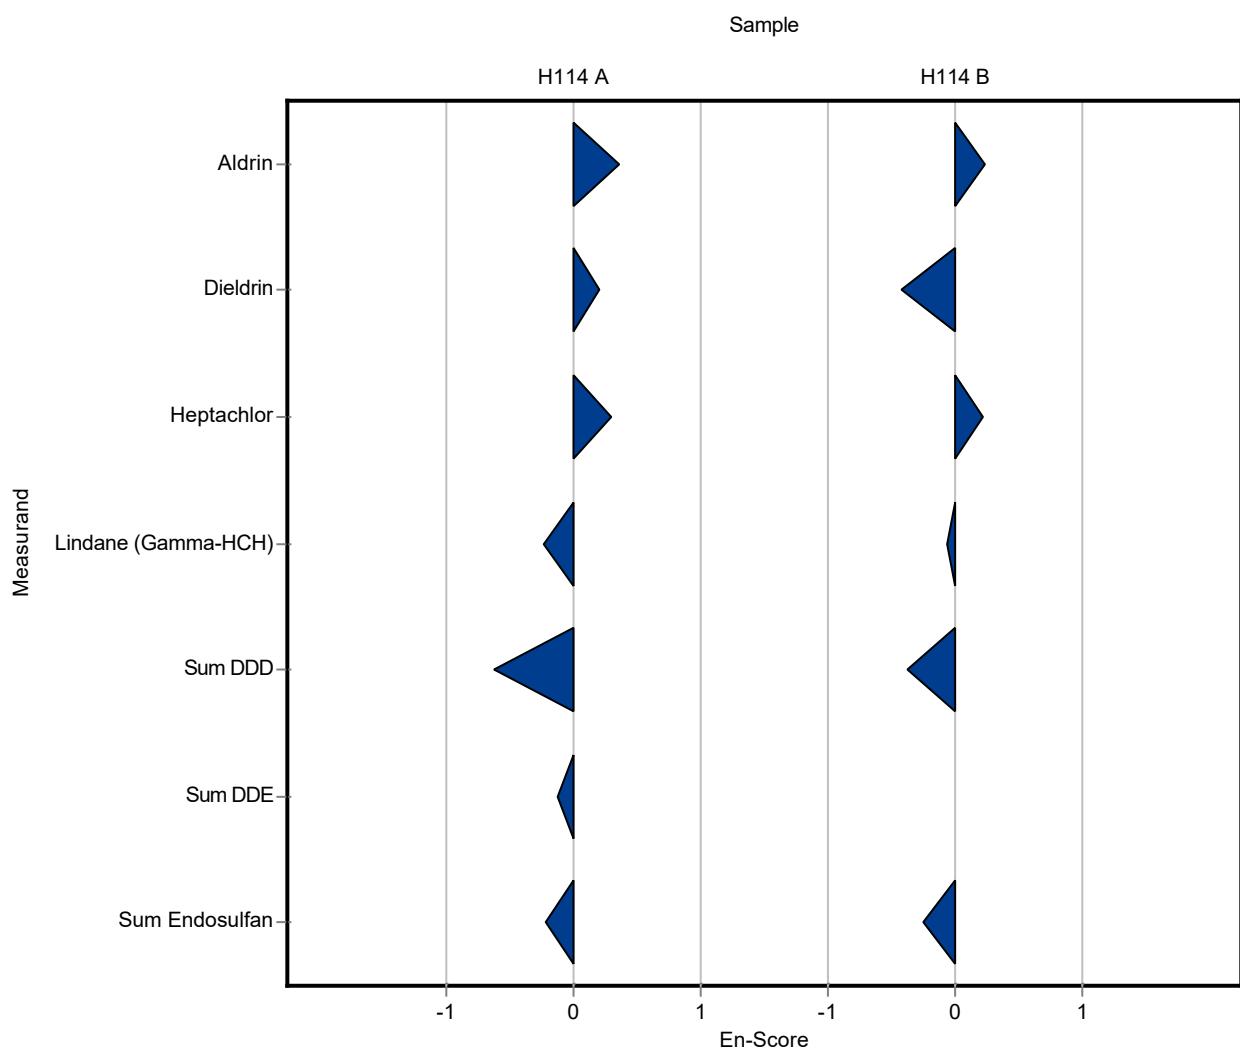

## E9. Methodenübersicht / Overview of methods

LabCode	Sample	Acetamiprid	Aldrin	Atrazine	Atrazine-desethyl	Atrazine-desisopropyl
LC0001	H114A	SPE-LC-MS/MS;	SPE-GC-MS/MS;	SPE-GC-MS/MS;		
LC0002	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0003	H114A		GC-HRMS; DIN 38407-37			
LC0004	H114A	House method; MT.M1.318				House method; MT.M1.626
LC0005	H114A		GC-MS/MS;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;
LC0006	H114A			HPLC-UV; EN ISO 11369	HPLC-UV; EN ISO 11369	HPLC-UV; EN ISO 11369
LC0007	H114A		GC; DIN 38407-2	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)
LC0008	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0009	H114A			LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;
LC0010	H114A			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0011	H114A	LC-MS direct;			LC-MS direct;	LC-MS direct;
LC0012	H114A	LC-MS/MS;	GC-ECD;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;	
LC0013	H114A		GC-MS; DIN 38407-37	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0014	H114A					
LC0015	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC ; EN ISO 10695	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0016	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	EN ISO 6468; GC-MS	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0017	H114A			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0018	H114A	LC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0019	H114A		GC-MS; DIN 38407-37 (F37)			

LabCode	Sample	Bromacil	Clothianidin	Cyanazine	Dieldrin	Dinotefurane
LC0001	H114A		SPE-LC-MS/MS;		SPE-GC-MS/MS;	
LC0002	H114A		LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	
LC0003	H114A				GC-HRMS; DIN 38407-37	
LC0004	H114A	House method; MT.M1.626	House method; MT.M1.626			
LC0005	H114A	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	GC-MS/MS;	
LC0006	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		HPLC-UV; EN ISO 11369		
LC0007	H114A	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)		LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	GC; DIN 38407-2	
LC0008	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0009	H114A		LC-MS/MS direct;			
LC0010	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		
LC0011	H114A	LC-MS direct;	LC-MS direct;			
LC0012	H114A	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;		GC-ECD;	
LC0013	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC-MS; DIN 38407-37	
LC0014	H114A	GC-MS (SPE, derivatization); EN ISO 15913			GC-MS; house method	
LC0015	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC ; EN ISO 10695	
LC0016	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS; DIN 38407-35	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	EN ISO 6468; GC-MS	
LC0017	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)		LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)		
LC0018	H114A	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0019	H114A				GC-MS; DIN 38407-37 (F37)	

LabCode	Sample	Endrin	Heptachlor	Imidacloprid	Lindane (Gamma-HCH)	Nitenpyram
LC0001	H114A	SPE-GC-MS/MS;	SPE-GC-MS/MS;	SPE-LC-MS/MS;	SPE-GC-MS/MS;	
LC0002	H114A	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	LC-MS/MS direct; EN ISO 21676	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	
LC0003	H114A	GC-HRMS; DIN 38407-37	GC-HRMS; DIN 38407-37		GC-HRMS; DIN 38407-37	
LC0004	H114A			House method; MT.M1.318		
LC0005	H114A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS direct;	GC-MS/MS;	
LC0006	H114A			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		
LC0007	H114A	GC; DIN 38407-2	GC; DIN 38407-2		GC; DIN 38407-2	
LC0008	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)				
LC0009	H114A			LC-MS/MS direct;		
LC0010	H114A					
LC0011	H114A			LC-MS direct;		
LC0012	H114A	GC-ECD;	GC-ECD;	LC-MS/MS;	GC-ECD;	LC-MS/MS;
LC0013	H114A		GC-MS; DIN 38407-37	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		
LC0014	H114A				GC; EN ISO 6468; DIN 38407	
LC0015	H114A	GC ; EN ISO 10695	GC ; EN ISO 10695	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC ; EN ISO 10695	
LC0016	H114A	EN ISO 6468; GC-MS	EN ISO 6468; GC-MS	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	EN ISO 6468; GC-MS	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0017	H114A					
LC0018	H114A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0019	H114A		GC-MS; DIN 38407-37 (F37)		GC-MS; DIN 38407-37 (F37)	

LabCode	Sample	Prometryn	Propazine	Sum Chlordane	Sum DDD	Sum DDE
LC0001	H114A					
LC0002	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)		GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)
LC0003	H114A					
LC0004	H114A					
LC0005	H114A	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0006	H114A	HPLC-UV; EN ISO 11369	HPLC-UV; EN ISO 11369			
LC0007	H114A	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	GC; DIN 38407-2	GC; DIN 38407-2	GC; DIN 38407-2
LC0008	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0009	H114A		LC-MS/MS direct;			
LC0010	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36			
LC0011	H114A					
LC0012	H114A	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;		GC-ECD;	GC-ECD;
LC0013	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36			
LC0014	H114A					
LC0015	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC ; EN ISO 10695		GC ; EN ISO 10695
LC0016	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	EN ISO 6468; GC-MS	EN ISO 6468; GC-MS	EN ISO 6468; GC-MS
LC0017	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)			
LC0018	H114A	LC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0019	H114A				GC-MS; DIN 38407-37 (F37)	GC-MS; DIN 38407-37 (F37)

LabCode	Sample	Sum DDT	Sum Endosulfan	Thiacloprid	Thiamethoxam
LC0001	H114A		SPE-LC-MS/MS;	SPE-LC-MS/MS;	SPE-LC-MS/MS;
LC0002	H114A			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0003	H114A				
LC0004	H114A			House method; MT.M1.318	House method; MT.M1.626
LC0005	H114A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;
LC0006	H114A			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0007	H114A	GC; DIN 38407-2	GC; DIN 38407-2	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	
LC0008	H114A	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)			
LC0009	H114A			LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;
LC0010	H114A				
LC0011	H114A			LC-MS direct;	LC-MS direct;
LC0012	H114A	GC-ECD;	GC-ECD;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0013	H114A			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0014	H114A		GC-MS; house method		
LC0015	H114A	GC ; EN ISO 10695	GC ; EN ISO 10695	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0016	H114A	EN ISO 6468; GC-MS	EN ISO 6468; GC-MS	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0017	H114A			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	
LC0018	H114A	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0019	H114A	GC-MS; DIN 38407-37 (F37)	GC-MS; DIN 38407-37 (F37)		

LabCode	Sample	Acetamiprid	Aldrin	Atrazine	Atrazine-desethyl	Atrazine-desisopropyl
LC0001	H114B	SPE-LC-MS/MS;	SPE-GC-MS/MS;	SPE-GC-MS/MS;		
LC0002	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0003	H114B		GC-HRMS; DIN 38407-37			
LC0004	H114B	House method; MT.M1.318				House method; MT.M1.626
LC0005	H114B		GC-MS/MS;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;
LC0006	H114B			HPLC-UV; EN ISO 11369	HPLC-UV; EN ISO 11369	HPLC-UV; EN ISO 11369
LC0007	H114B		GC; DIN 38407-2	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)
LC0008	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0009	H114B			LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;
LC0010	H114B			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0011	H114B	LC-MS direct;			LC-MS direct;	LC-MS direct;
LC0012	H114B	LC-MS/MS;	GC-ECD;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;	
LC0013	H114B		GC-MS; DIN 38407-37	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0014	H114B					
LC0015	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC ; EN ISO 10695	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0016	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	EN ISO 6468; GC-MS	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0017	H114B			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0018	H114B	LC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0019	H114B		GC-MS; DIN 38407-37 (F37)			

LabCode	Sample	Bromacil	Clothianidin	Cyanazine	Dieldrin	Dinotefurane
LC0001	H114B		SPE-LC-MS/MS;		SPE-GC-MS/MS;	
LC0002	H114B		LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	
LC0003	H114B				GC-HRMS; DIN 38407-37	
LC0004	H114B	House method; MT.M1.626	House method; MT.M1.626			
LC0005	H114B	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	GC-MS/MS;	
LC0006	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		HPLC-UV; EN ISO 11369		
LC0007	H114B	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)		LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	GC; DIN 38407-2	
LC0008	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0009	H114B		LC-MS/MS direct;			
LC0010	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		
LC0011	H114B	LC-MS direct;	LC-MS direct;			
LC0012	H114B	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;		GC-ECD;	
LC0013	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC-MS; DIN 38407-37	
LC0014	H114B	GC-MS (SPE, derivatization); EN ISO 15913			GC-MS; house method	
LC0015	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC ; EN ISO 10695	
LC0016	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS; DIN 38407-35	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	EN ISO 6468; GC-MS	
LC0017	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)		LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)		
LC0018	H114B	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0019	H114B				GC-MS; DIN 38407-37 (F37)	

LabCode	Sample	Endrin	Heptachlor	Imidacloprid	Lindane (Gamma-HCH)	Nitenpyram
LC0001	H114B	SPE-GC-MS/MS;	SPE-GC-MS/MS;	SPE-LC-MS/MS;	SPE-GC-MS/MS;	
LC0002	H114B	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	LC-MS/MS direct; EN ISO 21676	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)	
LC0003	H114B	GC-HRMS; DIN 38407-37	GC-HRMS; DIN 38407-37		GC-HRMS; DIN 38407-37	
LC0004	H114B			House method; MT.M1.318		
LC0005	H114B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS direct;	GC-MS/MS;	
LC0006	H114B			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		
LC0007	H114B	GC; DIN 38407-2	GC; DIN 38407-2		GC; DIN 38407-2	
LC0008	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)				
LC0009	H114B			LC-MS/MS direct;		
LC0010	H114B					
LC0011	H114B			LC-MS direct;		
LC0012	H114B	GC-ECD;	GC-ECD;	LC-MS/MS;	GC-ECD;	LC-MS/MS;
LC0013	H114B		GC-MS; DIN 38407-37	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36		
LC0014	H114B				GC; EN ISO 6468; DIN 38407	
LC0015	H114B	GC ; EN ISO 10695	GC ; EN ISO 10695	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC ; EN ISO 10695	
LC0016	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	EN ISO 6468; GC-MS	EN ISO 6468; GC-MS
LC0017	H114B					
LC0018	H114B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0019	H114B		GC-MS; DIN 38407-37 (F37)		GC-MS; DIN 38407-37 (F37)	

LabCode	Sample	Prometryn	Propazine	Sum Chlordane	Sum DDD	Sum DDE
LC0001	H114B					
LC0002	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)		GC-MS/MS; DIN 38407-37 (F37)
LC0003	H114B					
LC0004	H114B					
LC0005	H114B	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0006	H114B	HPLC-UV; EN ISO 11369	HPLC-UV; EN ISO 11369			
LC0007	H114B	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	LC; DIN 38407-36 (F36); EN ISO 11369 (F12)	GC; DIN 38407-2	GC; DIN 38407-2	GC; DIN 38407-2
LC0008	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0009	H114B		LC-MS/MS direct;			
LC0010	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36			
LC0011	H114B					
LC0012	H114B	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;		GC-ECD;	GC-ECD;
LC0013	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36			
LC0014	H114B					
LC0015	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	GC ; EN ISO 10695		GC ; EN ISO 10695
LC0016	H114B	EN ISO 6468; GC-MS	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	EN ISO 6468; GC-MS	EN ISO 6468; GC-MS
LC0017	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)			
LC0018	H114B	LC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;
LC0019	H114B				GC-MS; DIN 38407-37 (F37)	GC-MS; DIN 38407-37 (F37)

LabCode	Sample	Sum DDT	Sum Endosulfan	Thiacloprid	Thiamethoxam
LC0001	H114B		SPE-GC-MS/MS;	SPE-LC-MS/MS;	SPE-LC-MS/MS;
LC0002	H114B			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)
LC0003	H114B				
LC0004	H114B			House method; MT.M1.318	House method; MT.M1.626
LC0005	H114B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;
LC0006	H114B			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0007	H114B	GC; DIN 38407-2	GC; DIN 38407-2	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	
LC0008	H114B	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)			
LC0009	H114B			LC-MS/MS direct;	LC-MS/MS direct;
LC0010	H114B				
LC0011	H114B			LC-MS direct;	LC-MS direct;
LC0012	H114B	GC-ECD;	GC-ECD;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0013	H114B			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0014	H114B		GC-MS; house method		
LC0015	H114B	GC ; EN ISO 10695	GC ; EN ISO 10695	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0016	H114B	EN ISO 6468; GC-MS	EN ISO 6468; GC-MS	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36	LC-MS/MS direct; DIN 38407-36
LC0017	H114B			LC-MS/MS direct; DIN 38407-36 (F36)	
LC0018	H114B	GC-MS/MS;	GC-MS/MS;	LC-MS/MS;	LC-MS/MS;
LC0019	H114B	GC-MS; DIN 38407-37 (F37)	GC-MS; DIN 38407-37 (F37)		